

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Стеллаж медицинский настольный КП-СН-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

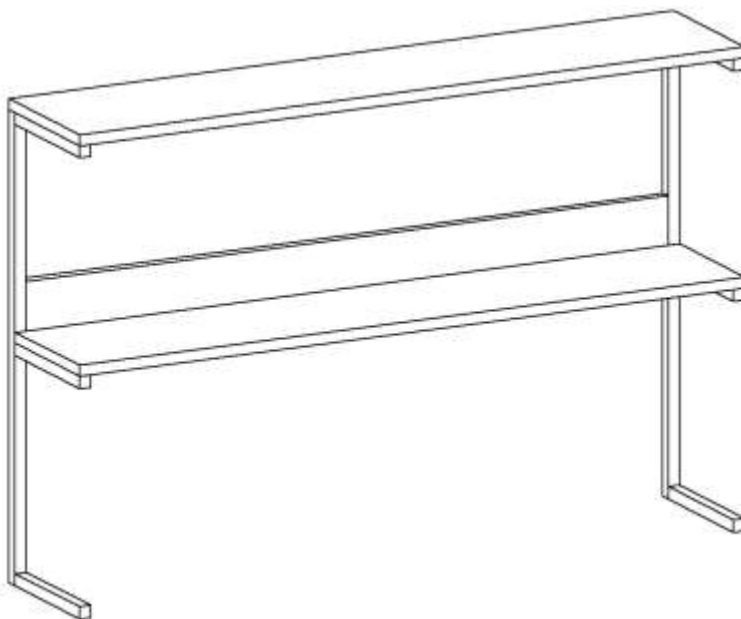

1. Назначение и конструкция

Стеллаж настольный используется для оснащения клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для установки непосредственно на столы, служит для удобства размещения медицинского инструментария, различного аналитического, измерительного оборудования и принадлежностей к ним. Стеллажи спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Материал полок – ламинированная ДСП соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на стеллаж настольный КП-СН-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Стеллаж настольный – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Стеллаж поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте стеллаж, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

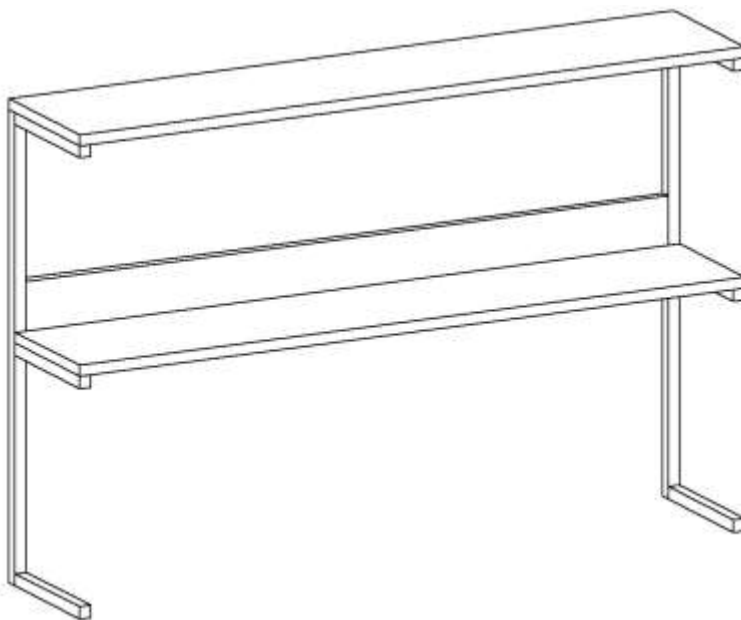

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Стеллаж должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Стол медицинский высокий КП-СМВ-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

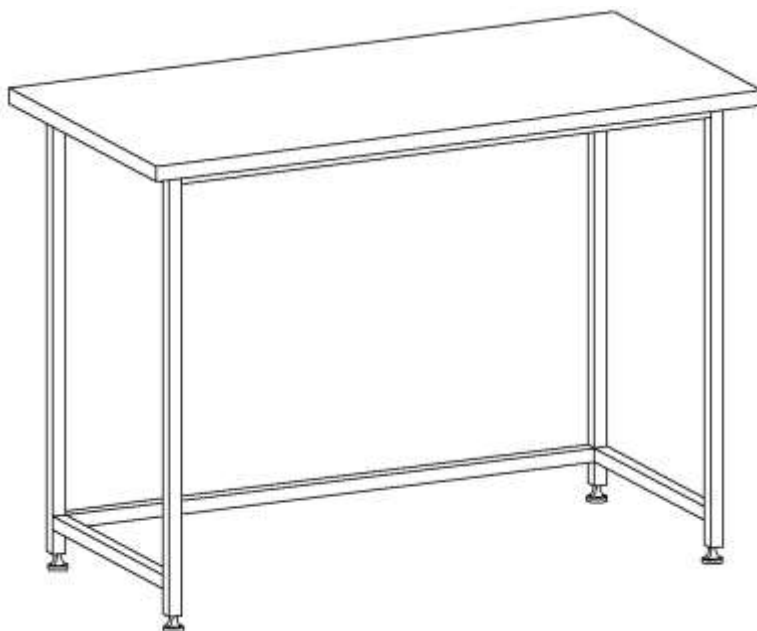

1. Назначение и конструкция

Стол медицинский высокий используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для размещения различного аналитического, измерительного, физиотерапевтического оборудования и другой аппаратуры используемой при проведении диагностических и исследовательских работ. Столы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Материал столешницы – постформинг, ламинированная ДСП или керамика и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на стол лабораторный КП-СЛВ-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Стол лабораторный высокий – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Стол поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте стол, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

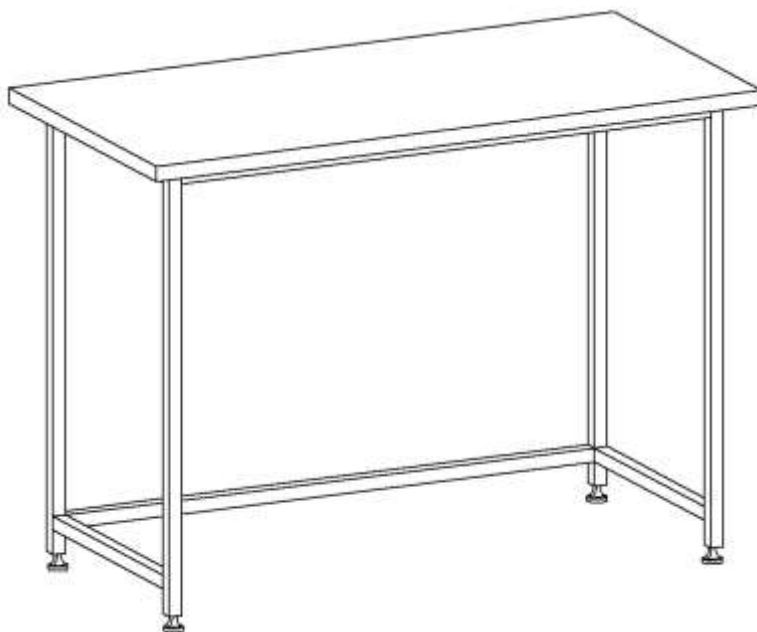

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Стол медицинский для титрования КП-СТР-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

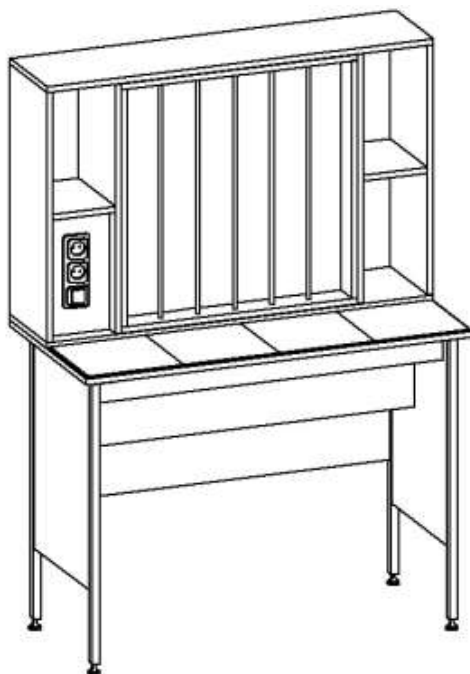

1. Назначение и конструкция

Стол для титрования используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для проведения работ с использованием традиционных бюреточных систем титрования в диагностических и исследовательских работах. Столы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Материал столешницы – постформинг или ламинированная ДСП или керамика и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на стол для титрования КП-СТР-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Стол для титрования – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Стол поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте стол, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

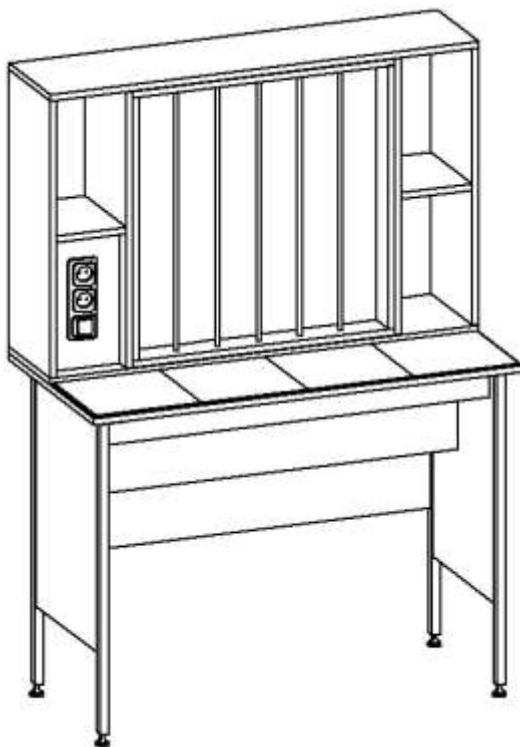

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Стол медицинский низкий КП-СМН-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

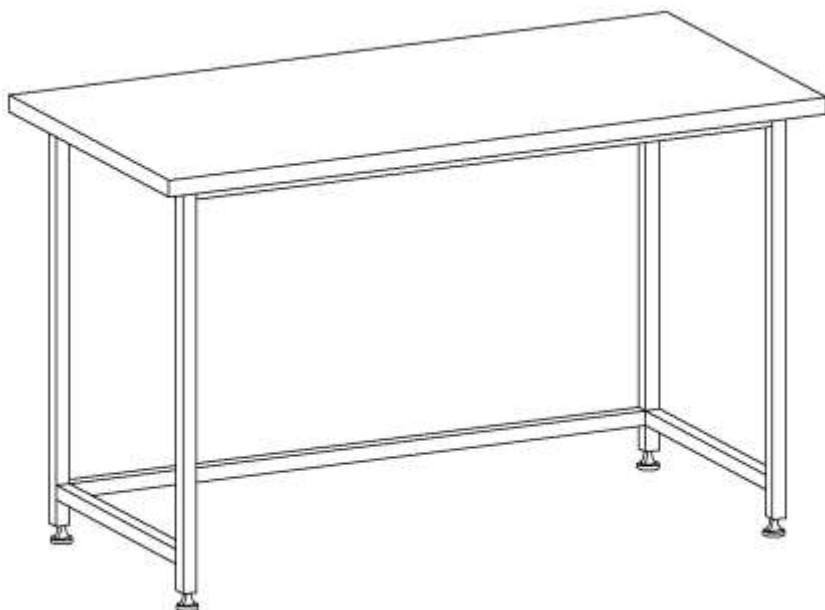

1. Назначение и конструкция

Стол медицинский низкий используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для размещения различного аналитического, измерительного, физиотерапевтического оборудования и другой аппаратуры используемой при проведении диагностических и исследовательских работ. Столы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Материал столешницы – постформинг, ламинированная ДСП или керамика и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на стол лабораторный КП-СЛН-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Стол лабораторный низкий – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Стол поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте стол, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

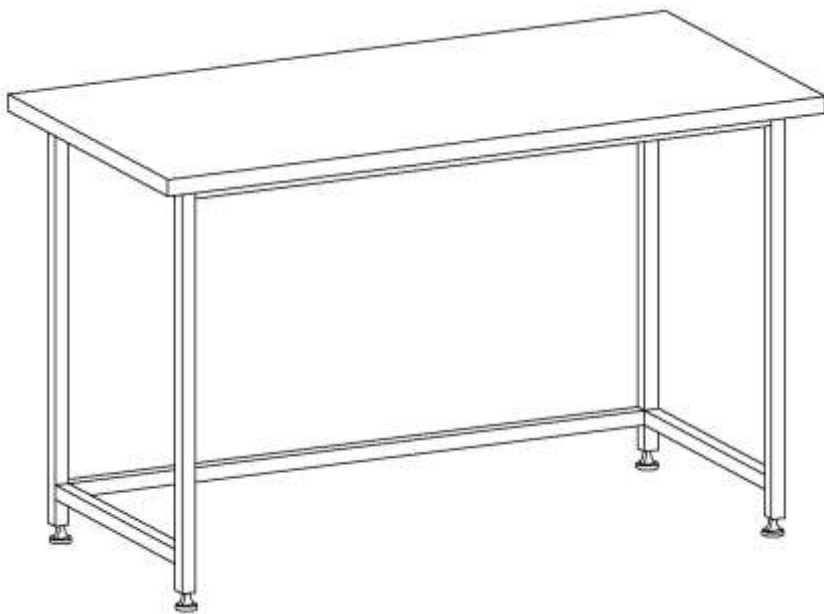

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Стол медицинский островной КП-СМО-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

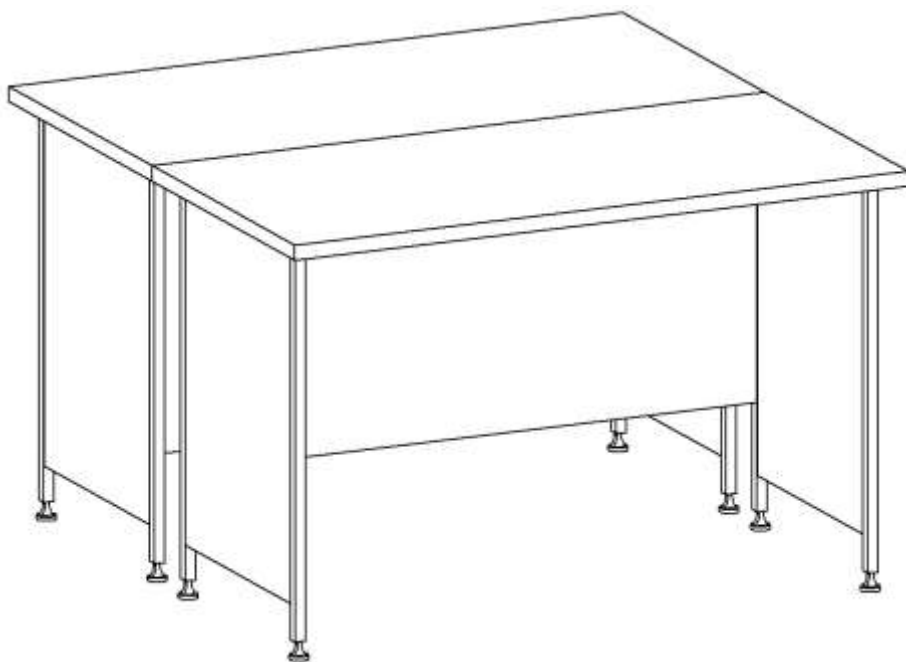

1. Назначение и конструкция

Стол медицинский островной используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для размещения различного аналитического, измерительного, физиотерапевтического оборудования и другой аппаратуры используемой при проведении диагностических и исследовательских работ. Обеспечивает медицинскому персоналу круговой доступ к установленному на него оборудованию. Столы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Материал столешницы – постформинг, ламинированная ДСП или керамика и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на стол лабораторный островной КП-СЛО-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Стол лабораторный островной – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Стол поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте стол, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

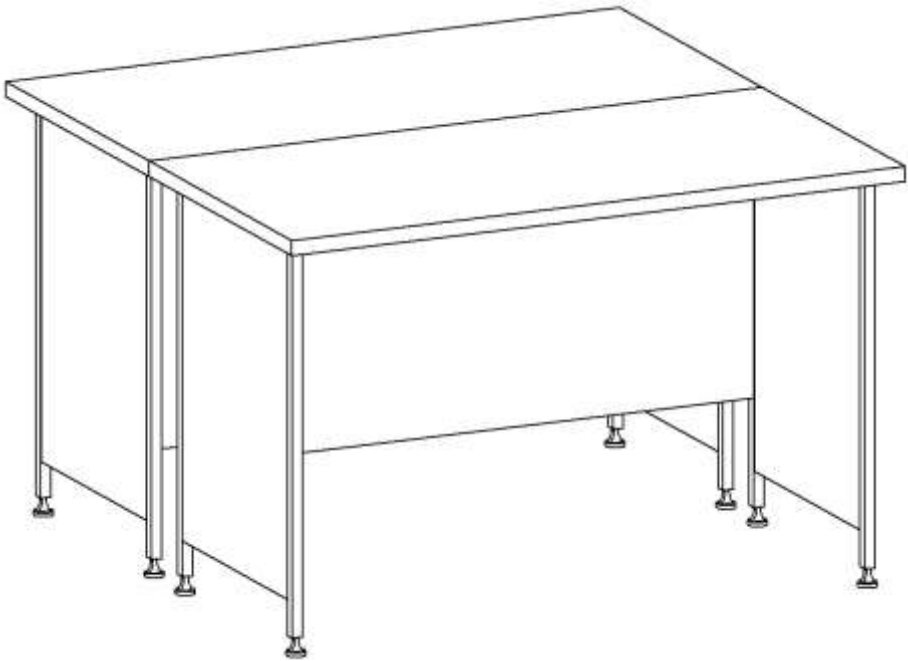

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Стол медицинский технологический КП-СТХ-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**



1. Назначение и конструкция

Стол медицинский используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для размещения и хранения различного аналитического, измерительного, физиотерапевтического оборудования и другой аппаратуры, принадлежностей и медицинского инструментария, используемого при проведении диагностических и исследовательских работ. Конструкция стола позволяет его оперативное перемещение к необходимому на данный момент месту. Стол технологический спроектирован в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Столешницы, полки, стенки стола изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде

1. Стол технологический – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Стол поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте стол, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите изделие для определения ее состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид



6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Стол медицинский для весов КП-СВ-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**



1. Назначение и конструкция

Антивибрационный стол для весов используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для размещения аналитического весового оборудования, при высокоточном взвешивании реактивов и материалов используемых при проведении диагностических и исследовательских работ. Столы для весов спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Материал столешницы – постформинг или ламинированная ДСП или керамика и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на стол для весов КП-СВ-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде

1. Стол для весов – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Стол поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте стол, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид



6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Сушка медицинская для посуды КП-СДП.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

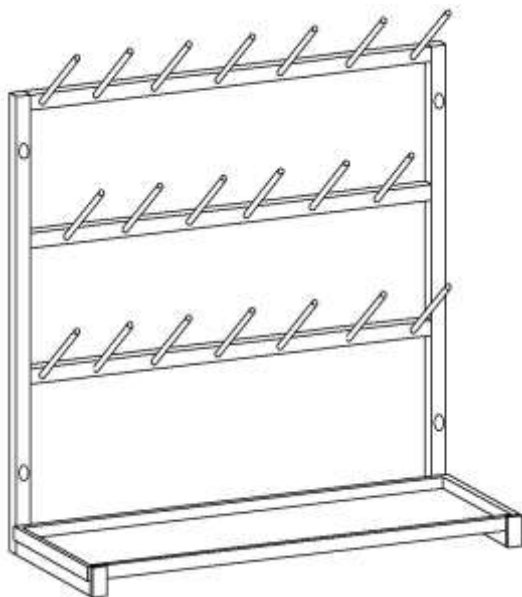

1. Назначение и конструкция

Сушка для посуды используется для оснащения клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначена для естественной сушки лабораторной посуды, медицинских инструментов и иных предметов после мойки. Может исполняться как в настенном варианте, а также в настольном, как дополнение к шкафу для мойки. Сушка для посуды спроектирована в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Каркас сушки, колбодержатели и сливной лоток изготавливаются из стали с полимерным покрытием, либо в качестве несущего материала может быть использован химически стойкий полипропилен. «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на шкаф под мойку КП-ШМ-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Сушка для посуды – 1шт
2. Съёмный лоток – 1 шт.
3. Паспорт – 1шт
4. Упаковка

5. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте сушку, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения ее состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

6. Общий вид

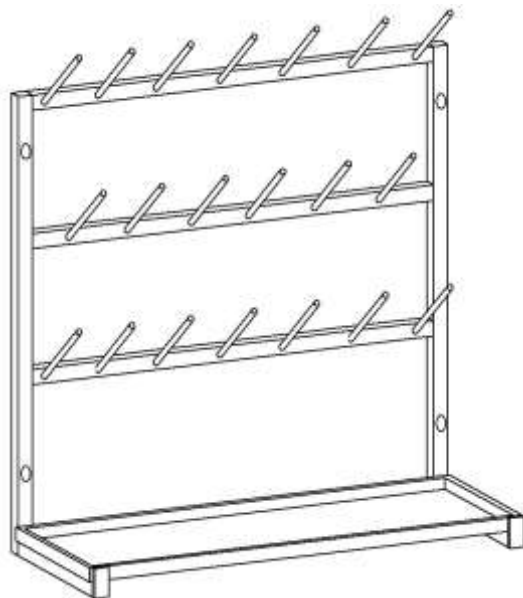

7. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Сушка для посуды должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

**Тумба медицинский подкатная
КП-ТП-Х.Х.Х.**

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

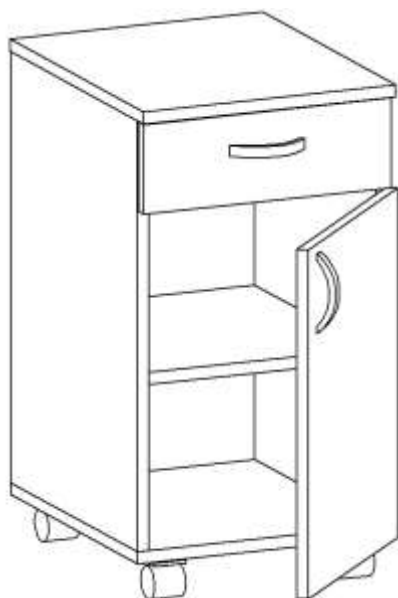

1. Назначение и конструкция

Тумба подкатная используется для оснащения клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Может служить как отдельно стоящий предмет лабораторной мебели, либо в качестве дополнительного элемента к столам лабораторным. Предназначена для размещения и хранения различного аналитического, измерительного, физиотерапевтического оборудования и другой аппаратуры, принадлежностей и медицинского инструментария, используемой при проведении диагностических и исследовательских работ. Конструкция тумбы позволяет оперативное перемещение к необходимому на данный момент месту. Тумба подкатная спроектирована в соответствии с ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Столешницы, полки, стенки стола изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на тумбу подкатную КП-ТП-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Тумба подкатная – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Тумба поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте тумбу, освободите ее от упаковочного материала.
2. Осмотрите тумбу подкатную для определения ее состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

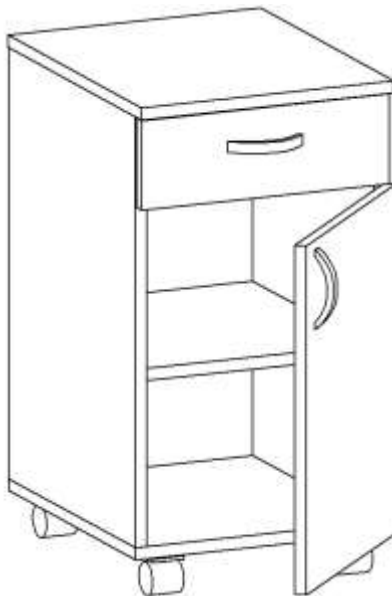

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Тумба должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Тумба медицинский стационарная КП-ТС-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

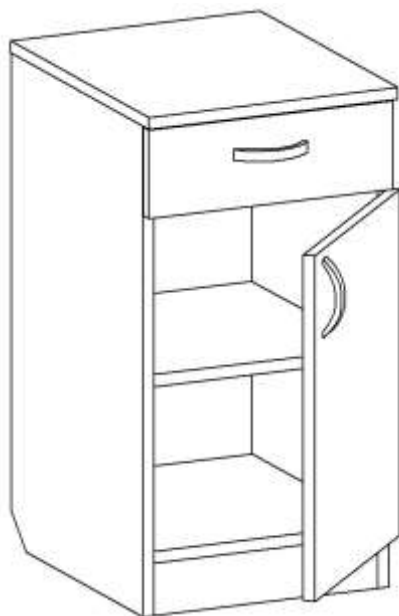

1. Назначение и конструкция

Тумба используется для оснащения клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Может служить как отдельно стоящий предмет лабораторной мебели, либо в качестве дополнительного элемента к столам лабораторным. Предназначена для размещения и хранения различного аналитического, измерительного, физиотерапевтического оборудования и другой аппаратуры, принадлежностей и медицинского инструментария, используемой при проведении диагностических и исследовательских работ. Тумба спроектирована в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Столешницы, полки, стенки стола изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства».

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на тумбу стационарную КП-ТС-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Тумба стационарная – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Тумба поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте тумбу, освободите ее от упаковочного материала.
2. Осмотрите тумбу стационарную для определения ее состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

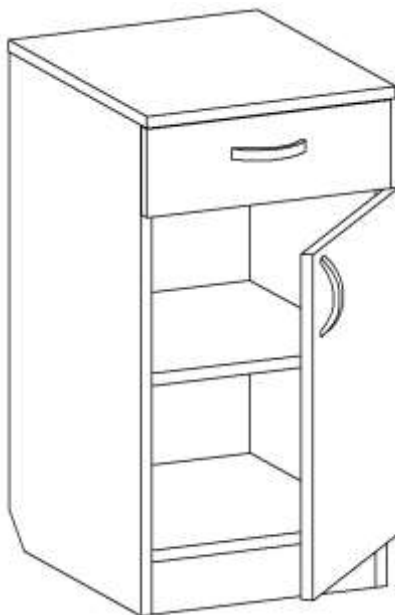

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Тумба должна эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

П А С П О Р Т

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ВЫТЯЖНОЙ

КП-ШВ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ГОСТ 16371-2014

1. Инструкция по эксплуатации.

1.1 Вытяжные шкафы предлагают решение, представляющее собой конструкционную инновацию технологии вытяжных шкафов, обеспечивающую защиту от вредных химических паров в широком диапазоне фронтальных скоростей, а также удобство работы, благодаря эргономичному дизайну и простоте в эксплуатации.

Конкретная комплектация под индивидуально заказчика зависит от:

- требований к постановке анализа;
- общего количества анализов выполняемых лабораторией;
- параметров помещения;
- финансовых возможностей;
- общего комплекта мебели для данной лаборатории и принципов её размещения.

Шкаф вытяжной предназначен для работы с вредными веществами, состоит из следующих основных частей:

- верхней секции (рабочая камера)
- нижней секции (основание - тумба с дверями, два отделения, съёмная полка)

Верхняя часть устанавливается на тумбу сверху без дополнительного крепления.

1.2 На рабочей поверхности внутри верхней секции в нижней части (слева) устанавливается следующее оборудование (по согласованию с Заказчиком): шаровой кран для холодной воды расположенный на задней стенке шкафа с комплектом для подключения (экран, шайба-1шт М24, пластина фиксирующая, мет.хромир.переходник-25мм, армированный гибкий шланг длиной 1000мм ½" для подвода воды (М+М), сифон пластмассовый одинарный без перелива с отводом и нержавеющая раковина для слива в рабочей столешнице размером (265x162мм) глубиной 100мм. (В данной конструкции шкафа возможна установка 2-х кранов (холодная/горячая) вода по дополнительному заказу).

1.3 Рабочая камера оборудуется электроблоком 220 В $\pm$ 10 %, 6А, на котором установлены две розетки и выключатель освещения, автоматом аварийного отключения на 16 А с монтажной коробкой/клемником и проводом дл.3м с эл. вилкой разборной (Европейский стандарт) для подключения к эл.снабжению, которые расположены на задней стенке шкафа. Конструкция электроблока обеспечивает возможность технологического заземления.

В верхней зоне рабочей камеры располагается светильник под лампу накаливания не более 60 Вт. или светильник дневного освещения, обеспечивающий освещенность рабочей поверхности не менее 75 люкс.

1.4 Доступ в рабочую камеру осуществляется путем поднятия передней рамы. Подъем стекла закаленного «STALINIT» толщиной 5 мм осуществляется за ручки в конструкции движения по деревянным направляющим в пазах с помощью металлических противовесов, расположенных за задней стенке шкафа, которые обеспечивают фиксацию стекла в любом положении. При не полном опускании экрана действует внешняя система воздушных потоков, чтобы обеспечить верхнюю конвекцию воздушных масс и увеличить потери тепла в зоне рабочей столешницы.



Противовесы дм.60мм крепятся через крючки М10 на металлическом тросе 2 мм с полипропиленовым покрытием.

Трос надевается на установленные на верхней крышке рабочей камеры ролики (4шт) и продевается через отверстия в закаленном стекле.

1.5 Воздуховод (фланец дм.150мм (возможные диаметры от 100,125,150мм)) вытяжного шкафа для отсоса вредных веществ расположен в верхней крышке рабочей камеры по центру, а также в нижней конструкции шкафа-боковой части (слева) (в данной конструкции шкафа устанавливается по дополнительному заказу). К магистральному воздуховоду шкаф подсоединяется через фланец с помощью гибких алюминиевых воздуховодов с высокими аэродинамическими и прочностными характеристиками (гофры дм.150мм (возможные диаметры от 80 до 315мм)) длиной 3м с хомутами-2шт для крепления) (в данной конструкции шкафа устанавливаются по дополнительному заказу)

Возможна установка на верхней крышке рабочей камеры шкафа центробежно-осевого канального вентилятора с защитной сеткой (напряжение при 50 Гц 220-240В, мощность 24-60Вт, частота вращения 2400об/мин, приток воздуха 98-295м³/час, давление 35-80Па, уровень шума 34-41дБ, 3м (в данной конструкции шкафа устанавливаются по дополнительному заказу).

1.6 Конструкция шкафа позволяет устанавливать его вплотную к стене. Основание шкафа имеет регулируемые по высоте опоры ПНД, которые позволяют выставить «горизонтالي» вытяжного шкафа по уровню пола до 50 мм.

Прочная металлоконструкция каркаса под нижней тумбой изготавливается из стальных труб квадратного сечения, покрытых порошковой эпоксидной краской, отвержденной в печи. Антибактериальное гибридное полиэфирное порошковое покрытие обеспечивает долговременную химическую и износостойкость.

1.7 Рабочая поверхность (столешница) верхней секции изготовлена (по выбору заказчика) из влагостойкого меламина покрытого хим.стойким пластиком высокого давления "lamine SLTTEX LAB Н" или покрыта «TRESPA TopLab» изготовленной из термически закаленных синтетических пигментированных смол толщиной 10 или 13мм, а также полированной нержавеющей сталью толщ. 0,8-1мм с алюминиевым уголком по контуру столешницы.

Рабочая поверхность шкафа может быть облицована керамической антикислотной ГРЭСС плиткой (керамогранит) размером 300х300мм (не глазурированной) толщиной 9-10мм с пластмассовым уголком 9мм по контуру столешницы. Швы между плитками заделываются водоотталкивающей противогрибковой фугой Ceresit. Также возможна установка цельной керамической антикислотной плитой размером 1200х600мм (не глазурированной) толщиной 10-12мм различной цветовой гаммы (в данной конструкции шкафа устанавливаются по дополнительному заказу). Все зазоры и стыки в верхней секции шкафа на рабочей поверхности на рабочей столешнице обработаны непрозрачным силиконом (герметиком), обладающим отличной сцепляемостью и водостойкостью.

1.8 Корпус вытяжного шкафа изготовлен из ламинированной ДСП толщиной не менее 18мм. Все лицевые поверхности оклеены ударопрочной и влагостойкой кромкой ПВХ "REHAU"- толщ. 2мм. На торцевых поверхностях остальных деталей наклеена меламиновая кромка.

2. Технические характеристики.

Мощность отсоса - 1000 куб.\ч. (при подключении к магистральному воздуховоду)

Скорость воздуха в рабочей камере - 0,3 м\с

Кратность обмена воздуха раб. пространства - 600

Габаритные размеры: длина – 900 (944), 1200(1246), 1500(1546), 1800(1888) мм

ширина – 718, 800, 850 мм

высота – 2100, 2200, 2350 мм

В скобках указаны размеры шкафов с рабочей столешницей облицованной керамической плиткой ГРЭСС.

Рабочее напряжение - 220 В.

Частота - 50 Гц.

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации) шкаф вытяжной - 1 шт

Раковина из нержавеющей стали - 1 шт (при установке самостоятельно швы заделать силиконом/герметиком)

Шаровый кран - 1 шт

Экран - 1шт

Пластина фиксирующая – 2шт

Мет.хромир.переходник-20мм – 1шт


Армированный гибкий шланг длиной 1000мм ½" для подвода воды (М+М) – 1шт


Сифон пластмассовый одинарный без перелива с отводом – 1шт

Металлокаркас (цельносварной) 550х140 на 860/1160/1460 – 1шт


Регулируемая опора ПНД дм.50мм – 6шт, 4шт (шкафы на 900)
 Ручка-скоба мебельная L-96 – 5шт, 4шт (шкафы с 2-мя дверями на 900)
 Петля мебельная с проводником накладная – 6шт, 4шт (шкафы с 2-мя дверями на 900)
 Розетка с заземлением - 1 шт
 Розетка без заземления- 1 шт
 Выключатель - 1 шт
 Рамка 3-х местная к электроблоку – 1шт
 Клемник -1шт
 Заглушка мебельная пластм. для евростяжек/конфирмат – 120шт
 Евровинт конфирмат 7х50 – 120шт
 Монтажная коробка к клемнику -1 шт
 Электровилка – 1шт
 Провод 3-х жильный -3м
 Гофрированный шланг для эл.проводки дм.16мм - 2,5м
 Автомат аварийного отключения 16А (25А) – 1шт
 Коробка к автомату отключения – 1шт
 Противовес мет. с крючками - 2 шт
 Ролики для троса - 4шт
 Тросс 3мм с полипропиленовым покрытием по 2,5м - 2шт
 Стекло закаленное Сталилит 6мм с отв. (805 на 814/1116/1416) -1шт
 Брусok деревянный с пазом 1165х60х30 – 2шт
 Скоба монтажная круг 6А – 28шт
 Электросветильник ПСХ - 1шт
 Лампа накаливания 60Вт – 1шт
 Плитка 30х30 ГРЭСС – 6шт, 8шт, 10 шт, 12шт (шкафы на 900, 1200, 1500, 1800 керамика)
 Уголок пластм. д/плитки внутренний 9мм – 5 м, 6м, 7м, 10м (шкафы на 900, 1200, 1500, 1800 керамика)
 Шурупы/саморезы и шканты дер. (в ассортименте по типу/размеру) – 34шт/88шт
 Провода (в ассортименте по типу/размеру)
 Меламиновая кромка, кромка ПВХ 2мм (в ассортименте по типу/размеру)
 Патрубок вентиляционный/фланец дм.150мм – 1шт
 Краткое описание - 1 шт
 Верхняя секция (рабочая камера) – 1шт
 Нижняя секция (основание) - 1 шт (с 2-мя дверями или 3-мя, съёмная полка)

4. Чертежи верхней секции (рабочей камеры) и нижней секции (основание) для вытяжных шкафов

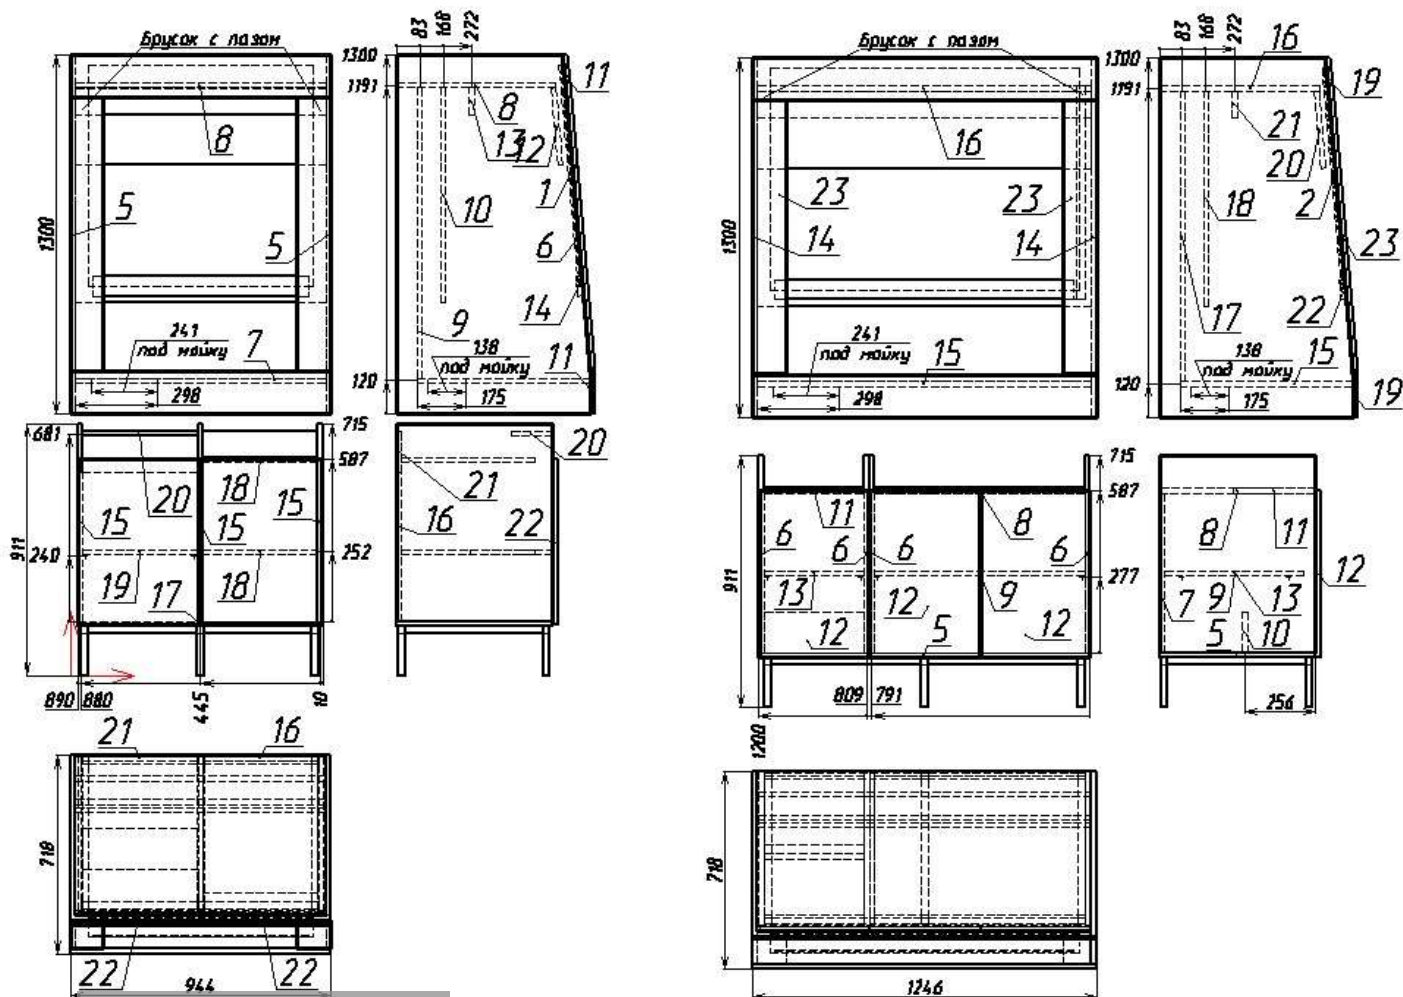

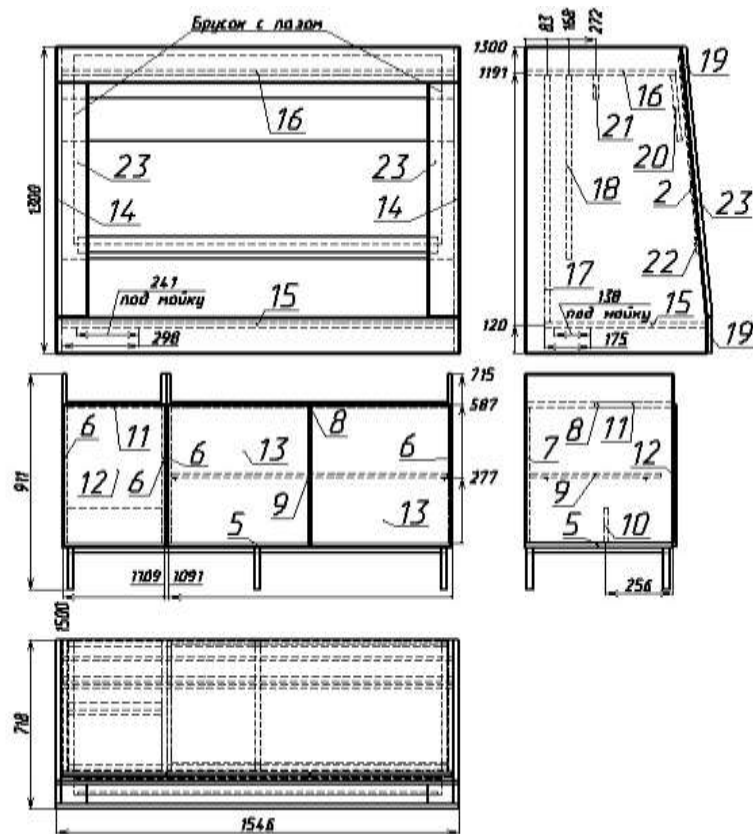

5. Общий вид вытяжных шкафов

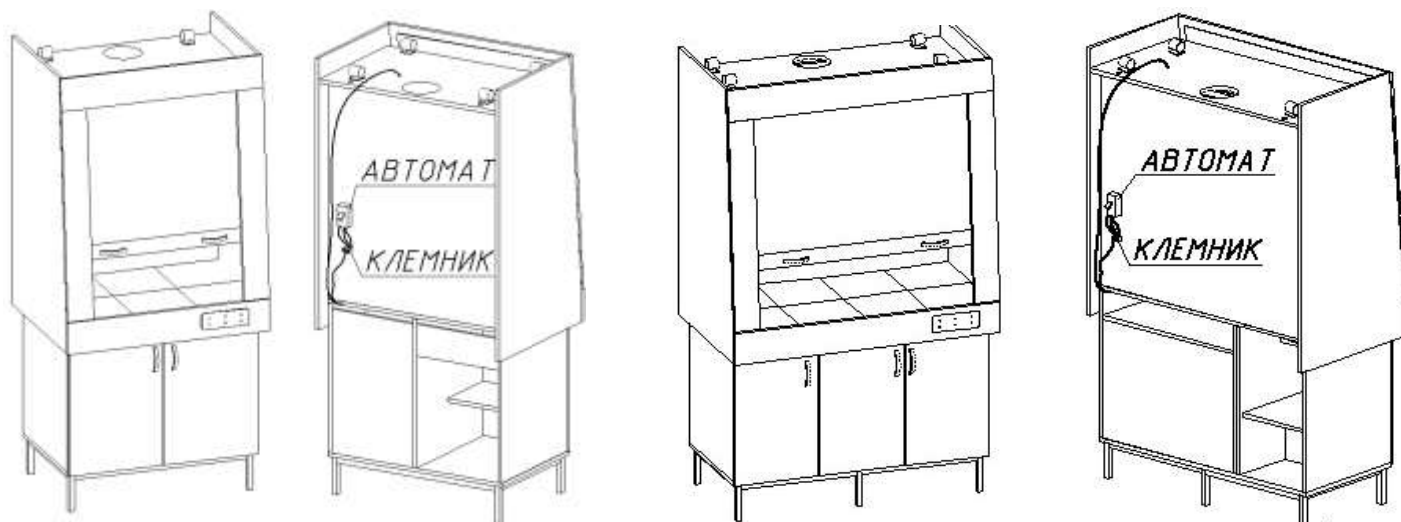

6. Спецификация составных панелей вытяжных шкафов

Заказ: Спецификация на ДСП 18

Изделие: Шкаф вытяж. с/р. ДСП-ШВТ-31 1540x710x2100

Поз	Наименование	Кол-во	Длина (L)	Ширина (W)	Кромка(L/W)
5	Стойка	2	1300	700	ЧЕРТЕЖ
6	Фасад	2	215	565	L, L/W, W
7	Столешница	1	920	626	L, L**
8	Кромка	1	920	577	L, L**
9	Стойка	1	1063	908	L, L**
10	Стойка	1	780	500	***W, L
11	Фасад	2	150	565	L, L/W, W
12	Фасад	1	290	500	***W, L
13	Стойка	1	100	500	***W, L
14	Фасад	1	215	565	L, L/W, W, PAX 40x63
15	Стойка	3	215	565	L, L/W, W
16	Зашита	1	690	617	***W, L
17	Панель	1	830	565	L, L/W, W
18	Панель	2	617	617	L, L**
19	Панель	1	617	565	L, L/W, W
20	Панель	1	617	565	L, L/W, W
21	Фасад	1	150	617	***W, L
22	Фасад	2	617	617	L, L/W, W, PAX 40x63

1 - Кромка(0,4mm)
2 - ПВХ 2/22(2mm)

Заказ: Спецификация на ДСП 18

Изделие: Шкаф вытяж. с/р. ДСП-ШВТ-32 1210x710x2100

Поз	Наименование	Кол-во	Длина (L)	Ширина (W)	Кромка(L/W)
5	Панель	1	500	565	L, L/W, W
6	Стойка	4	215	565	L, L/W, W
7	Зашита	1	578	763	L, L**
8	Панель	1	565	565	L, L**
9	Панель	1	760	500	L, L/W, W
10	Стойка	1	950	565	***W, L
11	Панель	1	565	100	L, L**
12	Фасад	3	215	565	L, L/W, W
13	Панель	1	565	500	L, L/W, W
14	Стойка	2	1300	700	ЧЕРТЕЖ
15	Столешница	1	1210	626	L, L**
16	Кромка	1	1210	577	L, L**
17	Стойка	1	1053	918	L, L**
18	Стойка	1	780	520	***W, L
19	Фасад	2	215	565	L, L/W, W
20	Фасад	1	290	520	***W, L
21	Стойка	1	100	520	***W, L
22	Фасад	1	215	565	L, L/W, W, PAX 40x63
23	Фасад	2	565	565	L, L/W, W

1 - Кромка(0,4mm)
2 - ПВХ 2/22(2mm)


Заказ: Спецификация на ДСП 18

Изделие: Шкаф вытяж. с/р. ДСП-ШВТ-33 1540x710x2100

Поз	Наименование	Кол-во	Длина (L)	Ширина (W)	Кромка(L/W)
5	Панель	1	500	565	L, L/W, W
6	Стойка	4	215	565	L, L/W, W
7	Зашита	1	578	9063	L, L**
8	Панель	1	565	565	L, L**
9	Панель	1	760	500	L, L/W, W
10	Стойка	1	950	565	***W, L
11	Панель	1	565	100	L, L**
12	Фасад	1	690	565	L, L/W, W
13	Фасад	2	617	617	L, L/W, W
14	Стойка	2	1300	700	ЧЕРТЕЖ
15	Столешница	1	1540	626	L, L**
16	Кромка	1	1540	577	L, L**
17	Стойка	1	1053	918	L, L**
18	Стойка	1	780	520	***W, L
19	Фасад	2	215	565	L, L/W, W
20	Фасад	1	290	520	***W, L
21	Стойка	1	100	520	***W, L
22	Фасад	1	215	565	L, L/W, W, PAX 40x63
23	Фасад	2	565	565	L, L/W, W

1 - Кромка(0,4mm)
2 - ПВХ 2/22(2mm)

7. Схема подключения крана шарового

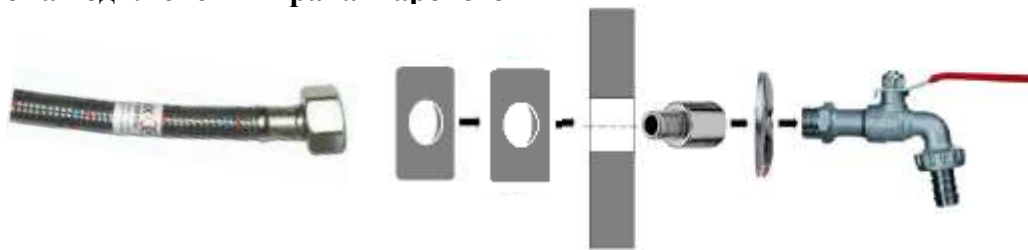

Порядок сборки крана шарового для установки:

1. Установить экран/отражатель на кран шаровый (со стороны резьбового соединения) – загнуть фиксаторы.
2. Подсоединить переходник хром. дл.20мм.
3. Вставить кран с переходником в отверстие задней. стенки шкафа с внутренней стороны рабочей камеры.
4. Надеть на переходник 2 (две) фиксирующие пластины (нерж.сталь толщиной 0,8мм).
5. Присоединить армированный шланг дл.1м. (зажать до упора с помощью рожкового ключа).

Рекомендуется для монтажа использовать «фум-ленту».


Резьбоуплотнительная лента «ФУМ» изготавливается из не спеченной фторопластовой пленки, используется для уплотнения резьбовых соединений в условиях агрессивных сред или сильных окислителей, является химически стойким, самосмазывающимся набивочным и прокладочным материалом. Лента ФУМ отличается легкостью, удобством монтажа, повышенной химической, термической устойчивостью, высокой уплотняющей способностью, а также неограниченным сроком хранения.

8. Схема организации реверсивного воздушного потока в вытяжных шкафах серии «ЛАБ» производства ООО «КронаПлит»

Вытяжные шкафы производства ООО «КронаПлит» относятся к наиболее массовой (по их применению) группе вытяжных шкафов с **контуром вытяжки открытого типа**. В них обеспечение безопасности рабочей зоны и работающего персонала осуществляется за счет **постоянного принудительного отсоса воздуха и притока из открытой рабочей камеры вытяжного шкафа** с последующим выбросом его через систему вентиляции в атмосферу вне помещения лаборатории.

Воздушный поток поступает в рабочую камеру с различной скоростью через открытую переднюю часть шкафа, после чего проходит через предварительный переходник (фланец дм.от 150мм) и далее, с помощью принудительной вентиляции, по вентиляционным коробам направляется в воздух окружающего пространства.

При закрытом переднем защитным экране воздух не может проникнуть в рабочую камеру вытяжного шкафа, что не позволяет осуществить необходимую циркуляцию воздушных потоков.

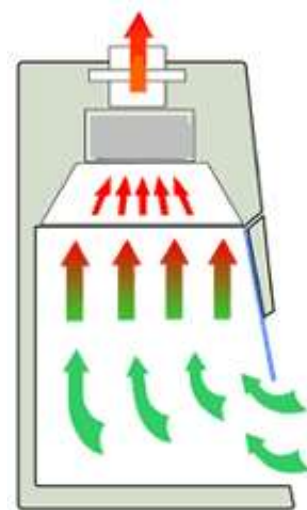

9. Требования к установке вытяжных шкафов

- Надлежащие размещение (смотрите рекомендации компании «КронаПлит»)
- Вытяжная система должна отвечать требованиям по отводу воздушного потока и перепаду давления
- Система вытяжных каналов и приспособления для подсоединения
- Вытяжной вентилятор (или вытяжная система здания)
- Контактор (если применяется)
- Средства регулирования вытяжного потока (заслонка или частотный инвертор)
- Достаточный приток воздуха в лабораторию
- Подставка-тумба под шкаф или другая опора


Если не указано иное, вышеизложенные пункты не выполняются компанией «КронаПлит»

10. Схема установки стекла СТАЛИНИТ 6мм в вытяжной шкаф производства ООО «КронаПлит»

1. Снять верхнюю лицевую панель.



2. Аккуратно установить стекло в пазы направляющих брусов.




Вид сверху
со снятой крышкой

3. Установить на место верхнюю лицевую панель.



4. Подвесить противовесы, пропустив металлический трос через пазы в роликах

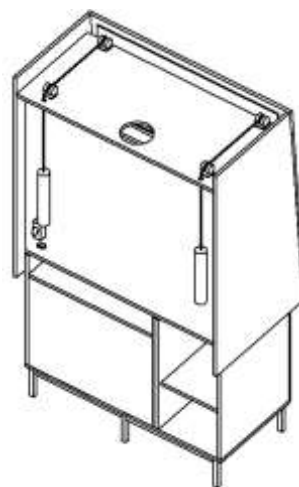

11. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220013, г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 37, пом. 16, офис 1
тел./факс: (017) 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: г. Минск, ул. Якуба Коласа, д. 37, пом. 16, офис 1

В изделиях «Шкаф вытяжной КП-ШВ-3.0.2» ГОСТ 16371 устанавливается однополюсный автомат отключения ВА 47-29-1 С-32 230/400 50Гц 4500 16А, ГОСТ Р503 45-99 (наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3 - 0,5).

10. Гарантийный талон

заполняется производителем или торговым представителем

Дата отгрузки/продажи _____

(число, месяц, год)

Изготовитель/продавец _____

(подпись или штамп)

Штамп организации

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский для документов КП-ШД-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

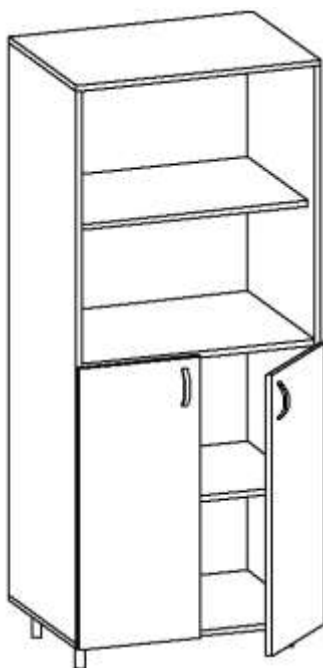

1. Назначение и конструкция

Шкаф для документов используется для оснащения клинично-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для размещения и хранения различного рода медицинских документов, бланков, архивов медицинских записей и карточек, с результатами исследований и анализов. Он помогает упорядочить бумажный поток, повысить оперативность поиска нужной информации, сделать доступ к документам более удобным. Шкафы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа, двери, полки изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на шкаф для документов КП-ШД-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Шкаф для документов – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

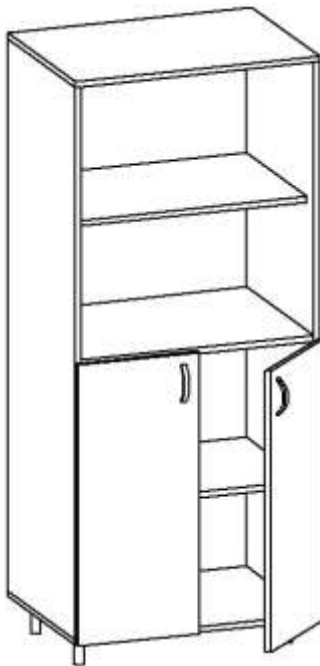

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский для инвентаря КП-ШИ-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

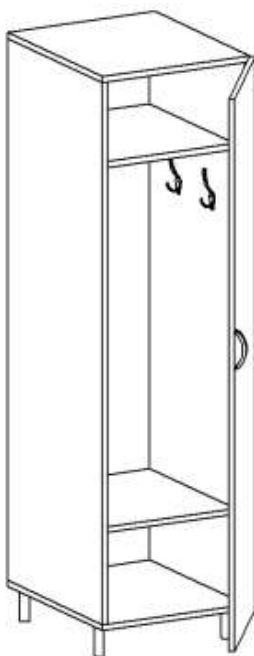

1. Назначение и конструкция

Шкаф для инвентаря используется для оснащения клинично-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для хранения медицинских инструментов, принадлежностей, моющих и дезинфицирующих средств, сопутствующих материалов. Обеспечивает чистоту, стерильные условия хранения. Шкафы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа, двери, полки изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Шкаф для инвентаря – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

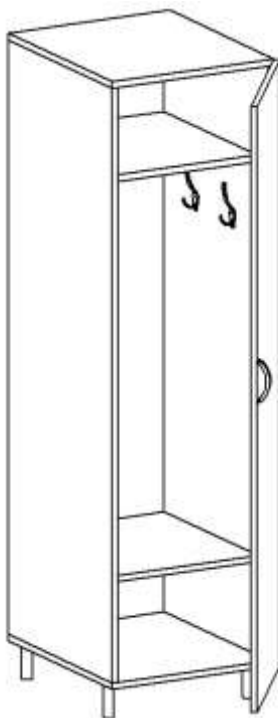

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский для одежды КП-ШО-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

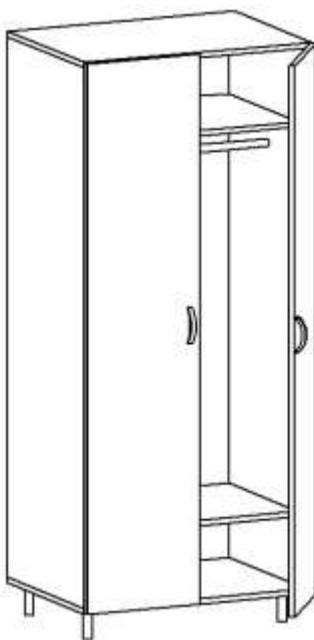

1. Назначение и конструкция

Шкаф для одежды используется для оснащения клинично-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для раздельного хранения личной (верхней) и рабочей (санитарной/стерильной) одежды медицинского персонала. Служит для соблюдения санитарно-гигиенических норм работниками медучреждений. Шкафы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа, двери, полки изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на шкаф для одежды КП-ШО-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Шкаф для одежды – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

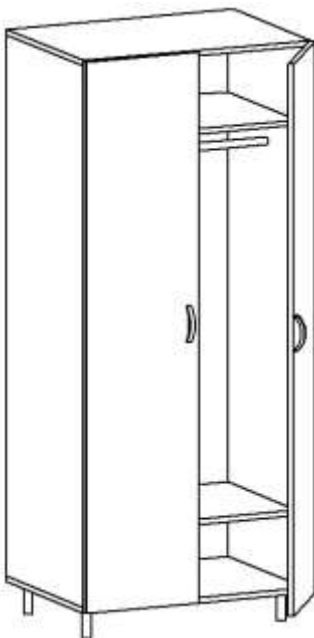

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский для посуды КП-ШП-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

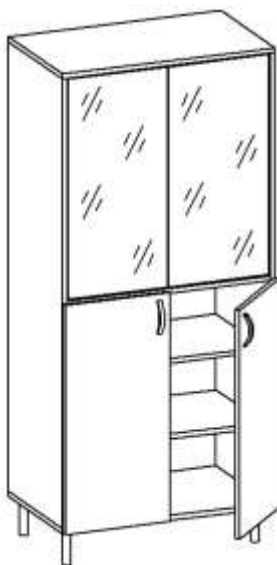

1. Назначение и конструкция

Шкаф для посуды используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для хранения лабораторной посуды и принадлежностей используемых при проведении диагностических и исследовательских работ. Шкафы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа, двери, полки изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18 мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на шкаф для посуды КП-ШП-Х.Х.Х. разработаны **ООО «КронаПлит»**.

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде

1. Шкаф для посуды – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид



6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский для приборов КП-ШПР-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

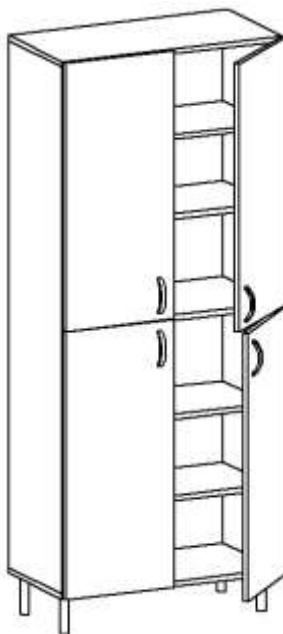

1. Назначение и конструкция

Шкаф для приборов используется для оснащения клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для хранения медицинских инструментов и приборов. Внутри изделия помещают медицинские инструменты, которым обеспечивается чистота, стерильные условия хранения. Шкафы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа, двери, полки изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на шкаф для приборов КП-ШПР-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Шкаф для приборов – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

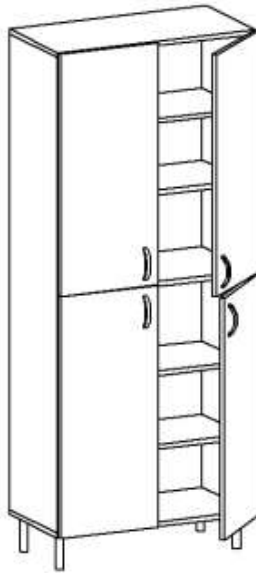

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

6.1 Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.

6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский для реактивов КП-ШР-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

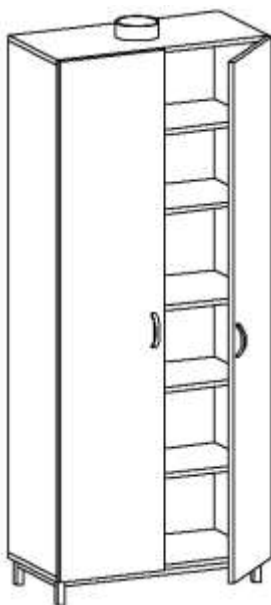

1. Назначение и конструкция

Шкаф для реактивов используется для оснащения клиничко-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для хранения медицинских препаратов, химических летучих реактивов, предохраняет медицинский персонал от воздействий химических паров и щелочных и кислотных испарений. Внутри изделия помещают медицинские инструменты, которым обеспечивается чистота, стерильные условия хранения. Шкафы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа, двери, полки изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей пищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на шкаф для реактивов КП-ШР-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Шкаф для реактивов – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

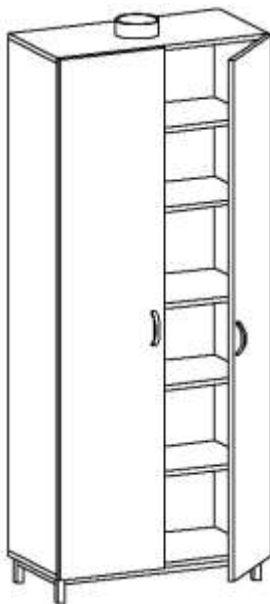

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)


Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский навесной КП-ШН-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**

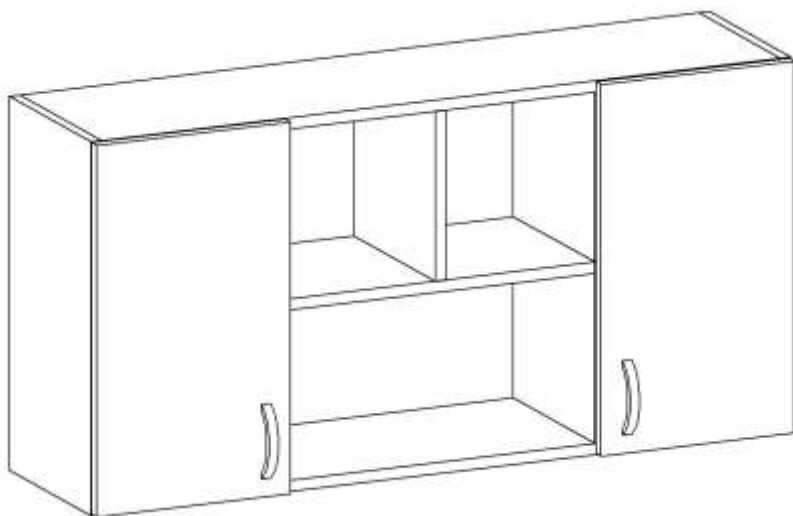

1. Назначение и конструкция

Шкаф навесной используется для оснащения клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для удобного настенного хранения лабораторной посуды, принадлежностей, реактивов и препаратов, используемых при проведении диагностических и исследовательских работ. Шкафы спроектированы в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа, двери, полки изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18 мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде


1. Шкаф навесной – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите шкаф для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид

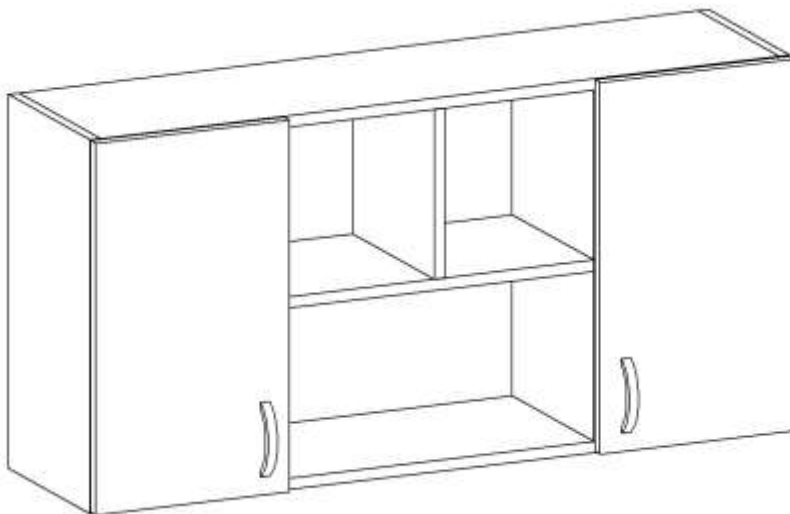

6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

7. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Изготовитель: **ООО «КронаПлит»**, 220090, г. Минск, ул. Якуба Колоса, д. 37, пом. 16, офис 1

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня продажи.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращаться по адресу: 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. 40 лет Победы, д.21

тел./факс: +375 17 510-65-31

Гарантийные обязательства

заполняется производителем или торговым представителем

Дата изготовления _____
(месяц, год)

Изготовитель/продавец _____
(подпись и штамп)

Штамп организации

П А С П О Р Т

Шкаф медицинский под мойку КП-ШМ-Х.Х.Х.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ГОСТ 16371-2014 ТО ВУ 191630968.001-2019**



1. Назначение и конструкция

Шкаф под мойку используется для оснащения клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораторий учреждений здравоохранения. Предназначен для мытья лабораторной посуды и иных предметов от загрязнений реактивами, химическими растворами, эмульсиями, суспензиями, жиром, медицинских инструментов после проведения исследований. Шкаф под мойку спроектирован в соответствии с ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

2. Технические характеристики

Корпус шкафа под мойку, двери, изготовлены из ДСП ламинированной толщиной 18 мм и соответствуют ГОСТ 10632 – 89 «Плиты древесностружечные. Технические условия» п.п.1.6; 1.8; ГН 2.6.4.10-12001 «Республиканские допустимые уровни содержания Цезия-137 в древесине, продукции из деревянных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства»

Материалы, фурнитура, метизы приобретены в торговой сети на предприятиях Республики Беларусь производства РБ, стран СНГ, а также импортного производства.

Конструкторская документация и техническое описание на шкаф под мойку КП-ШМ-Х.Х.Х. разработаны ООО «КронаПлит».

3. Комплектность поставки (в базовой комплектации)

Изделие поставляется в собранном виде

1. Шкаф под мойку – 1шт
2. Паспорт – 1шт
3. Упаковка

4. Подготовка изделия к работе

Шкаф поставляется потребителю собранным и упакованным

1. Распакуйте шкаф под мойку, освободите его от упаковочного материала.
2. Осмотрите для определения его состояния после транспортировки и хранения.
3. Выполните влажную санитарную обработку.

5. Общий вид



6. Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность и долговечность мебели зависит не только от её качества, но и от правильного пользования и ухода за ней.

- 6.1 Шкаф под мойку должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 6.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.