Номер изделия: I01SOL01 250 мл

ВНУТРЕННИЙ ЭТАЛОННЫЙ СТАНДАРТ IONOREF

Предусмотренное применение

IonoRef – запатентованный эталонный раствор, предназначенный для анализатора электролитов Ionix. Раствор поставляется в 250 мл флаконе с защитным ключом.
Данный раствор используется для:

- двухточечной калибровки,
- одноточечной калибровки, осуществляемой при каждом измерении образца,
- цикла рециркуляции, автоматически выполняемого в режиме ожидания.

Содержание упаковки

- Флакон 250 мл
- Готовый к использованию реагент
- Защитная заглушка

Состав

Компонент	Концентрация
Неорганические соли	< 5%
Поверхностно-активные вещества	< 1%
Консервант	< 0,5%

Стабильность

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- При работе с реагентами использовать надлежащую лабораторную практику (НЛП).

Ликвидация отходов

Утилизировать пустой флакон в соответствии с местными требованиями.


Использование

- Установить флакон внутрь Ionix, как описано в руководстве пользователя, стр. 2-23.
- Взять защитный ключ, находящийся в прикрепленной к флакону сумке, и установить его, как показано на рисунке.




- В главном меню нажать кнопку [SERVICE].


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

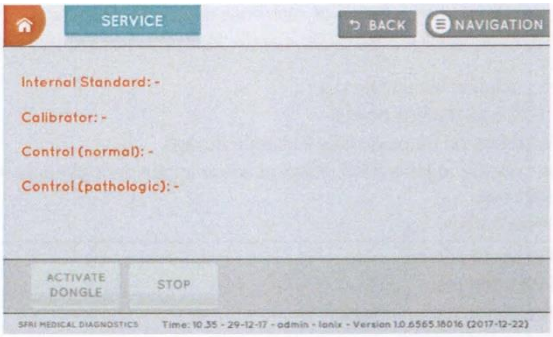

- После установки защитного ключа активируется кнопка [Activate Dongle].

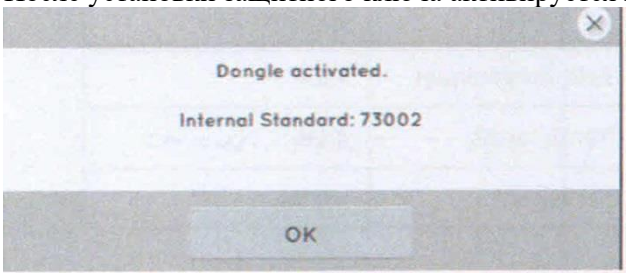

- Нажать клавишу [ACTIVATE DONGLE]. Данные загружаются из защитного ключа в Ionix, и отображается сообщение для подтверждения активации с номером партии. Если отображается сообщение об ошибке, повторить операцию.
- Теперь новый внутренний эталонный стандарт готов к использованию.

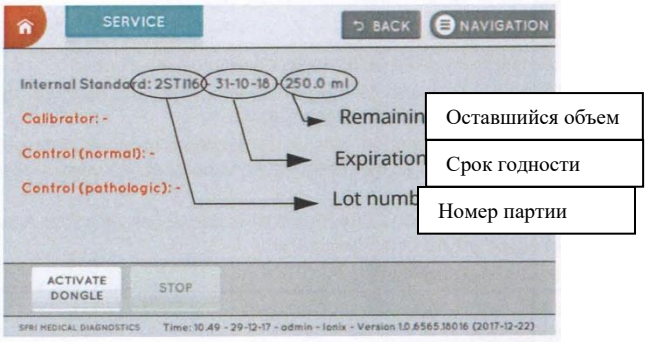

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01SOL02 1x60 мл

IONOREAG TCO_2

Предусмотренное применение

Реагент, используемый для измерения общего количества CO_2 (tCO_2)[1] с помощью Ionix.

Содержание упаковки

- 1 флакон объемом 60 мл.
- Маркированная пустая пробирка
- Готовый к использованию реагент

Состав

Компонент	Концентрация
Органический буферный раствор	< 5%
Неорганические соли	< 1%
Консервант	< 0,5%

Стабильность

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой.
- При работе с реагентами придерживаться надлежащей лабораторной практики (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование

Установка


1. Открутить крышку реагента

2. Снять крышку

3. Установить колпачок с соединениями на бутылку реагента

4. Установить наконечник Луэр с трубкой (повернуть на четверть оборота, не зажимая слишком сильно).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

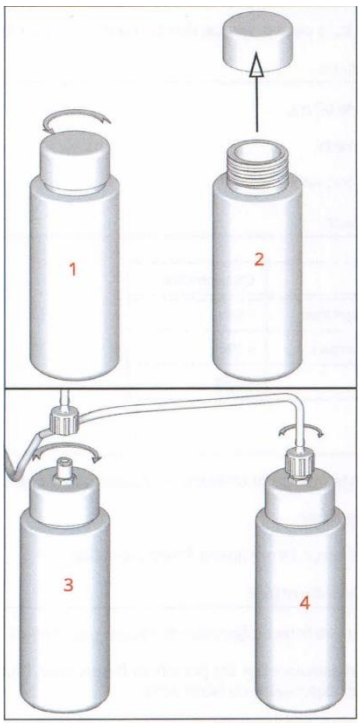

Активация реагента
На навигационной панели в сервисном меню выбрать [Reagents], поместить маркированную пустую пробирку на штатив таким образом, чтобы штрих-код был обращен к задней панели прибора, затем нажать кнопку [Scan Lactic Acid] для приборов с устройством для считывания штрих-кодов. Для приборов, не оснащенных данным устройством, нажать [Type Lactic Acid] и ввести код, напечатанный на наклейке пробирки.

Номер партии и срок годности отображаются в поле <lactic acid>.

Перед использованием новых реагентов необходимо выполнить первое наполнение.

1. Общее содержание CO_2 (tCO_2) в суммарном объеме бикарбонатов и углекислого газа, растворенных в образце.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01KITCO201 1 x 60 мл + 1 x 5 мл

TCO_2KIT

Предусмотренное применение

Набор, используемый для измерения общего количества CO_2 (tCO_2)[1] с помощью Ionix.

Содержание упаковки

- 1 флакон объемом 60 мл (реагент)
- 1 пробирка объемом 5 мл (контроль)
- Маркированная пустая пробирка
- Готовый к использованию реагент

Состав

Компонент	Концентрация
Органический буферный раствор	< 5%
Неорганические соли	< 1%
Консервант	< 0,5%
Бикарбонат (контроль)	30 ± 5 ммоль/л

Стабильность

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой.
- При работе с реагентами придерживаться надлежащей лабораторной практики (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование

Контроль

Выбрать режим, поместить пробирку на штатив этикеткой к задней стенке прибора (если есть устройство считывания штрих-кодов) или ввести код, помеченный в поле id. Ionix распознает образец как контроль CO_2.

Установка реагента


1. Открутить крышку реагента

2. Снять крышку

3. Установить колпачок с соединениями на бутылку реагента

4. Установить наконечник Луэр с трубкой (повернуть на четверть оборота, не зажимая слишком сильно).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

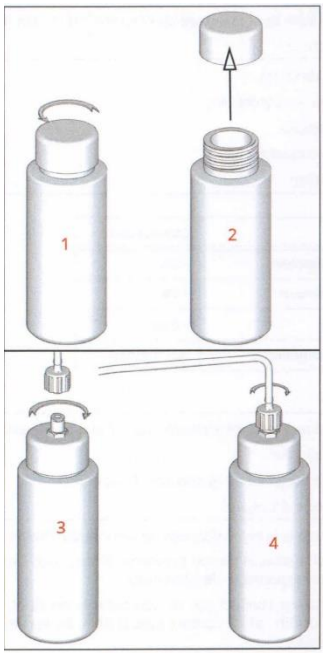

Активация реагента
На навигационной панели в сервисном меню выбрать [Reagents] поместить маркированную пустую пробирку на штатив таким образом, чтобы штрих-код был обращен к задней панели прибора, затем нажать кнопку [Scan Lactic Acid] для приборов с устройством для считывания штрих-кодов. Для приборов, не оснащенных данным устройством, нажать [Type Lactic Acid] и ввести код, напечатанный на наклейке пробирки.

Номер партии и срок годности отображаются в поле <lactic acid>.

Перед использованием новых реагентов необходимо выполнить первое наполнение.

1. Общее содержание CO_2 (tCO_2) в суммарном объеме бикарбонатов и углекислого газа, растворенных в образце.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01KIT01

IONIX IONOKIT

Предусмотренное применение

Ionix pack – набор, содержащий все необходимые для использования анализатора растворы: калибратор (шесть пробирок), контроль (одна пробирка), очиститель (одна пробирка) и натриевый кондиционер (одна пробирка). В комплект также входит защитный ключ, содержащий данные о калибраторе и контроле (номер партии, срок годности, концентрации...). Данный набор содержит различные необходимые растворы, которых достаточно для примерно шести недель работы, независимо от количества испытаний в день.

- Калибратор (IonoCal, номер изделия I01CAL01) используется для двухточечной калибровки,
- Нормальный контроль (IonoTrol normal, номер изделия I01CTL01) используется для контроля качества.
- Очиститель (номер изделия I01CLE01) и кондиционер (номер изделия I01CLE02) используются для планово-профилактического обслуживания.

Содержание упаковки

- 6 пробирок с калибратором по 5 мл, 1 пробирка для других растворов на 5 мл.
- Готовый к использованию реагент
- Защитный ключ

Состав

Компонент	Концентрация
Неорганические соли	< 5%
Поверхностно-активные вещества	< 1%
Консервант	< 0,5%

Стабильность

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- При работе с реагентами использовать надлежащую лабораторную практику (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование

Калибратор и контроль: активация защитного ключа

- Следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, глава 3.4.1 – «Реагенты»

IonoClean, IonoCleanNa

- Профилактическое обслуживание является обязательным, и Ionix будет напоминать об этом пользователям в необходимое время.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, глава 3.4.5 – «Очистка».
- После очистки или кондиционирования необходимо выполнить калибровку. По причине существенного смещения запрещено производить измерения в течение двух часов после профилактического обслуживания.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

	Маркировка CE
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01CTL04 1x5 мл

IONOTROL TCO2

Предусмотренное применение

Набор, используемый для контроля общего содержания CO_2 (tCO_2)[1] с помощью прибора Ionix.

Содержание упаковки

- Пробирка (контроль) 1x5 мл.
- Готовый к использованию реагент

Состав

Компонент	Концентрация
Органический буферный раствор	< 5%
Неорганические соли	< 1%
Консервант	< 0,5%
Бикарбонат (контроль)	30 ± 5 ммоль/л

Устойчивость

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- При работе с реагентами придерживаться надлежащей лабораторной практики (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование

Контроль

Выбрать режим, поместить пробирку на штатив этикеткой к задней стенке прибора (если есть устройство считывания штрих-кодов) или ввести код, помеченный в поле id. Ionix распознает образец как контроль CO_2.

1. Общее содержание CO_2 (tCO_2) в суммарном объеме бикарбонатов и углекислого газа, растворенных в образце.

/Печать:
SFRI SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон 33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824 Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01CTL03 1x5 мл

IONOTROL PATHOLOGIC

Предусмотренное применение

Набор IonoTrol pathological pack представляет собой набор, содержащий патологические контрольные пробирки для анализатора электролитов Ionix, изделие I01CTL03 для одной пробирки объемом 5 мл, и защитный ключ, необходимый для загрузки характеристик (номер партии, срок годности, концентрации…)

- Данный контроль используется для контроля качества.

Содержание упаковки

- Одна пробирка с контролем 5 мл.
- Готовый к использованию реагент
- Защитный ключ

Состав

Компонент	Концентрация
Органический буферный раствор	< 5%
Неорганические соли	< 1%
Консервант	< 0,5%

Устойчивость

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- При работе с реагентами использовать надлежащую лабораторную практику (НЛП).


Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование


Активация защитного ключа

- Взять ключ, входящий в комплект, и вставить его, как показано на рисунке.

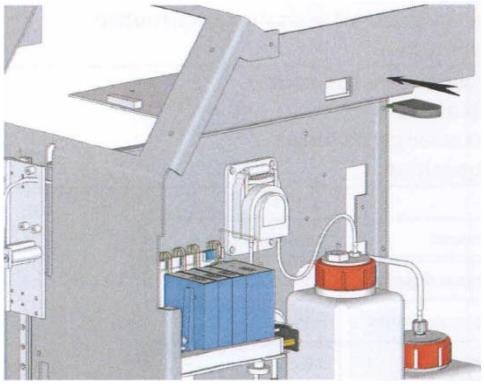


- В главном меню нажать кнопку [SERVICE].

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

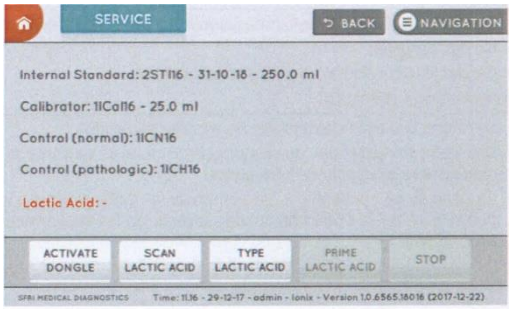

- Отображается состояние реагента
- Нажать клавишу [ACTIVATE DONGLE]. Данные загружаются с ключа на прибор Ionix, после чего выводится сообщение с номером партии для подтверждения активации.

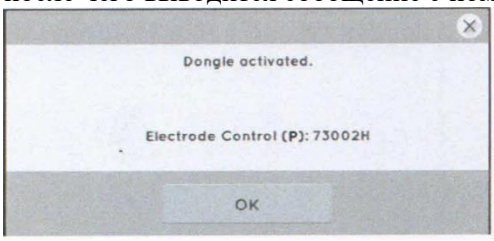

Если отображается сообщение об ошибке, повторить операцию.

- Теперь новый контроль готов к использованию.
- Утилизировать пустые флаконы в соответствии с местными требованиями.

Если остался контроль от предыдущей партии, его можно использовать до тех пор, пока его абсолютный объем не превысит нуля.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01CTL01 1x5 мл

IONOTROL NORMAL

Предусмотренное применение

Набор IonoTrol normal pack представляет собой набор, содержащий нормальные контрольные пробирки для анализатора электролитов Ionix, изделие I01CTL01 для одной пробирки объемом 5 мл, и защитный ключ, необходимый для загрузки характеристик (номер партии, срок годности, концентрации…)
Данный контроль используется для контроля качества.

Содержание упаковки

- 1 пробирка с контролем 5 мл.
- Готовый к использованию реагент
- Защитный ключ

Состав

Компонент	Концентрация
Органический буферный раствор	< 5%
Неорганические соли	< 1%
Консервант	< 0,5%

Устойчивость

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- При работе с реагентами использовать надлежащую лабораторную практику (НЛП).


Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование


Активация защитного ключа

- Взять ключ, входящий в комплект, и вставить его, как показано на рисунке.

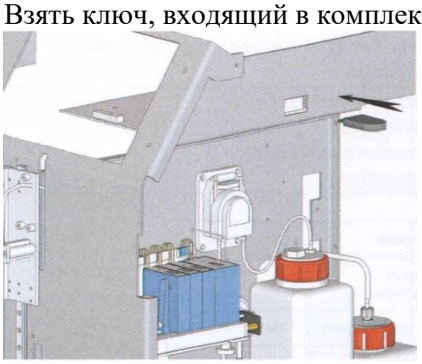


- В главном меню нажать кнопку [SERVICE].

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

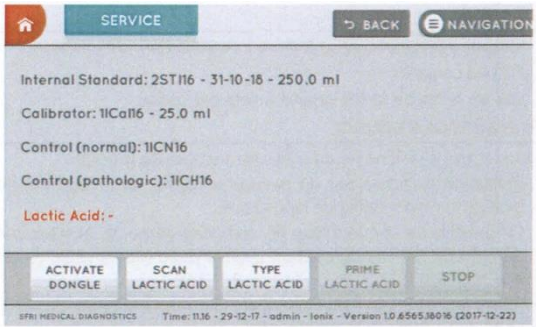

- Отображается состояние реагента
- Нажать клавишу [ACTIVATE DONGLE]. Данные загружаются с ключа на прибор Ionix, после чего выводится сообщение с номером партии для подтверждения активации.
- Если отображается сообщение об ошибке, повторить операцию.

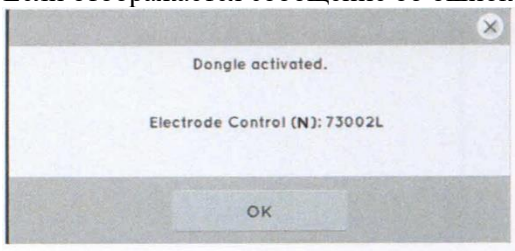

- Теперь новый контроль готов к использованию.
- Утилизировать пустые флаконы в соответствии с местными требованиями.

Если остался контроль от предыдущей партии, его можно использовать до тех пор, пока его абсолютный объем не превысит нуля.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01CLE02 1x5 мл

IONOCLEANNA

Предусмотренное применение

- IonoCleanNa предназначен для кондиционирования электродов в анализаторе электролитов Ionix, номер изделия I01CLE02 для одной пробирки на 5 мл).
- Данный раствор используется для травления мембраны натриевого электрода. Используется при слишком низком наклоне натрия

Содержание упаковки

- 1 пробирка с контролем объемом 5 мл.
- Готовый к использованию реагент
- Защитный ключ

Состав

Фторсоли
Кнсервант

Устойчивость

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- При работе с реагентами использовать надлежащую лабораторную практику (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.


Использование

- С экрана «ROUTINE» перейти к функциям очистки с помощью панели «NAVIGATION».




- Для очистки (натриевая очистка) поместите пробирку с кондиционером в любое положение штатива, этикеткой к задней стенке Ionix, нажмите клавишу [SODIUM CLEANING]. Штатив начинает двигаться и когда будет обнаружена пробирка с очистителем, произойдет запуск процедуры (аспирация очистителя в электроды).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

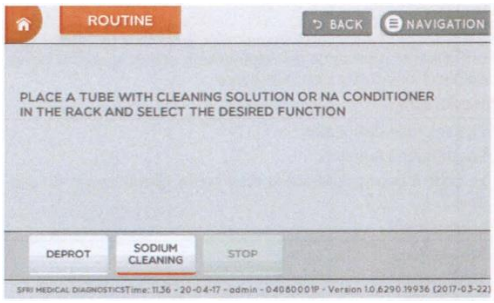

- Индикатор выполнения в верхней части окна показывает статус процедуры.

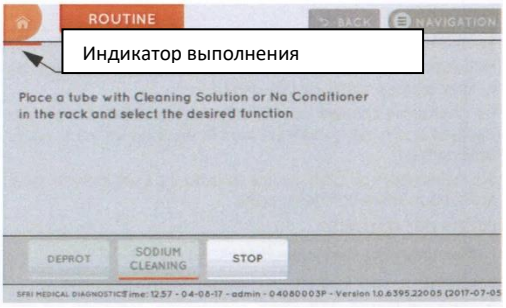

- После травления[1] требуется калибровка. По причине существенного смещения запрещено производить измерения в течение двух часов после профилактического обслуживания.

1. Данная операция важна, в основном для натриевого электрода, но также и для электрода pH и эталонного электрода: с физической точки зрения отрывается один слой молекул.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01CLE01 1x5 мл

IONOCLEAN

Предусмотренное применение

- IonoClean – специальный раствор для очистки для анализатора электролитов Ionix, номер изделия I01CLE01.
- Данный раствор используется для депротеинизации жидкостей на приборе Ionix.

Содержание упаковки

- 1 пробирка с очистителем 5 мл.
- Готовый к использованию реагент
- Для идентификации изделия используется штрих-код, нанесенный на пробирки

Состав

- Гипохлорит натрия < 4%
- Поверхностно-активное вещество
- Консервант

Устойчивость

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования


- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза промыть водой.
- При работе с реагентами использовать надлежащую лабораторную практику (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.


Использование

- С экрана «ROUTINE» перейти к функциям очистки с помощью панели «NAVIGATION».

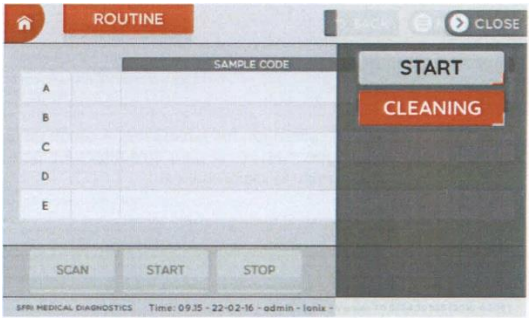


- Для очистки (депротеинизация) поместите пробирку с очистителем в любое положение штатива, этикеткой к задней стенке Ionix, нажмите клавишу [DEPROT]. Штатив начинает двигаться и когда будет обнаружена пробирка с очистителем, произойдет запуск процедуры (аспирация очистителя в электроды).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

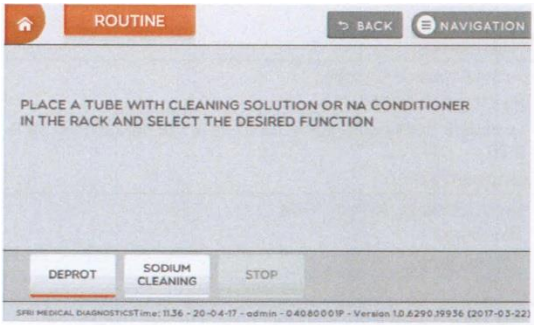

- Индикатор выполнения в верхней части окна показывает статус процедуры.

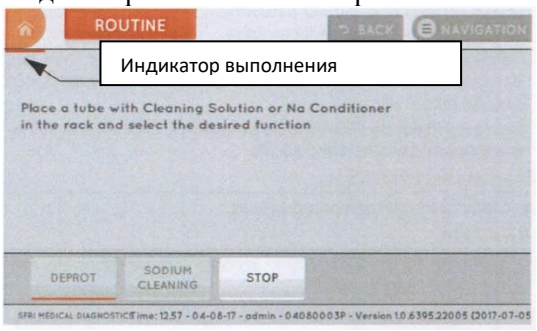

- После очистки требуется калибровка. По причине существенного смещения запрещено производить измерения в течение двух часов после профилактического обслуживания.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

CE	Маркировка CE
IVD	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
LOT	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01CAL03 1x5 мл

IONOCAL TCO_2

Предусмотренное применение

Раствор, используемый для калибровки общего количества CO_2 (tCO_2)[1] с помощью Ionix.

Содержание упаковки

- 1 пробирка с калибратором 5 мл.
- Готовый к использованию реагент

Состав

Компонент	Концентрация
Органический буферный раствор	
Неорганические соли	
Консервант	

Стабильность

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой.
- При работе с реагентами придерживаться надлежащей лабораторной практики (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование

В панели навигации в меню калибровки выбрать TCO_2, затем выполнить калибровку в соответствии с указаниями, отображаемыми на экране.



/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

	Маркировка CE
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Номер изделия: I01CAL01 1x5 мл

IONOCAL

Предусмотренное применение

IonoCal представляет собой калибратор для анализатора электролитов Ionix. Он поставляется с защитным ключом, необходимым для загрузки характеристик (номер партии, срок годности, концентрации…)

- Данный калибратор используется для двухточечной калибровки.

Содержание упаковки

- Пробирка на 5 мл.
- Готовый к использованию реагент
- Защитный ключ

Состав

Компонент	Концентрация
Органический буферный раствор	< 5%
Неорганические соли	< 1%
Консервант	< 0,5%

Стабильность

- Хранить при комнатной температуре до истечения срока годности.
- Не замораживать.
- Между использованиями флакон необходимо хранить закрытым.

Меры предосторожности в процессе использования

- См. Паспорт безопасности материала
- Использование исключительно уполномоченным персоналом под ответственность биолога.
- Данное изделие не содержит вредных компонентов и не представляет опасности. При попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой.
- При работе с реагентами придерживаться надлежащей лабораторной практики (НЛП).

Ликвидация отходов

В соответствии с местными законодательными требованиями.

Использование

Активация защитного ключа калибратора

Следовать инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, «Реагенты», стр. 3-47.

Если остался калибратор от предыдущей партии, его можно использовать до тех пор, пока его абсолютный объем не превысит нуля.

/Печать:
SFRI
SAS, уставной капитал: 75 800 евро
№ 453 866 824 RCS Бордо
Льё-ди Бергантон
33127 Сен-Жан-д'Йак – Франция
TVA FR 36 453 866 824
Тел.: +33 (0)5 56 68 80 50 – Факс: +33 (0)5 56 21 79 03/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Маркировка CE
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Срок годности
	Код партии
	Допустимая температура хранения
	Перед использованием см. инструкцию
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru