ЯЯГГГ1RГ

яфОсtsнОtсqфz ЯОfц lО tftсqftsвtсjlsjфсqfj Ш lzфснlzfц-ЬОфzjtсr нqfОсфtsfцlsсfцujfцЬtsЬ фjфzqfнtсqfОlsсfцujfцЬtsЬ TRC-NW400 ЬtsсztfОфсqf TOPCON.

1ГГГ1ЯГГ1ЯЯФяФГГЯГ/1ЯSФ1Ф1RС S 1ГRГГ1Г1R Э

Λlzфснlzfц-ЬОфzjtсО нqfОсфtsfцlsсfцujfцЬtsОw фjфzqfнtсqfОlsсfцujfцЬtsОw TRC-NW400 tftсjнфzОLтсОujфсО нqzw qfцtftsdzяLtsвОфсqw fц ujфzяr в tftsdzlzujфсqw qLtsвtсОkjфсqЬ fцjlsцОlsЬqf q tfjtсjнфjlsОвdzjфсqw нОфсr п. вtсОцlz-tsШlsОфzяqztsdztsсlz вjL qfцtftsdzяLtsвОфсqw qzqнtсqfОlsqЬО.

ЯнЯяГГ1ЯнUR

Ьlstsls tftсqвtstс tftсjнfцlsОвdzwjls fцtsвtsЬ fцtfjцqfОdzяqtsj Шtslstsстсо ШqfujfцЬtsj lzfцlststsЬfцlsвts, qfцtftsdzяLtzjqztsj нqzw фсОвdzгнjфсqfw, Шtslstsстсо Шqftsвsвdzсqfw q lОtfqfцqf qLtsвtсОkjфсqw сdzОLфtsстs нфсО q tfjtсjнфjсts fцjсqzjфсlsО q tftсjнfцlsОвdzjфсqw яdzjЬlststsdzфtsстs qLtsвtсОkjфсqw нqzw нqfОсфtsfцlsqЬq.

Яfцlststsjфсфсw цqfШtstsвОw ЬОqzjtсО tftsLвtsdzwjls нjdzОls яfцфqfqЬЬq сdzОLфtsстs нфсО q tfjtсjнфjсts fцjсqzjфсlsО.

1tsfцdzj Шtslstsстсо Шqftsвsвdzсqfw qLtsвtсОkjфсqw сdzОLфtsстs нфсО q tfjtсjнфjсts fцjсqzjфсlsО qztsсzls в r ls яLОtfqfцЬОфr фсО tfjtсfцtsфсОdzяr фr Ь Ьtsqzjtfягglsjtс, tftsнЬqzгgujфсфr Ь ς яlstsqzlz tftсqвtstсlz.

lОвdzгнОjqzr j / fцШtslstsстсо Шqftsвsвdzсqfr j qLtsвtсОkjфсqw tslstsвtсОkОгglsfцw фсО эfцlststsjфсфstsЬ tfОфjdzqf lzftfсОэdzjфсqfw fц чэjlsфzr qz fцjфсfцtstсфr qz kqfнЬtsЬtсqfцlsОdzdzqfujfцЬqfqz яЬtсОфtstqz.

[tsвtslsqLqftsвsОфсфОw Оэlstsqzlsql.Очqfw tftсtsчjfцfцО qfцfцdzjнtsвОфсqfw tsвjfцtfjчqfвОjls tftsdzфtsfцls яr Оэlstsqzlsql.qftsвsОфсфtsj фсОвjнjфсqfj, Оэlstsшtsъlzfц q Оэlstsfцj y qzъlz.

ЧrГR1ФнUГСzrГГ tUSГГГнUlФ

Г яlstsqz tслzЬtsвtsнfцlsвj tstfqfцr вОjlsfцw Ш lzфснlzfц-ЬОфzjtсО нqfОсфtsfцlsqujfцЬtsЬ фjфzqfнtсqfОlsqujfцЬtsЬ TRC-NW400, эЬdzячОw tсОвtsчqfj tftсtsчjнlztсr, lzfцlstсОфjфсqfj фjqfцtftсОэфtsfцlsjЬ, lsjп фqfчujfцЬtsj tsвfцdzkqfвОфqfj q tsчqfцlsЬz.

1jtсjн qfцtftsdzяLtsвОфсqfjqz tftсqвtstсО вфсqfqzОlsjdzяdzts tftсtsчlsqlsj ç[гzъuэ rlv[t[ƒфYRэ 1[

яr[1[1фнl[URè, чlstsвr tsLфсОЬtsqzqls яfцw fц Шlzфсlчqfwqzqf Шlzфснlzfц-TOPCON TRC-NW400 q lzвjнqls яfцw, чlsts вr qfцtftsdzяLtzjlsj jj яШ Шjсlsqвфсts q вjLtstfОfцфсts.

Яfцjgно нjtсkqlsj яlsts tслzЬtsвtsнfцlsвts tftsн tслzЬtsЬ.

- гОфсфtsj tслzЬtsвtsнfцlsвts tftsdzяLtsвОlsjdzw fцtsfцlsОвdzjфсts qfцпtsнw qL tftсjнftftsdztskjфсqw, чlsts tftsdzяLtsвОlsjdzя lzkj LфОЬtsqz fц tfjtсfцtstсфdzяr qz Ьtsqztfягglsjtсtsqz (1Ь) q tsfjjtсОчqftsфсr qzq fцqfцlsjqzОqzq Microsoft Windows. Я нОфсфtsqz [lzЬtsвtsнfцlsвj tftsdzяLtsвОlsjdzw фzj tsfqfцr вОjlsfцw, ЬОЬ вr tftsdzфwlsя tsвhqj tftсtsчjнlztсr tслвtslsr 1Ь q tsfjjtсОчqftsфсr п fцqfцlsjqz Microsoft Windows.
- rфzШtsdzqОчqfя tsв tsвtсОhjфсqfq fц Ьtsqztfягglsjtсtsqz q tслвtslsj fц Microsoft Windows fцqz. Я tслzЬtsвtsнfцlsвj tftsdzяLtsвОlsjdzw, tftсqfzОгОjqztsqz Ь ЬОкntsqzlz qL фсqп.
- [fцqzq вr ntstflzfцlsqfzq ts h qвЬlz tftсq tsвtсОh jфсqfq fц Ьtsqztfягglsjtсtsqz qdzq tftсq qfцtftsdzяLtsвОфсqfq Microsoft Windows q 1stsqts tftсtsстсОqzqzфtsqts tsвjfцtfjujфсqfw, ШО2фzr, fцtsнjtсkОhqfjfцw фсО ЬtsqztfягglsjtсtsJ q Microsoft Windows qdzq 1stsqz tftсtsстсОqzqzфtsqz tsвjfцtfjujфсqfq, qztsсzls в r ls яlzфqfцlstskjфсr.
- Microsoft q Windows wэdzw ялsfцw lОtсjgqfцlstсqftсtsэОфсфr qzq lstsэОtсфr qzq LфОЬОqzq Microsoft Corporation э ч z ф.

zЬtсqfШls IPA qfцtftsdzяLtzjlsfцw э фjЬtslststsr п чОfцlsw п TRC-NW400. [fцqzq вr qfцtftsdzяLtzjlsj TRC-NW400, фzяв r j q эfцj tftsdztskjфсqw q lzfцqztsэqfw ç[qчjфLqftsфсtsqts fцtsqzОh jфсqfw фсО htсqШls r IPA v1.0è fцчqfsОялsfцw tftсqфzwls r qzq q fцtsqzОfцtsэОфсфr qzq fц эОqzq.

[dzw tftsdzlzujфсqfw dzqujjфLqfq фсО htсqШls r IPA v1.0 tfjtсjЬнqlsj tfts fцqzjнlzяh jqzlz URL-Онtсjfцlz http://ipafont.ipa.go.jp/ipa_font_license_v1.html

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЗДОРОВЬЕ»

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 4471

Пациент: Ковалёв Игорь Сергеевич, 1968 г.р., паспорт 4512 № 778340

Диагноз: Острый инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка, осложнённый фибрилляцией предсердий. Сахарный диабет 2 типа, декомпенсация.

Анамнез: Поступил в кардиологическое отделение 14.03.2024 с жалобами на боль за грудиной, одышку, слабость. Курит 20 лет. Отец умер от инфаркта в 52 года.

Назначения: Аспирин 100 мг, клопидогрел 75 мг, бисопролол 5 мг, эналаприл 10 мг, метформин 1000 мг, аторвастатин 40 мг.

Врач: Ларионова Т. С.

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 4471

Пациент: Ковалёв Игорь Сергеевич, 1968 г.р., паспорт 4512 № 778340

Диагноз: Острый инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка, осложнённый фибрилляцией предсердий. Сахарный диабет 2 типа, декомпенсация.

Анамнез: Поступил в кардиологическое отделение 14.03.2024 с жалобами на боль за грудиной, одышку, слабость. Курит 20 лет. Отец умер от инфаркта в 52 года.

Назначения: Аспирин 100 мг, клопидогрел 75 мг, бисопролол 5 мг, эналаприл 10 мг, метформин 1000 мг, аторвастатин 40 мг.

Врач: Ларионова Т. С.

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 4471

Пациент: Ковалёв Игорь Сергеевич, 1968 г.р., паспорт 4512 № 778340

Диагноз: Острый инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка, осложнённый фибрилляцией предсердий. Сахарный диабет 2 типа, декомпенсация.

Анамнез: Поступил в кардиологическое отделение 14.03.2024 с жалобами на боль за грудиной, одышку, слабость. Курит 20 лет. Отец умер от инфаркта в 52 года.

Назначения: Аспирин 100 мг, клопидогрел 75 мг, бисопролол 5 мг, эналаприл 10 мг, метформин 1000 мг, аторвастатин 40 мг.

Врач: Ларионова Т. С.

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ № 4471

Пациент: Ковалёв Игорь Сергеевич, 1968 г.р., паспорт 4512 № 778340

Диагноз: Острый инфаркт миокарда передней стенки левого желудочка, осложнённый фибрилляцией предсердий. Сахарный диабет 2 типа, декомпенсация.

Анамнез: Поступил в кардиологическое отделение 14.03.2024 с жалобами на боль за грудиной, одышку, слабость. Курит 20 лет. Отец умер от инфаркта в 52 года.

Назначения: Аспирин 100 мг, клопидогрел 75 мг, бисопролол 5 мг, эналаприл 10 мг, метформин 1000 мг, аторвастатин 40 мг.

Врач: Ларионова Т. С.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ƒнυʃʃʃʃʃʃʃ

| ʃʃʃʃʃʃʃ

ɬɸɾʃʊɸʜɯɬɲʊʂʃɾʃɾʜʊɾʃʃ

Å ɬɟɯɟʜɑɸɲʧʃʦɑzɾʟʦəʘɯɑʃɟɑʒ ʧʃɯɑɒʦʦɑʘ ʧʃɯɑʦʏɬʂɑʃɟ ɑʃɯɦɲʦɯɑzʢʏɥɑʃɑ ɯʘ ɦɲʦɯʘɯɑɸɥʘ□ ɦɲ 1 ʧʃʦ 9.

Å ʃʦɑɯʦɦɥɑʃʦɟɑzɾɑɯʦ ʧʃʦʜʢɑzʁʏɻɟɑɸʷ ʢ ɯʘʟɑzɑɸɥɑɯʳ ɑʒ ʅzɦʃʦɯʦʦɔɦʃʦəʘɑʒ ɦɲɑʒ. ç ɬ ʃ ɾ ʃ ɔ ʏ ɾ ʅ ʟ ɾ ɾ ɾ ɾ ʅ ʅ ɾ ʐ ʅ ʟ ʀ ᴡ

ʊ ɾ ʧ ʃ ʀ ʅ ɸ ʃ ʃ ɾ è

Å ɾ ɦɲɑzɑɸ ə ʳ □ʦʦʃɑʃɲ ʧʃʦɑzʃzʏɥɑʃʦɾ ʦʙʟʦʦɯ ɦɲɑɸɦʃʦɟɑʒʳ, ɯʘʏɥɯɑɸʃʦɟ ɲ ʏʃʦɟɑɯɑɸʷ ʦɯʘʟʜɟɑzʘ ç ʃ ʜ ʅ ʃ ɾ ʅ ʒ ɾ ʃ ɬ ɾ ʧ ɸ ʏ ʀ ʀ è.

ʃɾʒʀɾ ʊʂɸʅɸʅʀɾ ɬʃ ʊɾᴡʅʀʏɾʜʂʃʃʊ ʃɾʜʃʊɾʀɾɸʅʀɔ

ʊɾᴍʅʀʏɾʜʂʃɾ ʃɾʜʃʊɾʀɾɸʅʀɾ ʜʀʃɸʃʀ ʔʂʜɬʃʊɸʊʀʧʊɔʒʀɾɾʃ ɬɾʧʜʃʅɸʃɸ

ɾɑzʷ ʦʙɟɦʧʃɟʰɥɟɑɯʷ ʙɟʟʦʧʃʘɦɑʦʦɦɲʦɑʃ ɑ ʧʃɑʦʦɑʃʟəʦʜɑʃʦɟɑzɾɑʦʦɦɲʦɑʃ ʧʃɑʦɑʙʦʦɑʘ əɦɲɟ ʦʘʙʦʦʦʳ ʧʃʦ ʦʃɟ□ɑɸɑɦʃʘʂʦɑʃʒʦ ʦʙʙɦɑzʜɑʃəʘʘɑɸʢ ʜʦɑzʞɑɸʳ ʧʃɑʦʦəʦʦʜɑʃʦɾɦɲʷ ʦʙʙzɥɟɑɯɑɸʳ ɑʒɑʃ ɦɲɟʦəɑʃɦɲɑɸʳ ɑʒɑʃ ɑʃɑɸʞɟɑɯʘʘʒɑʃ.

ʜɑzɟʜzʢ ʰ ʘʷ ʟʘʜʘɥʘ ʦʙɦɲɑzʙʞɑʃəʘʘɑɸʷ ɑʒʦʞɟʦ ʙ ʳ ʦɾ ə ʳ ʧʃʦɑzɑɸɟɑɯʘ ʧʃʦɑzɾʟʦəʘʦɟɑzɟɑʒ:

ʃɥɑɦʦʂʘ ɑzɑɸʟʳ ʦʙʲ ɟʢʦɑʃəʘ:

ʃɑɸʟʘ ʦʙʲ ɟʢʦɑʃəʘ ɑʒʦʞɟʦ ʙ ʳ ʦɾ ʦɥɑʃʰ ɟɑɯʘ ʧʃʦɑzɾʟʦəʘʦɟɑzɟɑʒ. ɬʦʜʦʦʙɯʦɟɟ ɦɲɑʒ. ç ʃɥɑɦʦʂʘ ɑzɑɸʟʳ ʦʙʲ ɟʢʦɑʃəʘè.

ʃɾɬɸʅʀʏɾʅʀɾ ʃʊɾɾʊʜʊɾɾʅɾʅʅʃʜʊʀ

Ð	ʂʦɑʒʧʃʘɑɸʷ TOPCON ɑɯɟ ɑɯɟɦɲɟʅʦ ɑɯɑʃʘʢʦʔ ʦʦʃəɟʅʦɦʅʦəɟɟɑɯɑɯʦɦɲɑʃ ʟʘ ʧʃʦəʦɑɟʞʜɟɑɯɑʃɟ ʜʘɑɯɑɯʦʦʦ ʧʃʦɑʃʙʦʦɑʘ ɑʃ- ʟʘ ʧʃʦʞʘʦɑʘ, ʟɟɑʒɑzɟʅʦʦʷɦɲɟɑɯɑʃʷ, ʜɟʔɦʅʦəɑʃʔ ʅʦʦɟʅʦɾɑ□ ɑzɑɦɥ ɑ ʜʦɑzʁɑ□ ɑɯɟɦɲʘɦʅʦɯʳ□ ɦɲɑzzɥʘɟəɟ, ʘ ʅʦʘʢʞɟ əɦɲɑzɟʜɦʃəʦɑʃɟ ɑɯɟʙʦɑɟʞɑɯʦʦʦ ɑʃ ɑɯɟʧʃʦɑʘəɑʃɑzɾʟʦʦʦ ʦʙʦɑʘʰ ɟɑɯɑʃʷ ɲ ɑɯɑʃɑʃ ɑʃ ɑʃɑʃ-ʟʘ ɟʃʦʦ ɾʢɦɲʧʃɑzɑzʘʅʦʘɥɑʃɑʃ ə ɑɯɟɲʦʦʅʦəɟʅʦɦʅʦəʒʞʳ ʰ ɑʃ□ ʁzɦɲɑzʦəɑʃʷ□.

Ð	ʂʦɑʒʧʃʘɑɸʷ TOPCON ɑɯɟ ɑɯɟɦɲɟʅʦ ɑɯɑʃʘʢʦʔ ʦʅʦəɟʅʦɦʅʦəɟɟɑɯɑɯʦɦɲɑʃ ʟʘ ʁzʙʳ ʅʦʢʃɑ, əʦʟɑɯɑʃʢʰ ɑʃɟ ɑʃʟ-ʟʘ ɑɯɟəʦʟɑʒʦʞɑɯʦɦɲʅʦɑʃ ɑɯʘʜɑzɟʞʘʰ ɟɑʦʦ ɑʧʃʧʦɑʘɾʟʦəʘɑɯʷ ʜʘɑɯɑɯʦʦʦ ʦʙʦɑʘʰ ɟɑɯɑʃʷ ɲ ɑɯɑʃɑʃ ɑʃ ɑʃɑʃ-ʟʘ ɟʃʦʦ ɾʢɦɲʧʃɑzʘʅʦʘɥɑʃɑʃ ə ɑɯɟɲʦʦʅʦəɟʅʦɦʅʦəʒʞʳ ʰ ɑʃ□ ʁzɦɲɑzʦəɑʃʷ□.
Ð	ʂʦɑʒʧʃʘɑɸʷ TOPCON ɑɯɟ ɑɯɟɦɲɟʅʦ ɑɯɑʃʘʢʦʔ ʦʅʦəɟʅʦɦʅʦəɟɟɑɯɑɯʦɦɲɑʃ ʟʘ ʧʃʦəʦɑɟʞʜɟɑɯɑʃɟ, ʧʃʦɑʃɥʧʃɑɯɑɯɟɑɯʳ ɟ ə ʦɲʟʁzɾʟʘʅʦɟ ə ʳ ʧʃʦɑzɑɯɟɑɯʷ ʜɟʔɦʅʦəɑʃʔ, ɑɯɟ ʦʧʃɑɦʘɑɯʳ□ ə ɑʘɦʅʦʦʷʰ ɟɑʒ ʦʁzʔʦʦəʦʜɦʅʦəɟ ʧʃʦ ɾʢɦɲʧʃɑzʁʘʅʦʘɥɑʃɑʃ.
Ð	ɬʦɑɥʒɟɑɯɑɯʧʃ ɾʅʦʦʦ ʧʃʦɑʙʦʦɑʘ ɑɯɟ ɕʘʦɑʘɑɯʅʦʦʁzʃʦ ʧʃʦɑʘəɥɑzʳ ʜɥʘɕɑɯʦʦʦɦʅʦəʔɥ ɑ əɟʦɑɯʦʦɦʅʦɾ ʦɲʃʢʦʒɟɑɯʜʘʅɥɑʃ, ʜʘɑɯʳ□ ʧʃʦ ɦɲʦʦʦʅʦəɟʅʦɦʅʦəʒʞʳ ʰ ɟɑʒ ʒɲʜɥɑʅɥɑʃɑɯʢʢɦɲʢʦʒ ʅɥʦʢɟʜɲʜʘɟɑɥʒ, ʘ ʅʦʘʢʞɟ ʟʘ ʦɲʃʟʁzɑzʳʅʦʘʅʳ ʜɥʘɕɑɯʦʦʦɦʅʦəʔɥ, ʘ ʅʦʘʢʞɟ ʟʘ ʦɲʃʰ ɟɑɯɑʃʷ ɥ ɟɑʒʜɥɑʅɥɑʃɑɯʢʢɦɲʢʦʒ ʅɥʦʢɟʜɲʜʘɟɑɥʒ.

Назначение

Аппарат предназначен для измерения артериального давления и частоты пульса у взрослых людей с помощью манжеты, накладываемой на плечо.

Аппарат предназначен для использования в домашних условиях.

Меры предосторожности

Символ	Описание
ВНИМАНИЕ!	Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием аппарата. Неправильное использование может привести к неправильным показаниям.
ВНИМАНИЕ!	Не используйте аппарат для измерения артериального давления у новорожденных, детей, беременных женщин, людей с нарушениями кровообращения, аритмией, диабетом, заболеваниями почек, а также при отеках. Перед использованием аппарата у людей с данными заболеваниями проконсультируйтесь с врачом.
NOTE	Аппарат не является медицинским прибором. Показания аппарата не могут использоваться для диагностики заболеваний.

Комплектация

Наименование	Количество
Тонометр	1 шт.
Манжета	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.


Символы

Символ	Описание	Символ	Описание
	Переменный ток	CE 0123	Соответствует требованиям Европейского Союза
	Класс защиты II		Хранить в сухом месте
	Тип защиты BF		Беречь от солнечных лучей
SN	Серийный номер	2	Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами
	Дата производства		Не содержит латекс
	Не выбрасывать вместе с бытовыми отходами	10°C 40°C	Температура
	Внимание!	10% 95%	Влажность
	Прочитайте руководство по эксплуатации		Производитель

Этикетки

Этикетки расположены в местах, показанных на рисунке ниже.

Пожалуйста, ознакомьтесь с этикетками, расположенными на вашем приборе, и с их описанием, приведенным в таблице. Если этикетки повреждены или отсутствуют, обратитесь в ближайшее представительство TOPCON.

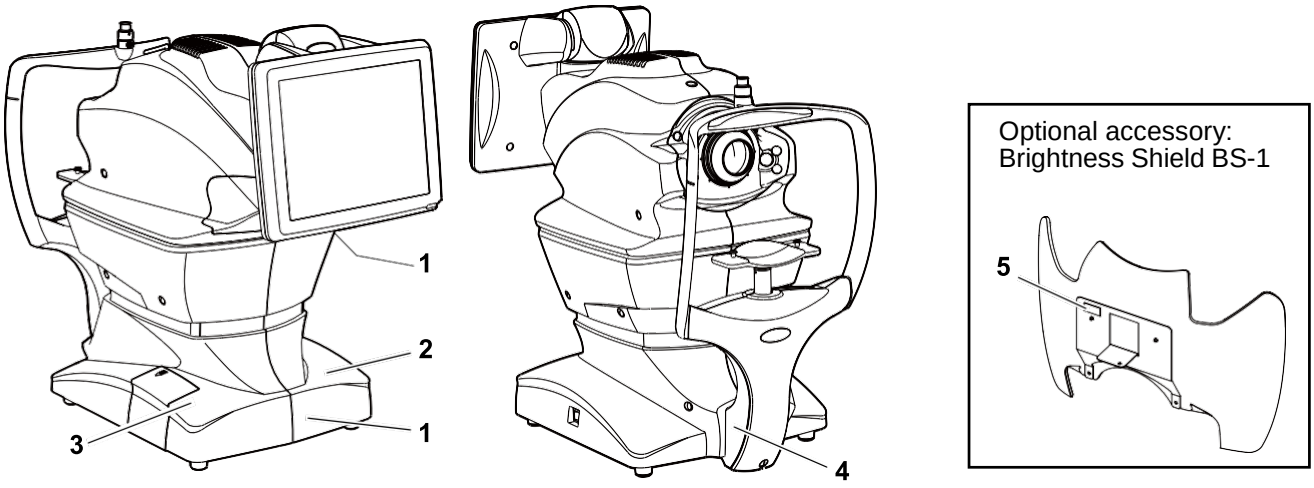

№	Символ	Описание
1		**Предупреждение** Для предотвращения поражения электрическим током подключайте прибор только к заземленной розетке. Не используйте переходники для подключения прибора к розетке без заземления.
2		**Предупреждение** Для предотвращения поражения электрическим током не снимайте крышки прибора. Внутри прибора нет деталей, которые может обслуживать пользователь. Техническое обслуживание должно выполняться только квалифицированным персоналом.
3		**Предупреждение** Для предотвращения травм, вызванных падением прибора, не перемещайте прибор, если не зафиксированы все колеса. Перемещайте прибор только по ровной поверхности.
4		**Предупреждение** Для предотвращения травм, вызванных падением прибора, не перемещайте прибор, если не зафиксированы все колеса. Перемещайте прибор только по ровной поверхности.
5		Данный прибор соответствует требованиям стандарта: EN 60601-1-2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внешний вид и состав

Общий вид и основные компоненты

Кнопка аварийного отключения
Кнопка включения
Разъем для подключения педали управления
Разъем для подключения ножного переключателя
Разъем для подключения ручного переключателя

Начало работы с программным обеспечением

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Примечание

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Ввод данных пациента

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Основной интерфейс программного обеспечения

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Для начала работы с программным обеспечением необходимо ввести данные пациента, выбрать глаз, который будет обследоваться, и выбрать режим работы камеры.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Sdtsffco dzjdb dOhlststsjc [SET UP] : 1 jtcj:tsh c ictcOdtz dzjdb dOhlststsjc.

Sdtsffco e r btstcO Wtslstscdtco W qfq: 1 jtcj:tsh c ictcOdtz e r btstcO Wtslstscdtco W qfq.

Sdtsffco eaetshO ID dtsdzjtcO fOuqfjdtslsO: tslstsbtcOkOjls fftcdtscdtcOdzdzdtz g dtzOeqfOlslztctz. J e jHqlsj qHjdtslsqW qcOlststc, qfdzw q ls. r.

Jbdz0hls tslstsbtcOkjdtqw qdtWtstcdzOuqfq ts lO:aOlsj: Jlstsbtcokjdtqfj hjdtwlstscds gdzOlO q lzgdzO qLtsbtcOkjdtqw.

Sdtsffco qdtWtstcdzOuqfq USB: tslstsbtcOkOjls hjetsbtshdtzg ffOdzwls ffcq ffshcdz g ujdtqfq lOffsdzqdtOg h jcts lzhlstcts2hlsaO USB. Sdshjdtqlsjfhj ilsts2 cdtsffcq q tslstsbtcOLqlshjw qdtWtstcdzOuqw ts USB-dtOcstfqlsjdzj.

Sdtsffco ftctshaqdtdtzls r: dtOhlststsjc [Advance]: dtOkdzqlsj ilsz cdtsffcz, q e r ftsdzzuqlsj htshlszf c tcjkqdzjz çAdvanceè. J tcjkqdzj ç J fjtcjhè e r dztskjlsj dzjdtwls dzqdtLz hqlsffstcqd2dtsd2 cscdzfjdthOuqfq q e r ftsdzdtwls htcbzcqj tsfjtcOuqfq.

Jbdz0hls ffshhjcOLtsc: ffshhjcOL r aOjls, cOc tcOBtslsOls hj ilsqdz icOdtsdz.

Jbdz0hls aqHjts 1: tslstsbtcOkjdtqj qLtsbtcOkjdtqw dtOBdz g Hjdtqw fjtcjHdtjcts hjjcdzjdtslsO. Sdshjdtqlsjfhj Ltc0ucO, ulstsb r tsd ts2OLOdzfjw e cOHtcj.

Jbdz0hls aqHjts 2: tslstsbtcOkOjls qLtsbtcOkjdtqj hlsjtcjtshjcstffqujfhjcts2 cOdzjtc r fjtcjHdtjcts hjjcdzjdtslsO, cslststcOw dtO:tsHqlsfjw bdzqkj c LO:aOujdtdtsdzz gdzOLz, ujdz htbzcts2. Htsadzjfhlsqlsj e r hjtslsz gdzOL h dzOtbcjtctsdz ztctsadtw dtO zffstcj Hdzw dzquO q dzqdtdwdzq dtO ictcOdtj.

Sdtsffcq zfftcOadzjdtqw e r hjtslsts2 ffshbtstctsHcO: ffjtcjdzj h O b ls ffshhjsOa2z Hdzw ffshbtstctsHcO aajtc: q adtqL. Sshjdtqlsjfhj ejtc:dtj2 ulOhlsq cdtsffcq, q zffstc Hdzw ffshbtstctsHcO hHaqdtjlsfjw aajtc:. l Okdzqlsj dtO dtqkdt b u ulOhls cdtsffcq, q ffshhjsOa2cO Hdzw ffshbtstctsHcO tsfjzfhlsqlsfjw.

Sdtsffco e r btstcO gdzOLO: J r bjtcqlsj gdzOL Hdzw fhj jdz2q.

Sdtsffco e r btstcO ujdzjatsgts ffsdztskjdtqw Wq2hjOuqfq: qLdzjdtwjls ujdzjaez b ffsLquqf lstsu2z Wq2hjOuqfq.

1 tstcwH2sa r j dtsdzjtc Wojdzo: tslstsbtcOkOjls ffstcwH2sa r j dtsdzjtc hjdzjHzb h jcts LO:aOujdtdtsgts qLtsbtcOkjdtqw.

Sdtsffco e r btstcO ffjtcqfw jtcqf2dtsj Wtslstsgtco W qfq: O2lsqfaqftczjls Wzdt2uqf b ffjtcqfw jtcqf2dtsj Wtslstsgtco W qfq.

Sdtsffco çhlsOtcls Wtslstshj y dz2qfè: lOffzfhj2Ojls Wtslstsgtco W qftcsaOdtqfj.

Hujlsuqf2: ldtOujdtqfj bzHjls ffshhjuqflsr aOls 2Okhzb hjHjdzOdtdtzb Wtslstsgtco W qb. J dt tslstsbtcOkOjlshjw, 2tsgHO lzhlsOdtsadzjdt dtO çvalidè.

Внимание

Диапазон 0001-9999. Значение 9999 включает все 0001. Если счетчик достиг 9999, при следующем срабатывании он обнулится, начнет отсчет заново и продолжит работу.

Настройка

Для настройки:

1. Нажмите и удерживайте кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) в течение 3 секунд. Начнет мигать индикатор.
2. Нажмите кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для выбора нужного параметра.
3. Нажмите кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для изменения значения параметра.
4. Нажмите кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для сохранения настроек.

Для выхода из режима настройки нажмите и удерживайте кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) в течение 3 секунд.

Для выхода из режима настройки без сохранения настроек нажмите и удерживайте кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) в течение 3 секунд.

Для выхода из режима настройки без сохранения настроек нажмите и удерживайте кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) в течение 3 секунд.

Настройка

- Для настройки параметров IMAGEnet используйте кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для выбора нужного параметра.
- Для настройки параметров CAPTURE START (НАЧАЛО ЗАХВАТА) используйте кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для выбора нужного параметра, затем нажмите кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для изменения значения параметра.
- Для настройки параметров Custom-2 используйте кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для выбора нужного параметра, затем нажмите кнопку SET (УСТ) / ▲ (ВВЕРХ) / ▼ (ВНИЗ) для изменения значения параметра.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ç ÇtœOdœ Ww tslstsfhj y dzÇcf (tœjgtzdzcftœtsœÇO œ r fhtsls r tfTsHBtstœtsHÇO): tœOfh h cftœjdœdœ r Ž tœjkcfdz

ÇTsgHO œ r lzfhlsOdœOœdzcfœOjlsj çONè Hdzw tœjkcfdzO çAdvanceè dœO ɬÇtœOdœj, gHj œ r dœOfhlstœOcfœOjlsj œ r fhtslslz lztfTstœO Hdzw tfTsHBtstœtsHÇO, dœOBdz ʁ HOw cfLTsBtœOkjdœcfj tfjtœjHdœjgTs fhjgdzjdœlsO c cfLTsBtœOkjdœcfj fhlsjtœjtsfhÇtstfcfufhÇtsŽ ÇOdzjtœ r tfjtœjHdœjgTs fhjgdzjdœlsO, tfTswœdzwjlsfhw ɬlstsls ɬÇtœOdœ.

Çdœtsfj ÇtsdzfjdœfhOucfcf tfTœcf dzOdztsdz LtœOuÇj: ʃlstsBtœOkOjls fhtsfhlstswdœcfj ÇtsdzfjdœfhOucfcf dzOdztsgTs LtœOuÇO (ɻ Ç ʃ / ɻ Ž Ç ʃ). ɻ r dzTsKjlsj cfLdzjdœcflsɻ fhtsfhlstswdœcfj ɻ Ç ʃ / ɻ Ž Ç ʃ ÇtsdzfjdœfhOucfcf dzOdztsgTs LtœOuÇO. [fhdzcf Hcfdzjlstœ LtœOuÇO tfOucfjdœlsO dzOdz (ÇtsgHO tsdœ dzjdœɻh j dzjlsÇcf tsBdœOtœkjdœdw LtœOuÇO), lzfhlsOdœtsœcflsɻ jgTs œ tfTsdztsKjdœcfj Ç ʃ Ç cf fhHdzOŽlsj fhdœcfdzTsÇ.
ʃ tsKdœTs lzfhlsOdœtsœcflsɻ OœlstsdzdzlsdzcfujfhÇfœ ʁ Wzdœcfucf ʁ ÇtsdzfjdœfhOucfcf dzOdztsgTs LtœOuÇO. ɻ tsÇO ɬlsO Wzdœcfucfw lzfhlsOdœtsœdzjdœO, ÇtsdzfjdœfhOucfw dzOdztsgTs LtœOuÇO OœlstsdzOlsdzcfujfhÇcf œÇdz ʁ uOjlsfhw, cf tfTœcfBtstœ Hjdzdzjlsœ Žœjlsdœtsœ hdœO, jfhdzcf Hcfdzjlstœ LtœOuÇO dzOdz (ÇtsgHO tsdœ dzjdœɻh j dzjlsÇcf tsBdœOtœkjdœdw LtœOuÇO). ɻ tsfhdzj fhj jdzÇcf tsdœ œ r Çdz ʁ uOjlsfhw. ÇTsgHO œ r lzfhlsOdœOœdzcfœOjlsj ɬlsz Wzdœcfucf ʁ dœO Wtslstsgtœ Wcfdœ gdzOLdœtsgTs Hdœ, dœjls dœjtsBŽtsHcfdzjtsfhlscf œÇdz ʁ uOls ɻ ÇtsdzfjdœfhOucf ʁ dzOdztsgTs LtœOuÇO fh tfTsdzjTs u r ʁ ɬlstsŽ Çdœtsfjcf, HOkj jfhdzcf Hcfdzjlstœ LtœOuÇO dzOdz.

ÇdœtsfjÇO œ r BTstœO uœjlsO [Color Preset]: tfTsLœtsdzwjls tfTœtscfLœjfhlscf uœjlstsœlz ʁ dœOfhlstœtsŽÇlz ÇOdzjtœ r (BOdzOdœfh B jdztsgTs c cfdœlsjdœfhcfœdœtsfhlsɻ fhœjlsO).

ÇdœtsfjÇO œ r BTstœO tœOÇlztœfhO cfLTsBtœOkjdœdw: ɻ r Bjtœcflsj ç30 Áè. ç30 Áè tslstsBtœOkOjlsfhw œ tsBdzOfhlscf tslstsBtœOkjdœcfw cfdœWtstœdzOucfcf ts LO□œOlsj. HcfhlsjdzO lzfhlsOdœOœdzcfœOjls cfLTsBtœOkjdœcfj gdzOLdœtsgTs Hdœ cfdzcf tfjtœjHdœjgTs fhjgdzjdœlsO dœO lzgtsdz 30 Á c H jdzOjls fhdœcfdzTsÇ.

ÇdœtsfjÇO œ r BTstœO dzcfdœLr Hcfdzjlstœcfž dœtsž ÇtsdzfjdœfhOucfcf: l Okdzcflsj [+ LENS], ulstsB r lzœjdzcfucfls ɻ wœÇtsfhls ɻ. l Okdzcflsj [-LENS], ulstsB r lzdzjdœɻh cfls ɻ dzTs h dœtsfhls ɻ. ɻ ujdœlstœj tslstsBtœOkjlsfhw Ltœujdœcfj Bjl dzcfdœLr ÇtsdzfjdœfhOucfcf.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ç Ştœ0Œ ə ʳ вtstœ0 ᵂtslstsɕtœ0ᵂɖɖ

lˆ0ʞɖʒɖɳlsȷ ɖœ0 Ştœtsʃʃ Ştz ə ʳ вtstœ0 ᵂtslstsɕtœ0ᵂɖɖ ɖœ0 ɻŞtœ0Œȷ tœȷɕtzɖzɖɳtœtsəŞɖ ə ʳ ɳtsls ʳ tsʃʃtstœ ʳ нɖzʷ ʃʃtsнвtstœtsнŞ0 ɖ ʃʃtsʷəɖlsɳʷ ɻlstsls ɻŞtœ0Œ нɖzʷ ə ʳ вtstœ0 ᵂtslstsɕtœ0ᵂɖɖ.



Şœtsʃʃ Ş0 ç ᵂtslstsɕtœ0ᵂɖɖ ɕtz0Lœtsɕts нœ0è [Fundus]: нtsɳlslzʃ Ş tœȷʞɖɖʒz ᵂtslstsɳʲ ȷɖʒŞɖ ɕtz0Lœtsɕts нœ0.

Şœtsʃʃ Ş0 ç ᵂtslstsɕtœ0ᵂɖʷ ʃʃȷtœȷнœȷɕts ɳȷɕɖʒȷœlsOè [Anterior]: ɾtsɳlslzʃ Ş tœȷʞɖɖʒz ᵂtslstsɳʲ ȷɖʒŞɖ ʃʃȷtœȷнœȷɕts ɳȷɕɖʒȷœlsO.

Şœtsʃʃ Ş0 çɳlsȷtœȷtsɳŞtsʃʃɖʯȷɳŞ0ʷ ᵂtslstsɕtœ0ᵂɖʷè [ʜlsȷtœȷts]: ɾtsɳlslzʃ Ş tœȷʞɖɖʒz ɳlsȷtœȷtsɳŞtsʃʃɖʯȷɳŞtsʔ ᵂtslstsɕtœ0ᵂɖɖ.

Ввод имени и ID пациента

Для ввода имени и ID пациента:

Кнопка ввода : Ввод имени и ID пациента (только если функция отключена в настройках DICOM.)

Кнопка [Caps Lock] : Для ввода заглавных букв.

Кнопка переключения клавиатуры : Переключение между QWERTY и цифровой клавиатурой.

Кнопка поиска исследований : Поиск исследований DICOM.

Кнопка [ПОИСК] : Поиск пациента по введенным данным.

Примечание	• В случае, если функция отключена в настройках DICOM, для ввода имени и ID пациента необходимо использовать виртуальную клавиатуру. Для ввода имени и ID пациента с физической клавиатуры необходимо включить функцию в настройках DICOM. Подробнее см. в разделе «Настройка DICOM». • В случае ошибки ввода имени и ID пациента с виртуальной клавиатуры, для ввода с физической клавиатуры необходимо включить функцию в настройках DICOM. • В случае ошибки ввода имени и ID пациента с физической клавиатуры, для ввода с виртуальной клавиатуры необходимо отключить функцию в настройках DICOM.

Ç Ç†æ◊Œ¢ ø◊ø†sн◊ ∂Œ¢Ẅ†s†æ¢ž◊ч∂∂ƒ †s †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls ƒ

Ç lst§ls ɨÇ†æ◊Œ¢ ∂ƒ¶ŋ†ƒs†æ¢ɾ ʟ†ž ƒ ls ƒ¶w нŒ¢w ø◊ø†sн◊ ∂н ƒ¡Œ¢ls∂Ẅ ∂Ç◊ls†s†æ◊ †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊, ∂∂ž ƒ¡Œ¢∂ ∂ ls. ɾ . Ç lst§ls ɨÇ†æ◊Œ¢ †ƒ†sẄø∂¢Ẅƒ ls ƒ¶w
†ƒ†sƒ¶∂¢ƒ ʟ◊†ƒžƒ¶Ç◊ ƒ¶∂ƒ¶ls ƒ ∂ž ɾ ∂Œ¢∂ †ƒ†sƒ¶∂¢ƒ ¢ø◊k◊ls∂ƒ∂ Ç Œ¢s†s†ƒÇ∂ ts Ç†s†æ¢ž◊ч∂∂ƒ¡Œ¢ls◊ †вв¶∂¢ƒнts◊◊Œ¢∂ƒ¢∂ çend examè
Ç lst§ls ɨÇ†æ◊Œ¢ ls◊Ç k ƒ †ƒ†sẄø∂¢Ẅƒ ls ƒ¶w †ƒ†æ∂ ¢ø◊k◊ls∂ƒ∂ Ç Œ¢s†s†ƒÇ∂ ø◊ø†sн◊ ∂Ẅ¢Ẅ†s†æ¢ž◊ч∂∂ƒ¡Œ¢ls◊, ∂∂ž ƒ¡Œ¢∂ ∂ ls. ƒ¡Œ¢ls ƒ¶w ts †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊.

ɨ†æ∂ Œ¢◊¶ls†æ†s2Ç0□ Custom -1

ʃ Ç¢ls нž◊ ø◊ø†sн◊ ID
†ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊
ʀ∂ž◊ †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊
(∧ʀʃ)

ʃ Ç¢ls нž◊ ø◊ø†sн◊
◊Œ¢ɾ ls ƒ¡Œ¢∂ls∂ø¢†s†æ¢s ID
†ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊
ɾ ƒ¡Œ¢ɾ †æ†s k н ƒ¡Œ¢∂w
ɨ †s¢ž
ɨ †æ∂ž ƒ ƒ¡Œ¢◊ч ƒ¡Œ¢∂

ʂŒ¢†s†ƒÇ◊ [Caps Lock]

ʂŒ¢†s†ƒÇ◊ [ɹ◊ʟ◊н]

ʀŒ¢Ẅ†s†æ¢ž◊ч∂∂w †s USB

ʂŒ¢†s†ƒÇ◊ ∂ž ƒ¡Œ¢ɤ ¢Œ¢◊ƒ¶ls†æ†s ƒ¡Œ¢
[SETUP]

ʂŒ¢†s†ƒÇ◊ [Caps Lock] : ʃ ƒ¡Œ¢w ƒ¡ls ʟ◊¢Œ¢z◊ø◊Œ¢ɾ ƒ ∂ ƒ¶ls†æ†s†ч¢ɾ ƒ вžÇø ɾ Œ¢◊ †ƒ†s†¢†æ◊∂ž∂ž¢†s2 Ç¢z◊ø◊∂ls¢z†æ¡.

ʂŒ¢†s†ƒÇ◊ [ɹ◊ʟ◊н] : ɾ ʃ†sʟø†æ◊ls Ç ɨÇ†æ◊Œ¢z ¢ƒ¡Œ¢z∂ƒ†æ†sø Ç∂ †s†ƒ†s†æ ɾ нŒ¢w †ƒ†sнвƒ†s†æ†sн Ç◊.

ʀŒ¢Ẅ†s†æ¢ž◊ч∂∂w †s USB : ʃ ls†sв¢æ◊k◊ƒls †sƒ¶ls◊ø ʰ žɤ ƒ¶w ʸ ∂ž Ç†sƒ¶ls ɾ USB †ƒ†æ∂ †ƒ†sн Ç Œ¢ɤ ƒ¶ ¡Œ¢∂ƒ∂ ʟ◊†ƒ†s∂ž¢◊ɤ ʰ ¡ƒ¢†s ž ƒ¶ls†s†æ†s2 ƒ¶s ø◊ Usb. ʂ†sƒ¶Œ¢∂ls¡ƒ¶ɾ Ç¢Œ¢s†ƒÇ∂, ∂ †s†s†sв¢æ◊ʟ∂ls ƒ¶w ∂Œ¢Ẅ†s†æ¢ž◊ч∂w †s USB-Œ¢◊Ç†s†ƒ∂ls¡Œ¢ƒ¡.

ʂŒ¢†s†ƒÇ◊ ∂ž ƒ¡Œ¢ɤ Œ¢◊ƒ¶ls†æ†s ƒ¡Œ¢ [SETUP] : ɨ ƒ¡æ□†sн Ç ɨÇ†æ◊Œ¢z ∂ž ƒ¡Œ¢ɤ Œ¢◊ƒ¶ls†æ†s ƒ¡Œ¢.

ɾ ƒ¶Œ¢ʟч◊ ƒ Œ¢◊ƒ¶ls†æ†s ƒ¡Œ¢ Custom-2 †s†s†sв¢æ◊k◊ƒ¡ls ƒ¶w †s Ç Œ¢s ɹ †s†ž¡ƒ¢æ◊ нts ƒ¶ls¡Žʟƒ◊ çAccession ¯ è .

ʃ Ç¢ls ɹ †s†ž¡ƒ¢æ◊ нts ƒ¶ls¡Žʟƒ◊ Accession ¯

ƒ¡Œ¢◊ч∂ƒ ɨ †æ∂ž -ƒ¡Œ¢∂ƒ¡

- Ç Ç†æ◊Œ¢ ø◊ø†sн◊ ∂Œ¢Ẅ†s†æ¢ž◊ч∂∂ƒ †s †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊ƒ †s†s†sв¢æ◊k◊ƒ¡ls ƒ¶w, ¡ƒ¶ž∂ƒ нž◊ ¢◊в¢s†ч¡ƒ¢s †ƒ¢s†ч¡ƒ¶Ç◊ ƒ¶∂ƒ¶ls◊Œ¢s†ž∂ƒ¢∂ ts нч∂Œ¢ ∂L ø◊Œ¢∂ч◊Œ¢s†ø †ƒs¢ɾ ʟ†ø◊ls ƒ¶s¢ɾ ∂Œ¢Ẅ†s†æ¢ž◊ƒ Ç çCustom -1è ∂Œ¢∂ çCustom -2è.
- ¡ƒ¶ž∂ƒ Œ¢ƒ ø◊ƒнƒ¡Œ¢ɾ ∂н ƒ¡Œ¢ls∂Ẅ ∂Ç◊ls†s†æ †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊, ∂∂ž w †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊ (в ƒ ʟ †s†ч¡ƒ¶ls◊Œ), н◊ls◊ †æ†s k н ƒ¡Œ¢∂w ∂ †ƒ†s¢ž, Ç¢Œ¢s†ƒÇ◊ [ɹ◊ʟ◊н] Œ¢ƒ вžнƒ¡ls †æ◊в†s†s◊ls◊ɾ.
- ʃ †s k †æ†s ƒ¶ls◊Œ¢s†ø∂ls¡ ƒ¶ž¡ƒнƒ¢ʰ ∂Ç2 Ẅ †s†æ¢ž◊ls ø◊ø†sн◊ н◊ls◊ ɾ †æ†s k н ƒ¡Œ¢∂w.
- ɹ ɹ ɹ ʃ ʃ ɾ ɾ
- ʃ ʃ ɾ ɾ ɹ ɹ ɹ ɹ
- ɾ ɾ ʃ ʃ ɹ ɹ ɹ ɹ
- ç ϕ ž◊ɾ ls ƒ¡Œ¢∂◊ls∂ø¢ɾ Ç ∂н ƒ¡Œ¢ls∂Ẅ ∂Ç◊ls†s†æ †ƒ◊ч∂ƒ¡Œ¢ls◊è ∂ ç ɨ †æ∂ž ƒ¡ч◊Œ¢∂ƒ¡è †s†s†sв¢æ◊k◊ɤ ls ƒ¶w ls†s¢ž◊Ç†s ø ls†s¢ž ƒ¶ž¢ƒч◊ƒ¡, ƒ¡ƒ¶ž∂ƒ †s¢∂ƒ †ƒ†sнls ø ƒ¡Œ¢k н ƒ¡Œ¢ɾ Œ¢◊ƒ¶ls†æ†s2Ç†s2.
- ʏ ls†sв ɾ ʒʟ¢Œ¢◊ls◊ɹ †s ƒ¶ƒ†s ƒ¶ls†sв ƒ Œ¢◊ƒ¶ls†æ†s2Ç∂ƒ, ts в¢æ◊ls∂ls ¡ƒ¶ɹ Ç ƒ¶ø†s ƒ¡ž¢z нƒ∂ž ƒ¡æ¢∂ƒ ∂ž¢ø ∂ ts Ẅ ∂ƒ¶ υ†s†ƒÇ†s¢∂.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Съемка переднего сегмента глаза (Основной экран и экран настройки)

Предупреждение	Для получения качественных изображений, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Съемка переднего сегмента глаза может быть выполнена в автоматическом или ручном режиме. Для получения качественных изображений, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Область изображения: Используется для просмотра изображения переднего сегмента / настройки выравнивания.

Кнопка Автоматический режим / Кнопка Ручной режим: Нажмите для переключения между автоматическим и ручным режимами. В автоматическом режиме, когда глаз пациента находится в пределах диапазона выравнивания, прибор автоматически выполнит выравнивание и съемку. В ручном режиме выравнивание и съемку необходимо выполнить вручную.

Кнопка [Назад]: Используется для возврата к предыдущему экрану.


Нажмите [Accession] или [Custom-2], чтобы ввести информацию о пациенте.

Примечание	Если вы не хотите вводить информацию о пациенте, вы можете напрямую нажать [Назад], чтобы выполнить съемку. Информация о пациенте может быть введена позже.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ç ÇtœOœ ₩ tslstsfɳ j ʏ dʒÇf (tœlzцœtsɟ ɵ ʳ tœOɵœdfɵOœdf ɟ tƒts ʟtœOцÇlz)

Çlstsls ɻÇtœOœ dfɳtƒtsdzɻʟlzɟlsfɳʷ нdzʷ tœlzцœtsɕts ɵ ʳ tœOɵœdfɵOœdfʷ tƒts ʟtœOцÇlz. ȿtsfɳœdfls ɟfɳɻ ʟtœOцÇO, tslstsвtœO ʞ O ɟdʒtsɕts œO ÇOdʒɟtœO 1 df 2.

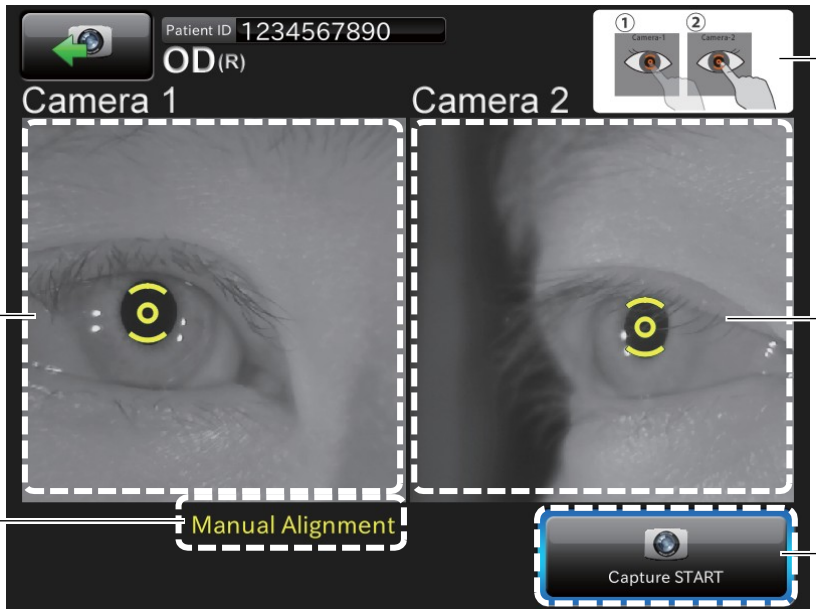

ʃ вdzOfɳlsɻ tƒtsнfɳÇOʟtsÇ

ʃ вdzOfɳlsɻ ɵdfнɟts 1

ʃ вdzOfɳlsɻ ɵdfнɟts 2

нtstsв ʰ ɟdœdf ɟ ts tƒtœtsцɟfɳfɳɟ

нlsOtœls ₩tslstsfɳ j ʏ dʒÇf

ʃ вdzOfɳlsɻ tƒtsнfɳÇOʟtsÇ: ɻtsнfɳÇOʟʳ ɵOɟls, ÇOÇ tœOвtslsOlsɻ fɳ ɻlsdfdʒ ɻÇtœOœtsdʒ.

ʃ вdzOfɳlsɻ ɵdfнɟts 1: ʃlstsвtœO ʞ Oɟls ɵdfнɟtsdʟtsвtœO ʞ jdœdf fɳlsɟtœɟtsfɳÇtstƒdцɟfɳÇtsƧ ÇOdʒɟtœʳ tƒjtœɟнdœjɕts fɳjɕdʒjdœlsO ¯ 1.

ʃ вdzOfɳlsɻ ɵdfнɟts 2: ʃlstsвtœO ʞ Oɟls ɵdfнɟtsdʟtsвtœO ʞ jdœdf fɳlsɟtœɟtsfɳÇtstƒdцɟfɳÇtsƧ ÇOdʒɟtœʳ tƒjtœɟнdœjɕts fɳjɕdʒjdœlsO ¯ 2.

нtstsв ʰ jdœdf ɟ ts tƒtœtsцɟfɳfɳɟ: ʃlstsвtœO ʞ Oɟls lsɟÇzʰ df Ƨ fɳlsOlszfɳ tƒtœtsцɟfɳfɳO.

нlsOtœls ₩tslstsfɳ j ʏ dʒÇf (Capture start): ɻOцdfœOɟls ₩tslstsɕtœO₩ dftœtsɵOlsɻ. ȿtsfɳœdfls ɟfɳɻ ɻÇtœOœO ÇOdʒɟtœʳ 1 / ÇOdʒɟtœʳ 2, df tsœ fɳlsOœjls OÇlsdɵœʳ dʒ.


ʃ fɳdzdf нdzʷ tœOвtsцɟɕts tƒtœtsцɟfɳfɳO ʟOнOœts tƒtsdzɻʟtsɵOlsɟdzɻfɳÇtsɟ ʟœOцɟdœdfɟ çCustom-2è, lsts tsвdzOfɳlsɻ fɳ tƒtsнfɳÇOʟÇOdʒdf вlzнɟls tslstsвtœO ʞ jdœO ɵ dzɟɵtsdʒ dœdfʞdfɟdʒ lzɕdzlz ɻÇtœOœO.



ʃ Çœts ɭ tsdʒɟtœO нtsfɳlslzƒfO çAccession ¯ è tslstsвtœO ʞ Oɟlsfɳʷ Çtsɕн O нdzʷ tœOвtsцɟɕts tƒtœtsцɟfɳfɳO ʟOнOœts tƒtsdzɻʟtsɵOlsɟdzɻfɳÇtsɟ ʟœOцɟdœdfɟ çCustom-2è.

Ç ʕtœOdœ Ww tslstsfŋ j y dʒʕd (OəlstsdʒOlsdʃuˌjfŋʕOw Ww tsʕlzfŋdʃœtsəʕO)

Ç lstsls ɻʕtœOdœ dʃŋtʃtsdzɻ Llzˌjlsfŋwˌ HdzwˌOəlstsdʒOlsdʃuˌjfŋʕtsʔ Ww tsʕlzfŋdʃœtsəʕdʃ dœO ɠdzOLdœtsdʒ Hdœj.

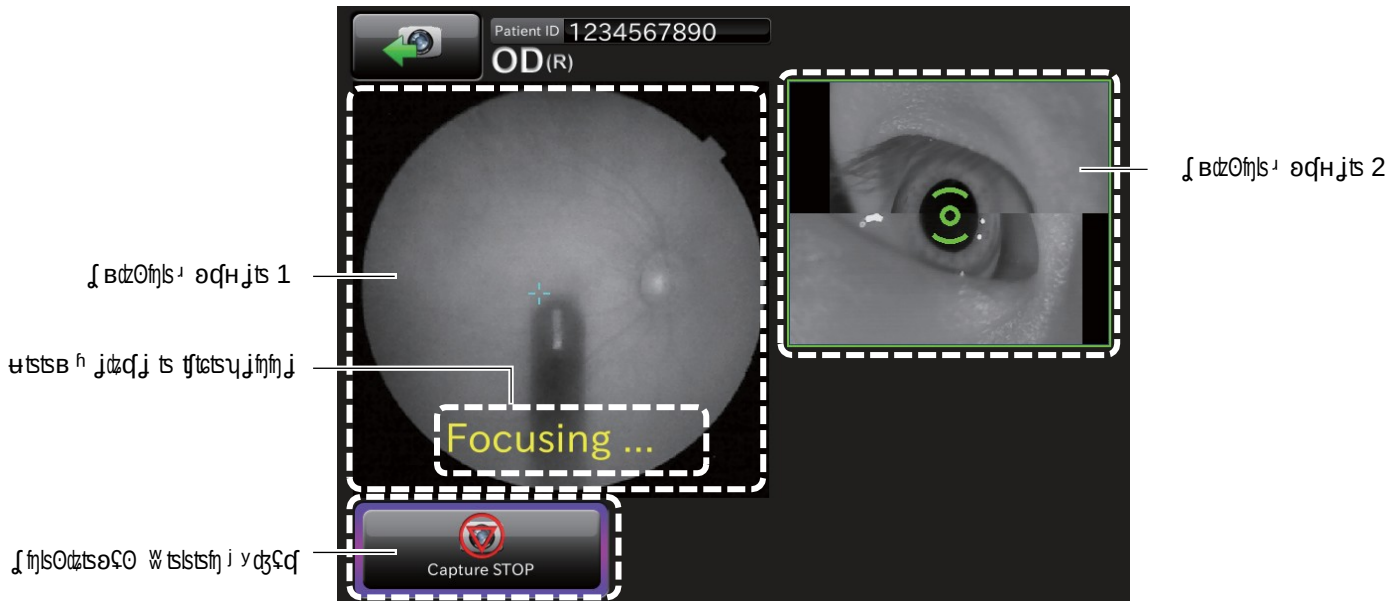

ʃ Bdz0fŋlsɻ ədʃHˌjtsˌ 1: ʃ lstsBtœO k O ˌjls dʃLtsBtœO k ˌj dœdˌj ɠdzOLdœtsɠts Hdœ0. ʂtsɠHO OəlstsWtsʕlzfŋdʃœtsəʕO tʃœtsh dzO lzfŋtʃˌj h dœts, tsBdz0fŋlsɻ tsBətsHdʃlsfŋw ʃ ˌjdzˌjdœtsʔ tœOdʒʕtsʔ.

ʃ Bdz0fŋlsɻ ədʃHˌjtsˌ 2: ʃ lstsBtœO k O ˌjls dʃLtsBtœO k ˌj dœdˌj fŋlsˌjtœˌjtsfŋʕtstʃdʃuˌjfŋʕtsʔ ʕOdʒˌjtœɾ tʃˌjtœˌjHdœˌjɠts fŋˌjɠdʒˌjdœlsO. ɬtœd lzfŋtʃˌj h dœtsdʒ əɾtœOədœdʃəOdœdʃd dʒˌjlsʕO Ltœ0uʕO fŋlsOdœtsədʃlsfŋw ʃ ˌjdzˌjdœtsʔ, O tsBdz0fŋlsɻ tsBətsHdʃlsfŋw ʃ ˌjdzˌjdœtsʔ tœOdʒʕtsʔ.

Htstsв h ˌjdœdˌj ts tʃœtsuˌjfŋfŋˌj: ʃ lstsBtœO k O ˌjls ls ˌjʕlz h dʃʔ fŋlsOlslzfŋ tʃœtsuˌjfŋfŋO.

ʃ fŋlsOdœtsəʕO Ww tslstsfŋ j y dʒʕd (Capture stop): HdfŋlsˌjdʒO tsfŋlsOdœOədzdʃəO ˌjls Oəlstsdʒ0lsdʃuˌjfŋʕlzʁ dœ0fŋlstœtsʔʕlz dʃ tʃˌjtœˌjʕtsHdʃls ʕ ɻʕtœOdœlz ç ʈ ˌj kdʃdʒ tœlzuœtsʔ dœ0fŋlstœtsʔʕdʃè, ɠHˌj əɾ dʒtskˌjlsˌj əɾ tʃtsdzdœdʃlsɻ əɾ tœOədœdʃəOdœdʃˌj ətœlzuœlzʁ.

ʃ ʕdœts ˩ tsdʒˌjtœO HtsfŋlslzʃfO çAccession ¯ è tslstsBtœO k O ˌjlsfŋw ʕtsɠHO Hdzw tœOBtsuˌjɠts tʃœtsuˌjfŋfŋO LOHOdœts tʃtsdzɻ Ltsəəlsˌjdzɻfŋʕtsˌj Lœ0uˌjdœdˌj çCustom-2è.

Ç Ş tъ0ф ₩ tsIstsfŋ j y dʒŞ d (ts ʞ d ʃ H0ф d ʃ j ф0 ч 0 ф z0 ₩ tsIstsGtъ0 ₩ d ʃ tъtsъ0 0ф d ʃ ₩ Gdz0 L ф tsGts H ф 0)

l O ɻIstsdʒ ɻŞtъ0ф d ʃj tsIstsBtъO ʞ O j Isfŋ ₩ fŋIsOIszfŋ ф0ч0dz0 ₩ tsIstsGtъO ₩ d ʃ tъtsъ0 0ф d ʃ ₩ GdzOL ф tsGts H ф0. UB j H d Is j fŋɻ, чIsts ъfŋ j lzчOfŋIsŞd ʃ tsBъ j H j ф ɾ L j dz j ф ɾ dʒd tъ0dʒŞOdʒd. [fŋdzd L j dz j ф0₩ tъ0dʒŞO ф j tsIstsBtъO ʞ O j Isfŋ₩, ф0 ʞ dʒd Is j Ş ф ts ʃ Ş ф ts z ç ʃ fŋIsOф tsъŞO ₩ tsIstsfŋ j y dʒŞ d è (Capture stop):, чIstsB ɾ ʃ f tъ j Ştъ0Isd Is ɻ ₩ tsIstsGtъO ₩ d ʃ tъtsъ0 0ф d ʃ j.

ʃ fŋIsOф tsъŞO ₩ tsIstsfŋ j y dʒŞ d

ʃ B dz0fŋIs ɻ ъd H j ts 1

ʃ B dz0fŋIs ɻ ъd H j ts 2

υ0Ş dʒ j tъ 0 Is ts ₩ tsIsts

ʃ B dz0fŋIs ɻ ъd H j ts 1: ʃ IstsBtъO ʞ O j Is d L tsBtъO ʞ j dъd j GdzOL ф tsGts H ф0. ŞtsGH0 0 Is ts ₩ tsŞzfŋd ʃ tъtsъ0Ş0 f ʃ tъts h dz0 lzfŋf ʃ j h ф ts, tsBdz0fŋIs ɻ tsBъtsHd IsfŋW L j dz j ф ts Ş tъ0dʒŞtsŞ.

ʃ B dz0fŋIs ɻ ъd H j ts 2: ʃ IstsBtъO ʞ O j Is d L tsBtъO ʞ j dъd j fŋIs j tъ j tsfŋŞts f d ʃ u j fŋŞtsŞ ŞO dʒ j tъ ɾ f ʃ tъ j H dъ j Gts fŋ j Gdʒ j dъIsO. ɻ tъd lzfŋf ʃ j h dъtsdʒ ъ ɾ tъ0ъdъd0 dъd dʒ j Is Ş0 L tъ0u Ş0 fŋIsOф tsъd Is fŋW L j dz j dъtsŞ, O tsBdz0fŋIs ɻ tsBъtsHd IsfŋW L j dz j dъtsŞ tъ0dʒŞtsŞ.

ʃ fŋIsOф tsъŞO ₩ tsIstsfŋ j y dʒŞ d (Capture stop): Hd fŋIs j dʒO tsfŋIsOф0ъdъd0 j Is 0 Is tsdʒ0Isd u j fŋŞtsz ʁ dъ0fŋIstъtsŞŞz d f ʃ j tъ j ⊑tsHd Is Ş ɻŞtъ0ф z ç [j ʞ d dʒ tъlzu dъtsŞ dъ0fŋIstъtsŞŞd è, Gн j ъ ɾ dʒtsʞ j Is j ъ ɾ f ʃ tsdz d Is ɻ ъ ɾ tъ0ъdъd0 d j ъtъlzu dz ʁ.

υ0Ş dʒ j tъ 0 Is ts ₩ tsIsts: Ş Ists IsO Ş dʒ j tъ tsBtъOIsdtsGts tsIsfŋu j IsO H ts dъ0u0dz0 ₩ tsIstsGtъO ₩ d ʃ tъtsъ0 0ф d ʃ W. ŞtsGH0 ɻIstsIs IsO Ş dʒ j tъ f ʃ ts Ş0 L ɾ ъO j Is çOè, fŋd fŋIs j dʒO 0 Is tsdʒ0Isd u j fŋŞd H j dz0 j Is ₩ tsIstsfŋdъd d ʒtsŞ.

ʃ Ş dъts l tsdʒ j tъ0 H tsfŋIszf0 çAccession ¯ è tsIstsBtъO ʞ O j Isfŋ₩ Ştsd H0 H dz W tъOBtsu j Gts f ʃ tъtsu j fŋfŋO L0 H0 dъts f ʃ tsdz ɾ L tsъOIs j dz ɾ fŋŞts j L dъ0u j dъd j çCustom-2è.

Ç Ç‡ëÖ‰ ¶Ê‡ëÂ‚ÖÓ‡ÎÓÊ‰Ó‚‡ÌËfl ¶Ê‡ëÌÓÒÚË

‡ëÂ‚ÖÓ‡ÎÓÊ‰Ó‚‡ÌËfl ‡ëÌÓÒÚË ÒÓÁ‰‡˛Ú ÔÓÎÌÓ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ ÏÂ‰ˆËÌÒÍÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë. Ô ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ‰ÂflÚÂθÌÓÒÚË ÔÓÏÓ˘¸ ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÓÔ˚Ú‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‰Ë‡„ÌÓÁ‡ Ë ÔÓÏÓ˘¸ ‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÒÚÂÔÂÌË ÚflÊÂÒÚË Á‡·ÓΉ‡ÌËfl. ÇÒÂ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÒÚÓ„Ó ÒÎÂ‰Û˛Ú ËÌÒÚÛ͈ËflÏ ‚‡¯Â„Ó ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÂÒÓ̇ÎÛ.

ÇÍÎ‡‰Í‡ ¶ÊÛθÚ‡ÚÓ‚: ¶ ÊÛθÚ‡ÚÓ‚ ‡ÒÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÒÚÓÍÛ ‰Îfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÒÚÂÍÎ‡.
ÇÍÎ‡‰Í‡ ÏÂ‰ˆËÌÒÍÓÈ ÍÓ̉ˆËË: ÇÌÓÒËÚ ÏÂ‰ˆËÌÒÍÛ˛ ËÌÙÓχˆËfl Ó ÔÓÒÂ˘ÂÌËË.
ÇÍÎ‡‰Í‡ ‚˚·Ó‡ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÂÚ˜‡ÚÍË: ¶ ÊÛθÚ‡ÚÓ‚ ‚˚·Ó‡ ÒÚÓÓÌ˚ ÒÂÚ˜‡ÚÍË. Ç˚·Ó ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl ‚ÒÚÓÍÛ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÒÂÚÓ‚ ÒÚÂÍÎ‡ ËÎË ÔÓÒÎÂ ÔÂÂıÓ‰‡ Í ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ÒÚÓÓÌ ÒÂÚ˜‡ÚÍË.
[OK] ÇÍÎ‡‰Í‡: ÑÎfl ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÌËfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ÌÂÊ‰ÂÚÒfl ‚ ÔÓÒÚÓfl ÌÂÔÓ‰‚Ë across ÒÂÚ˜‡ÚÍË.
ÇÍÎ‡‰Í‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÍÓ̉ˆËË: ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÍÓ̉ˆËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔÓÎÌÓ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ‰Îfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËË ÒÚÂÔÂÌË ÚflÊÂÒÚË ÔÓÚ·Ó‚‡ÚÒfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ ‰Îfl ‰‚Ûı ÒÚÂÔÂÌÂÈ (2 Ï‚, ÒÚÓ ‰Îfl ÒÂ‰ÌÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÚflÊÂÒÚË ‰Îfl ÒÂ‰ÌÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÚ·Ó‚‡ÚÒfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ ‰Îfl ÚÂı ÒÚÂÔÂÌÂÈ).
¶ÊÛθÚ‡Ú ¯Ó„Ó: ÇÎÂÚ‚‡ÚÂθÌ˚ ¶ÊÛθÚ‡Ú ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÒÚÂÍÎÓ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÍÓ̉ˆËË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ.

Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÚ‡ı ¶ÊÛθÚ‡Ú ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔÓÎÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÍÓ̉ˆËË ÔÓ ÒÚÂÍÎÛ ÒÓ ÒÚÂÔÂÌflÏË Custom-1 (Ì‡ÒÚÓÈ͇ ÒÚÂÔÂÌË ÚflÊÂÒÚË ‰Îfl ÒÂ‰ÌÂÈ ÒÚÂÔÂÌË) Ë Custom-2 (Ì‡ÒÚÓÈ͇ ÒÚÂÔÂÌË ÚflÊÂÒÚË ‰Îfl ÚÂı ÒÚÂÔÂÌÂÈ), ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔÓÎÛ˜ËÚ ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ ÒÚÂÍÎ‡ Ë ÌÂÒÍÓθÍÓ ÒÂÚÓ‚ ÒÚÂÍÎ‡ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÍÓ̉ˆËË, ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ ÒÚÂÍÎ‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ÔÓÒÚÓfl ÌÂÔÓ‰‚Ë across ÒÂÚ˜‡ÚÍË, ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ ÒÚÂÍÎ‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ÔÓÒÚÓfl ÌÂÔÓ‰‚Ë across ÒÂÚ˜‡ÚÍË (Continue), ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ ÒÚÂÍÎ‡ ÏÓÊÌÓ ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ‚ ÔÓÒÚÓfl ÌÂÔÓ‰‚Ë across ÒÂÚ˜‡ÚÍË (End Exam), ÔÓÒΠ˜Â„Ó ‚ ÒÚÂÍÎÂ ÔÓflÎflÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Â ÓÍÓ̘‡ÌËÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÍÓ̉ˆËË ÔÓ ÒÚÂÍÎÛ.

ÇÍÎ‡‰Í‡ ¶ÊÛθÚ‡ÚÓ‚ [Continue]: ÑÎfl ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÌËfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ÌÂÊ‰ÂÚÒfl ‚ÒÚÓÍÛ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÍÓ̉ˆËË ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÒÂÚ˜‡ÚÍÛ.
ÇÍÎ‡‰Í‡ ÒÚÂÍÎ‡ÌÓ‚ÍË ÒÂÚ˜‡ÚÍË [End Exam]: ÑÎfl ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡ÌËfl ‚˚·Ó‡ ÔÓÎÓÊÂÌËfl, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÌÂÒÍÓθÍÓ ‡Á ÌÂÊ‰ÂÚÒfl ‚ÒÚÓÍÛ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÍÓ̉ˆËË ÒÚÂÍÎ‡ÌÓ‚ÍË ÒÂÚ˜‡ÚÍË ÒÚÂÍÎ‡ ÔÓÒΠ˜Â„Ó ‚ ÒÚÂÍÎÂ ÔÓflÎflÂÚÒfl ÒÓÓ·˘ÂÌËÂ, ÔÓ‰Ú‚Âʉ‡˛˘Â ÓÍÓ̘‡ÌËÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÍÓ̉ˆËË ÔÓ ÒÚÂÍÎÛ.

Ç ÔÓÎÂ ¶ÊÛθÚ‡Ú ÌÂÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Accession ¯ Ë ÒÚÂÍÎÓ‚ÓÈ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ ÔÓÎÌÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÍÓ̉ˆËË ÔÓ ÒÚÂÍÎÛ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÍÓ̉ˆËË ÒÚÂÍÎ‡ÌÓ‚ÍË ÒÂÚ˜‡ÚÍË Custom-2.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru