**Банкетка модель БМ СГКН.752000**
**Банкетка модель БМ СГКН.752003**
**Банкетка модель БМ.03 СГКН.752001**
**Банкетка модель БМ.03 СГКН.752004**



**Банкетка модель БМ.01 СГКН.752005**
**Банкетка модель БМ.01 СГКН.752007**
**Банкетка модель БМ.02 СГКН.752002**
**Банкетка модель БМ.02 СГКН.752006**



**Банкетка модель БМ СГКН.752008**
**Банкетка модель БМ.04 СГКН.752009**
**Банкетка модель БМ.05 СГКН.752010**
**Банкетка модель БМ.03 СГКН.752011**



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## Банкетка медицинская
## моделей БМ, БМ.01, БМ.02, БМ.03, БМ.04, БМ.05

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Банкетка (в дальнейшем - изделие) предназначена для сидения посетителей в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Каркас изделия сварной, выполнен из стальной трубы с полимерным покрытием. Максимальная нагрузка на изделие 240 кг.

Масса изделия — не более 50 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в собранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **БМ СГКН.752000** | 1500x560x880 | Со спинкой; сидение и спинка – дерево (ламинированное ДСП), пенополиуретан и винилискожа |
| | | **БМ.03 СГКН.752001** | 1000x560x880 | |
| 2 | | **БМ СГКН.752003** | 1500x560x880 | Со спинкой; сидение и спинка – дерево (ламинированное ДСП) |
| | | **БМ.03 СГКН.752004** | 1000x560x495 | |
| 3 | | **БМ.01 СГКН.752005** | 1500x400x495 | Без спинки; сидение – дерево (ламинированное ДСП), пенополиуретан и винилискожа |
| | | **БМ.02 СГКН.752002** | 1000x400x495 | |
| 4 | | **БМ.01 СГКН.752007** | 1500x400x495 | Без спинки; сидение – дерево (ламинированное ДСП) |
| | | **БМ.02 СГКН.752006** | 1000x400x495 | |
| 5 | | **БМ СГКН.752008** | 1500x560x880 | Трехместная; со спинкой; спинка и сидения- металлические |
| | | **БМ.03 СГКН.752011** | 1000x560x880 | Двухместная; со спинкой; спинка и сидения- металлические |
| | | **БМ.04 СГКН.752009** | 1980x560x880 | Четырехместная; со спинкой; спинка и сидения- металлические |
| | | **БМ.05 СГКН.752010** | 2500x560x880 | Пятиместная; со спинкой; спинка и сидения- металлические |

## 4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 10. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

**Кушетка модель КМ СГКН.751000**
**Кушетка модель КМ СГКН.751003**
**Кушетка модель КМ СГКН.751004**



**Кушетка модель КМ.01 СГКН.751001**
**Кушетка модель КМ.01 СГКН.751002**



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## Кушетка медицинская моделей КМ, КМ.01

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кушетка (в дальнейшем - изделие) предназначена для осмотра посетителей в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сидение и подголовник изделия – деревянные (ламинированное ДСП), обшитые винилискожей с наполнением пенополиуретаном. Максимальная нагрузка на изделие - 150 кг.

Масса изделия — не более 45 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется в собранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особености конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **КМ СГКН.751000** | 1970x600x530 | Каркас металлический; угол наклона подголовника регулируется с помощью многопозиционного механизма Multiflex |
| | | **КМ СГКН.751003** | 1970x600x650 | |
| | | **КМ СГКН.751004** | 1970x650x530 | |
| 2 | | **КМ.01 СГКН.751001** | 1850x594x510 | Каркас – массив дерева; угол наклона подголовника имеет фиксированное значение |
| | | **КМ.01 СГКН.751002** | 1850x594x460 | |

## 4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для того, чтобы опустить подголовник, необходимо поднять его максимально вверх, а затем опускать.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 10. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

Рис.1

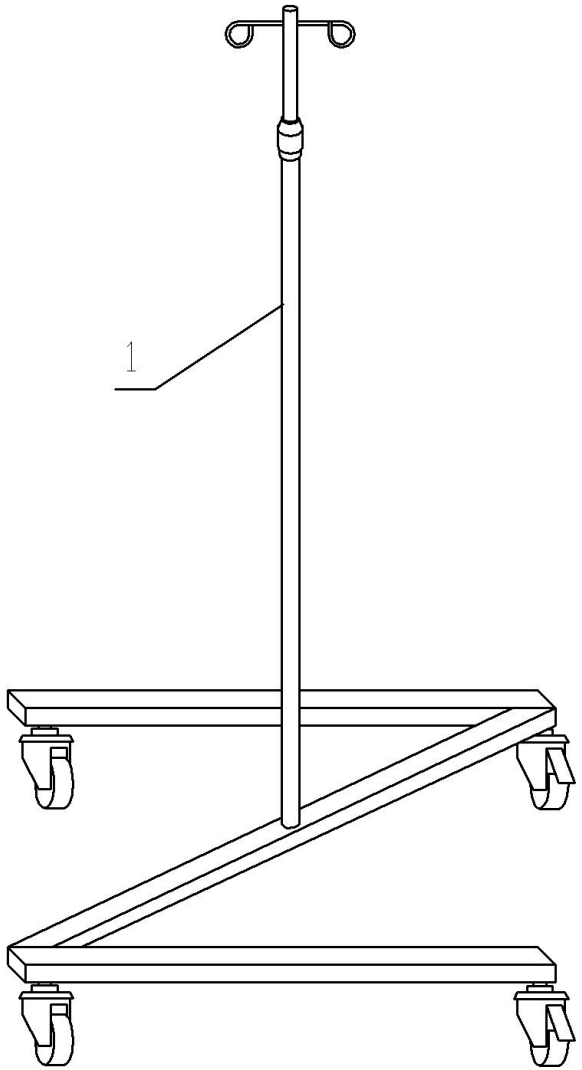


# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## Штатив для вливания
## модель ШДВ

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Штатив для вливания (в дальнейшем – изделие) предназначен для использования в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из стальных деталей с полимерным покрытием и выполнено в мобильном варианте, т.е. имеет четыре подвижных колеса. Имеет подвижную стойку за счет которой высоту изделия можно регулировать. Стойка фиксируется при помощи цангового зажима. Стойка выполнена из нержавеющей трубы. Максимальная нагрузка на изделие не более 5 кг.

Масса изделия — не более 6 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

Изделие поставляется в собранном виде.

В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт.

| Поз. на рис.1 | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Штатив модель ШДВ СГКН.753001 | 1 |

## 4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки секций, необходимо вручную приподнять секцию и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 10. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

**Стойка телескопическая инфузионная**



**Ограждение кроватное боковое**

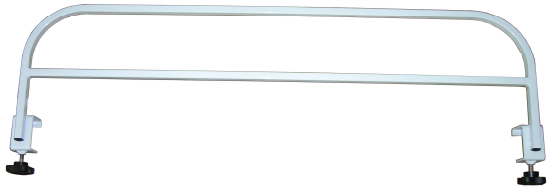


**Приспособление типа “Гусь” для приподнятия пациента**



**Рама Балканского**



**Подставка под “судно”**

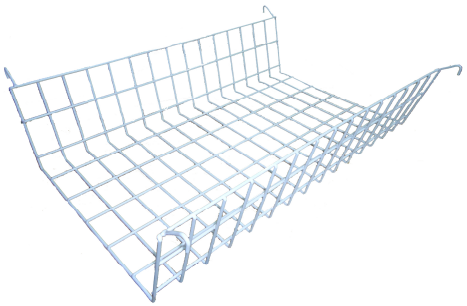

**Ступенька двухуровневая**



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## Принадлежности

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Принадлежности (в дальнейшем - изделие), поставляемые по желанию клиента, расширяют функциональные возможности больничных кроватей.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЯ

Изделия изготавливаются из стальных деталей с полимерным покрытием. Отдельные части и детали могут изготавливаться из нержавеющей стали, пластика.

Масса изделия — не более 10 кг.

### СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ИНФУЗИОННАЯ

Имеет выдвижную верхнюю стойку, крючки (2 шт.), держатели флаконов (2 шт.) из нержавеющей стали. Нижняя стойка оснащена удобным кронштейном для крепления к кровати.

Высота, мм. – 940…1570.

В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт. и паспорт – 1 шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Применяемость |
|---|---|---|---|
| 1 | | **СТИ СГКН.000001** | модели КБ.15 |
| | | **СТИ СГКН.000008** | модели КБ.07 |
| | | **СТИ СГКН.000009** | модели КБ.01÷05, КБ.09, КБ.12, КБ.13 |

### ОГРАЖДЕНИЕ КРОВАТНОЕ БОКОВОЕ

Оснащено удобными кронштейнами для быстрого и легкого крепления к кровати.

Габаритные размеры (длина, высота), мм. – 1039х290.

В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 2 шт. и паспорт – 1 шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Применяемость |
|---|---|---|---|
| 1 | | **ОКБ СГКН.000002** | модели КБ.15 |
| | | **ОКБ СГКН.000010** | модели КБ.07 |
| | | **ОКБ СГКН.000011** | модели КБ.01÷05, КБ.09, КБ.12, КБ.13 |

### ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТИПА “ГУСЬ” ДЛЯ ПРИПОДНЯТИЯ ПАЦИЕНТА

Оснащено кронштейном и дополнительным уголком, которые обеспечивают быстросъемность и легкую установку изделия. Комплектуется ручкой медиуинской для облегчения приподнятия пациента.

Габаритные размеры (длина, высота), мм. – 850х1366.

В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт. и паспорт – 1 шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Применяемость |
|---|---|---|---|
| 1 | | **УПП СГКН.000003** | модели КБ.01÷05, КБ.09, КБ.12, КБ.13, КБ.15 |

### РАМА БАЛКАНСКОГО

Оснащена кронштейнами и дополнительными уголками для быстрого и легкого крепления. Поперечная штанга рамы регулируется по высоте с шагом 100 мм.,

Габаритные размеры (длина, высота), мм. – 2100х1485.

В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт. и паспорт – 1 шт

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Применяемость |
|---|---|---|---|
| 1 | | **РБ СГКН.000004** | модели КБ.01÷05, КБ.09, КБ.12, КБ.13, КБ.15 |

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

### ПОДСТАВКА ПОД “СУДНО”

Оснащена крючками для быстрой навески на ложе кровати и снятия.

Габаритные размеры, мм. – 655х275х220.

В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт. и паспорт – 1 шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Применяемость |
|---|---|---|---|
| 1 | | **ППС СГКН.000005** | модели КБ.01÷05, КБ.07÷КБ.13, КБ.15 |

### СТУПЕНЬКА ДВУХУРОВНЕВАЯ

Для удобства пациента, основание ступенька имеет противоскользящее покрытие.

В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1 шт. и паспорт – 1 шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм. | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **СД СГКН.000006** | 600х550х440 | модели КБ.01÷05, КБ.07÷КБ.13, КБ.15 |
| 3 | | **СД СГКН.000007** | 600х550х260 | |

## 3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь. Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 5. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by


## 8. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

**Кровать больничная модель КБ.01 СГКН.750001**
**Кровать больничная модель КБ.01 СГКН.750073**

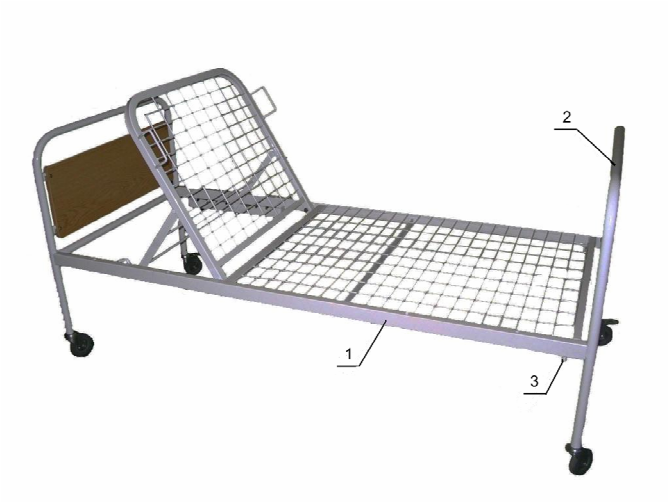


**Кровать больничная модель КБ.01 СГКН.750023**

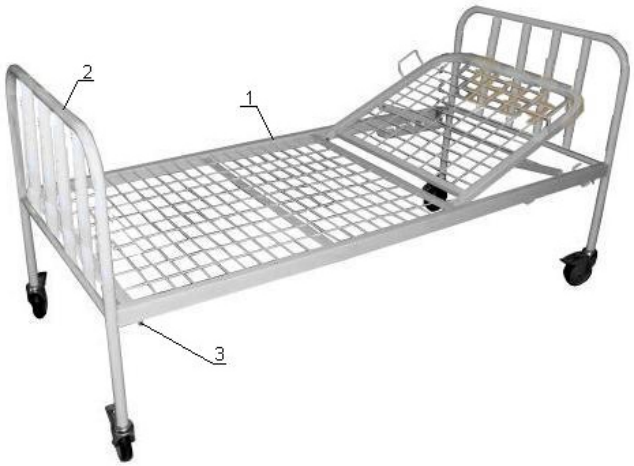


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
## модель КБ.01

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием и выполнено в мобильном варианте, т.е. оснащено четырьмя подвижными опорами Ø125 мм, две из них с тормозом. Имеет регулируемую головную секцию. Угол наклона подголовника регулируется от 0º до 60º. Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Габаритные размеры, мм – 2040x902x1008.

Масса изделия – не более 80 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.01 СГКН.750001** | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки |
| 2 | | **КБ.01 СГКН.750023** | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы |
| 3 | | **КБ.01 СГКН.750073** | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки головной секции необходимо вручную приподнять подголовник и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**


**Кровать больничная модель КБ.02 СГКН.750075**
**Кровать больничная модель КБ.02 СГКН.750077**

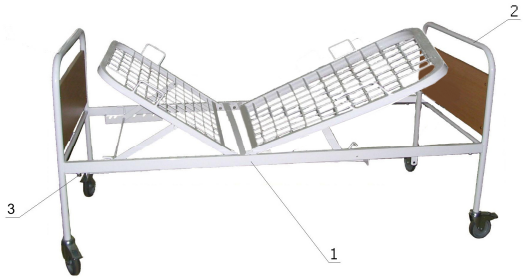



**Кровать больничная модель КБ.02 СГКН.750076**

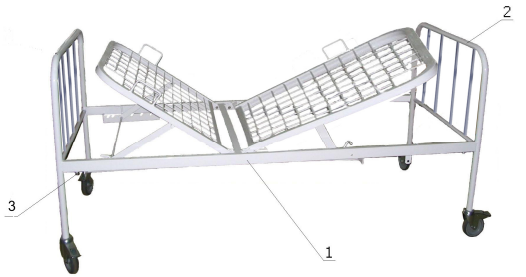


**Кровать больничная модель КБ.02 СГКН.750078**
**Кровать больничная модель КБ.02 СГКН.750080**

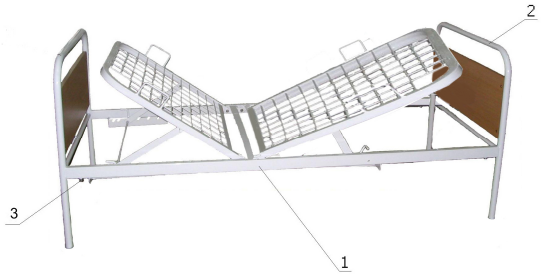


**Кровать больничная модель КБ.02 СГКН.750079**

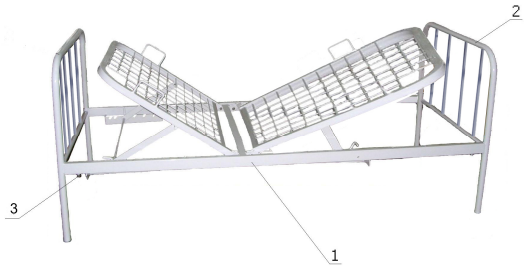


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

# КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
# модель КБ.02

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Имеет регулируемую головную и ножную секции. Регулировка углов наклона секций механическая. Угол наклона подголовника регулируется от 0º до 60º. Угол наклона ножной секции регулируется от 0° до 30° Максимальная нагрузка на изделие не более 150 кг.

Масса изделия – не более 80 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.02 СГКН.750075** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 2 | | **КБ.02 СГКН.750076** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 3 | | **КБ.02 СГКН.750077** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 4 | | **КБ.02 СГКН.750078** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| 5 | | **КБ.02 СГКН.750079** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; неподвижные опоры |
| 6 | | **КБ.02 СГКН.750080** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; неподвижные опоры |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки секций, необходимо вручную приподнять секцию и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

**Кровать больничная модель КБ.03 СГКН.750003**
**Кровать больничная модель КБ.03 СГКН.750074**

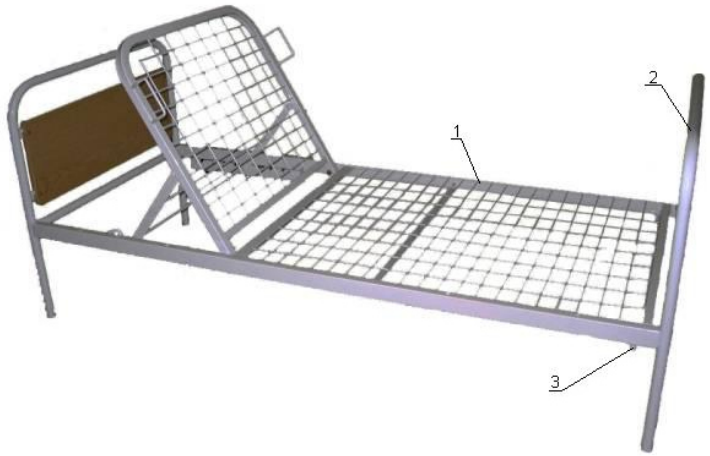


**Кровать больничная модель КБ.03 СГКН.750004**

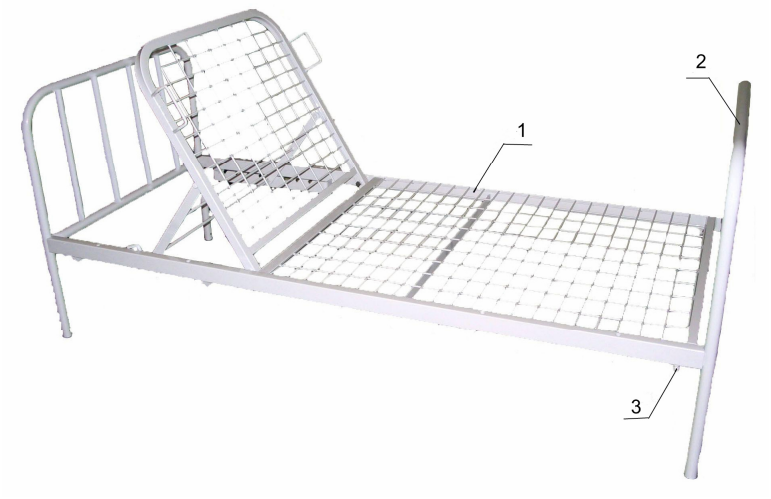


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
## модель КБ.03

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Имеет регулируемую головную секцию. Угол наклона подголовника регулируется от 0º до 60º. Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Габаритные размеры, мм – 2040х902х1015.

Масса изделия – не более 80 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.03 СГКН.750003** | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки |
| 2 | | **КБ.03 СГКН.750004** | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы |
| 3 | | **КБ.03 СГКН.750074** | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки головной секции необходимо вручную приподнять подголовник и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**


**Кровать больничная модель КБ.04 СГКН.750005**
**Кровать больничная модель КБ.04 СГКН.750082**

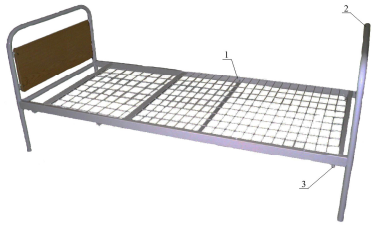



**Кровать больничная модель КБ.04 СГКН.750055**

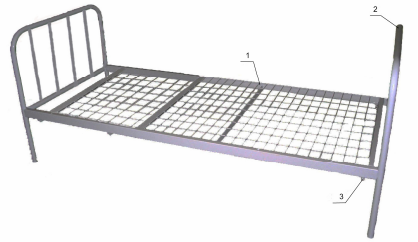


**Кровать больничная модель КБ.04 СГКН.750057**
**Кровать больничная модель КБ.04 СГКН.750081**

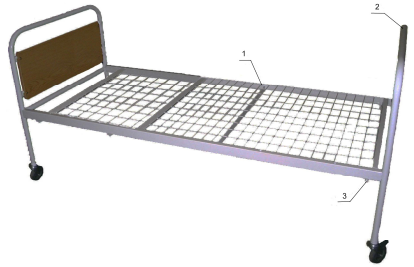


**Кровать больничная модель КБ.04 СГКН.750052**

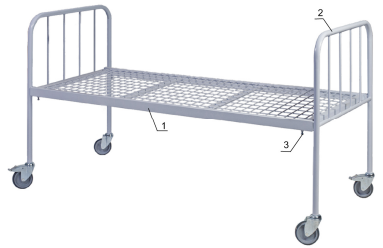


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

# КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
# модель КБ.04

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Ложе изготовлено из стального круга, сваренного между собой в виде решетки. Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Масса изделия – не более 80 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.04 СГКН.750005** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| 2 | | **КБ.04 СГКН.750055** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; неподвижные опоры |
| 3 | | **КБ.04 СГКН.750052** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 4 | | **КБ.04 СГКН.750057** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 5 | | **КБ.04 СГКН.750081** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 6 | | **КБ.04 СГКН.750082** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; неподвижные опоры |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Колесные опоры (при их наличии), оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**


**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750059**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750083**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750062**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750085**

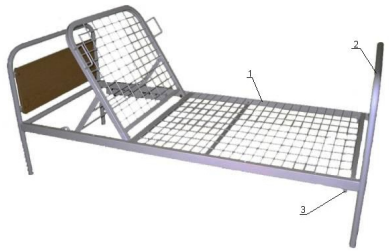


**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750060**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750084**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750063**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750086**

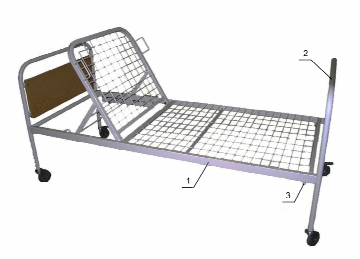


**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750006**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750007**




**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750053**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750058**
**Кровать больничная модель КБ.05 СГКН.750061**




Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

# КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
# модель КБ.05

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Имеет регулируемую головную секцию. Угол наклона подголовника регулируется от 0º до 60º. Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Масса изделия – не более 70 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.05 СГКН.750006** | 1440x702x1015 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; неподвижные опоры |
| | | **КБ.05 СГКН.750007** | 1640x702x1015 | |
| 2 | | **КБ.05 СГКН.750053** | 1640x702x1008 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| | | **КБ.05 СГКН.750058** | 1440x702x1008 | |
| | | **КБ.05 СГКН.750061** | 1640x902x1008 | |
| 3 | | **КБ.05 СГКН.750059** | 1440x702x1015 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| | | **КБ.05 СГКН.750062** | 1640x902x1015 | |
| 4 | | **КБ.05 СГКН.750060** | 1440x702x1008 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| | | **КБ.05 СГКН.750063** | 1640x902x1008 | |
| 5 | | **КБ.05 СГКН.750083** | 1440x702x1015 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; неподвижные опоры |
| | | **КБ.05 СГКН.750085** | 1640x902x1015 | |
| 6 | | **КБ.05 СГКН.750084** | 1440x702x1008 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| | | **КБ.05 СГКН.750086** | 1640x902x1008 | |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки головной секции необходимо вручную приподнять подголовник и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры (при их наличии), оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
## модель КБ.06

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней новорожденных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей и выполнено в мобильном варианте, т.е. оснащено четырьмя подвижными опорами Ø75 мм, две из них с тормозом. Изделие оснащено пластиковой ванной-кювезой. Угол наклона ванны-кювезы регулируется от -20º до +20º. Максимальная нагрузка на изделие не более 10 кг.

Габаритные размеры, мм – 900x460x990.

Масса изделия – не более 10 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в собранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (каркас – 1 шт., ванна-кювеза – 1 шт.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Особености конструкции |
|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.06 СГКН.750011** | Каркас изделия – нержавеющая сталь |
| 2 | | **КБ.06 СГКН.750015** | Каркас изделия – холоднокатаная сталь с полимерным покрытием |

## 4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для регулировки угла наклона ванны-кювезы, необходимо ослабить прижимной винт, расположенный на боковой стороне изделия, опустить или приподнять ванну-кювезу на необходимый угол и снова зафиксировать положение прижимным винтом. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 10. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

**Кровать больничная модель КБ.07 СГКН.750012**
**Кровать больничная модель КБ.07 СГКН.750087**

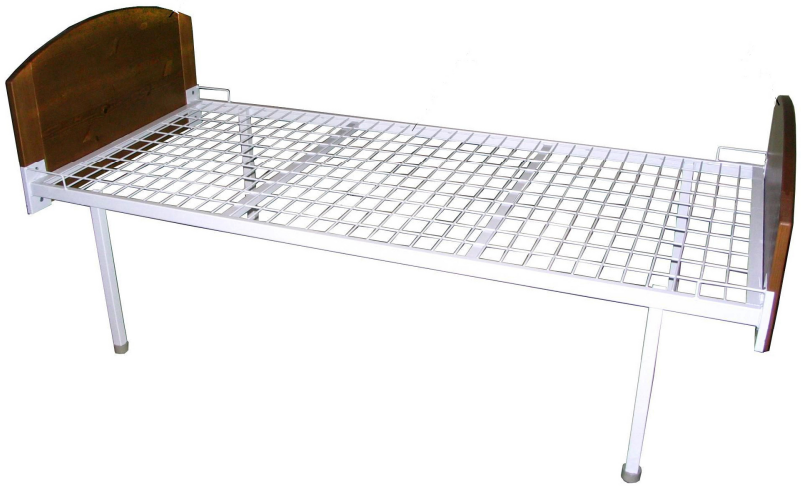

**Кровать больничная модель КБ.07 СГКН.750064**
**Кровать больничная модель КБ.07 СГКН.750088**



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

# КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
# модель КБ.07

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Ложе изготовлено из стального круга, сваренного между собой в виде решетки. Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Масса изделия – не более 75 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в собранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (кровать больничная – 1шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | КБ.07 СГКН.750012 | 2012x892x932 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| 2 | | КБ.07 СГКН.750064 | 2012x892x932 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 3 | | КБ.04 СГКН.750087 | 2012x892x932 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; неподвижные опоры |
| 4 | | КБ.07 СГКН.750088 | 2012x892x932 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |

## 4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Колесные опоры (при их наличии), оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 10. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001



## КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
## модель КБ.08


**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием и выполнено в мобильном варианте, т.е. оснащено четырьмя подвижными опорами Ø150 мм, две из них с тормозом. Ложе изделия односекционное. Изменение высоты ложа регулируется ножным гидравлическим насосом. В углах ложа установлены пластмассовые бампера для предохранения от ударов при перемещении, а по боковым сторонам установлены складывающиеся ограждения. Изделие дополнительно комплектуется съёмной инфузионной телескопической стойкой;

Максимальная нагрузка на изделие не более 150 кг.

Габаритные размеры, мм – 2170x720x445..820.

Масса изделия – не более 70 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в собранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (кровать больничная – 1шт., боковые ограждения – 2 шт., стойка телескопическая инфузионная – 1 шт. )

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.08 СГКН.750050** | Рентгенопроницаемое ложе |
| 2 | | **КБ.08 СГКН.750051** | Без рентгенопроницаемого ложа |

## 4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 10. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**


**Кровать больничная модель КБ.09 СГКН.750091**
**Кровать больничная модель КБ.09 СГКН.750093**

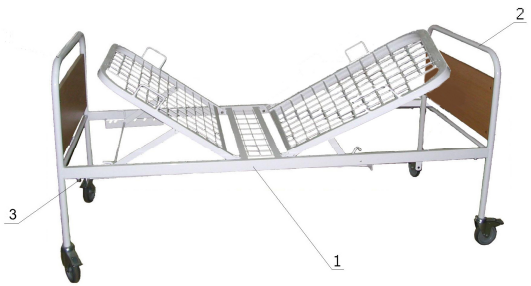



**Кровать больничная модель КБ.09 СГКН.750092**

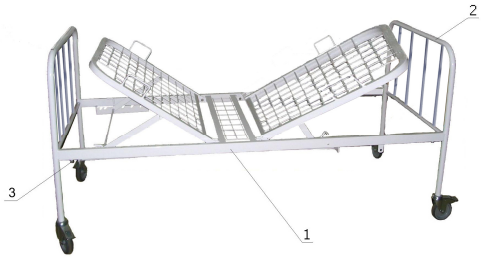


**Кровать больничная модель КБ.09 СГКН.750094**
**Кровать больничная модель КБ.09 СГКН.750096**

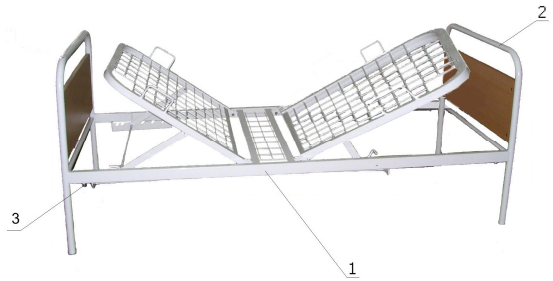


**Кровать больничная модель КБ.09 СГКН.750095**

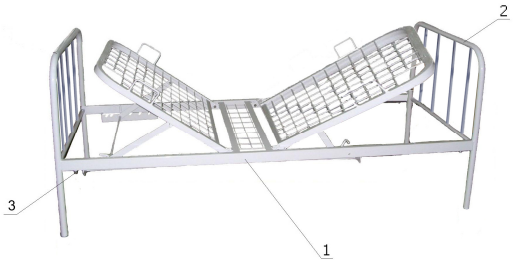


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

# КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
# модель КБ.09

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Ложе трёхсекционное (две секции регулируемые). Регулировка углов наклона секций механическая. Угол наклона подголовника регулируется от 0º до 60º. Угол наклона ножной секции регулируется от 0° до 30° Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Масса изделия – не более 80 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.09 СГКН.750091** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 2 | | **КБ.09 СГКН.750092** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 3 | | **КБ.09 СГКН.750093** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 4 | | **КБ.09 СГКН.750094** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| 5 | | **КБ.09 СГКН.750095** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; неподвижные опоры |
| 6 | | **КБ.09 СГКН.750096** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; неподвижные опоры |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки секций, необходимо вручную приподнять секцию и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**


**Кровать больничная модель КБ.12 СГКН.750099**
**Кровать больничная модель КБ.12 СГКН.750101**

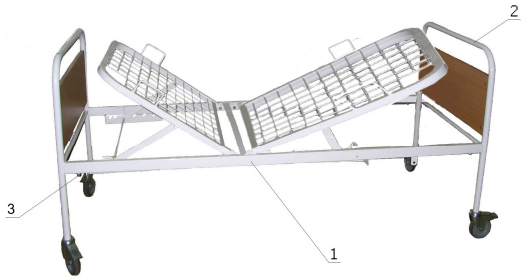



**Кровать больничная модель КБ.12 СГКН.750097**

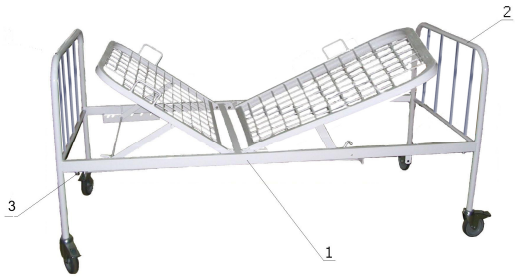


**Кровать больничная модель КБ.12 СГКН.750098**
**Кровать больничная модель КБ.12 СГКН.750100**

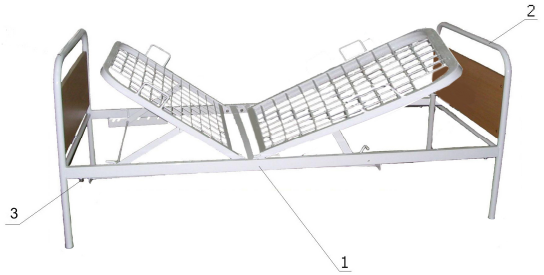


**Кровать больничная модель КБ.12 СГКН.750056**

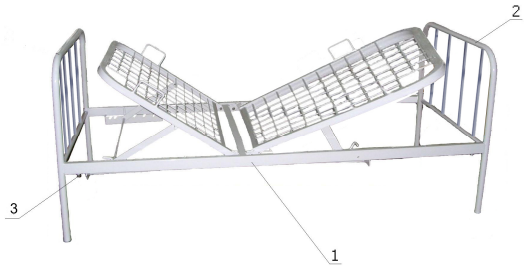


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

# КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
# модель КБ.12

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Имеет регулируемую головную и ножную секции. Регулировка углов наклона секций механическая. Угол наклона подголовника регулируется от 0º до 60º. Угол наклона ножной секции регулируется от 0° до 30° Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Масса изделия – не более 70 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | КБ.12 СГКН.750056 | 1440x702x1015 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; неподвижные опоры |
| 2 | | КБ.12 СГКН.750097 | 1440x702x1008 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 3 | | КБ.12 СГКН.750098 | 1440x702x1015 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| 4 | | КБ.12 СГКН.750099 | 1440x702x1008 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 5 | | КБ.12 СГКН.750100 | 1440x702x1015 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; неподвижные опоры |
| 6 | | КБ.12 СГКН.750101 | 1440x702x1008 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки секций, необходимо вручную приподнять секцию и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**


**Кровать больничная модель КБ.13 СГКН.750105**
**Кровать больничная модель КБ.13 СГКН.750107**

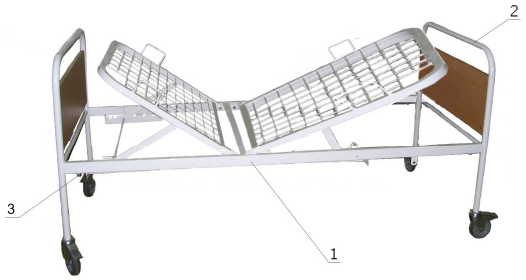



**Кровать больничная модель КБ.13 СГКН.750103**

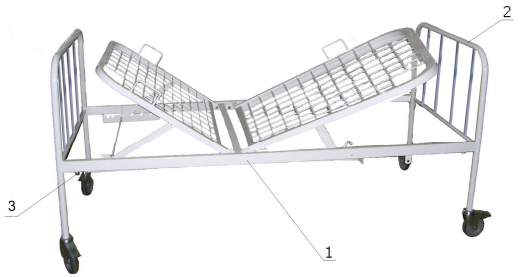


**Кровать больничная модель КБ.13 СГКН.750104**
**Кровать больничная модель КБ.13 СГКН.750106**

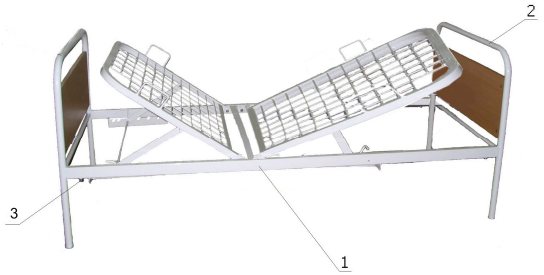


**Кровать больничная модель КБ.13 СГКН.750102**

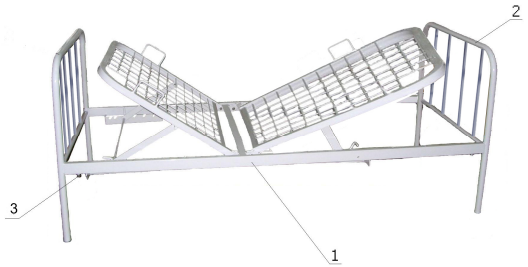


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
## модель КБ.13

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Имеет регулируемую головную и ножную секции. Регулировка углов наклона секций механическая. Угол наклона подголовника регулируется от 0º до 60º. Угол наклона ножной секции регулируется от 0° до 30° Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Масса изделия – не более 70 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | КБ.13 СГКН.750102 | 1640x902x1015 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; неподвижные опоры |
| 2 | | КБ.13 СГКН.750103 | 1640x902x1008 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 3 | | КБ.13 СГКН.750104 | 1640x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| 4 | | КБ.13 СГКН.750105 | 1640x702x1008 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 5 | | КБ.13 СГКН.750106 | 1640x702x1015 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; неподвижные опоры |
| 6 | | КБ.13 СГКН.750107 | 1640x702x1008 | Боковые спинки изделия имеют вставки из ABS-пластика; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки секций, необходимо вручную приподнять секцию и переставить фиксатор в нужное положение. Колесные опоры, оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**

**Кровать больничная модель КБ.14 СГКН.750018**



**Кровать больничная модель КБ.14 СГКН.750036**



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

# КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
# модель КБ.14

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием и выполнено в мобильном варианте, т.е. оснащено четырьмя подвижными опорами Ø100 мм с тормозом. Имеет боковые ограждения, защищенные от случайного опускания. Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы. Максимальная нагрузка на изделие не более 70 кг.

Масса изделия – не более 50 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в собранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие – 1шт.

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.14 СГКН.750018** | 1225x615x1285 | Верхнее и нижнее положения боковых ограждений - фиксированное |
| 2 | | **КБ.14 СГКН.750036** | 1500x820x1500 | Боковые ограждения фиксируются в верхнем, нижнем и промежуточном положении; ложе изделия регулируется по высоте в интервале от 650 до 925 мм. и может принимать положение тренделенбург и антитренделенбург |

## 4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой. Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

При перемещении бокового ограждения вниз, необходимо ограждение приподнять вверх до упора и опустить вниз. В случае наличия в кровати промежуточного положения, при перемещении бокового ограждения вниз необходимо ограждение приподнять вверх до упора, оттянуть кнопку фиксатора ограждения и, если ограждение опускается до промежуточного положения, отпустить кнопку фиксатора после начала перемещения ограждения. Ограждение зафиксируется в среднем положении автоматически. При перемещении в крайнее нижнее положение, кнопку фиксации удерживать в оттянутом положении до прохождения промежуточного положения. Для установки ограждения в верхнее положение, необходимо поднять его до упора вверх, оттянуть фиксатор и опустить ограждение на фиксатор. При наличии промежуточного положения, для перемещения в верхнее положение необходимо кнопку фиксатора удерживать в оттянутом положении до прохождения среднего положения.

Для создания положения ложа “тренделебург” или “антитренделенбург”, необходимо поднять нижнюю часть ложа за рукоятку, расположенную на ложе, на требуемую высоту. При этом скоба на ложе автоматически зафиксируется в пазах двух реек на спинке кровати. Для опускания ложа, необходимо скобу ложа вывести из зацепления пазов реек и придерживая скобу рукой опускать ложе. При необходимости, можно изменить высоту всего ложа.

Фиксация тормоза колеса происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 8. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 9. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ


Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____


## 10. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**


**Кровать больничная модель КБ.15 СГКН.750031**

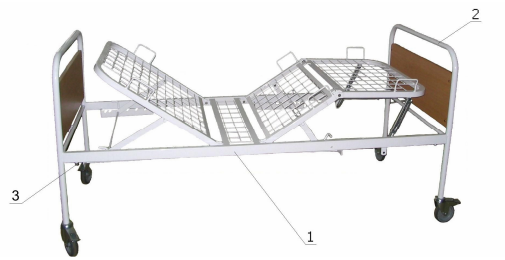



**Кровать больничная модель КБ.15 СГКН.750054**

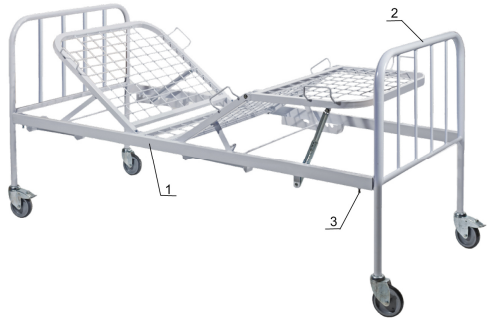


**Кровать больничная модель КБ.15 СГКН.750071**

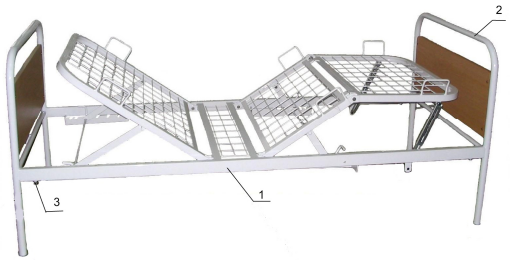


**Кровать больничная модель КБ.15 СГКН.750072**

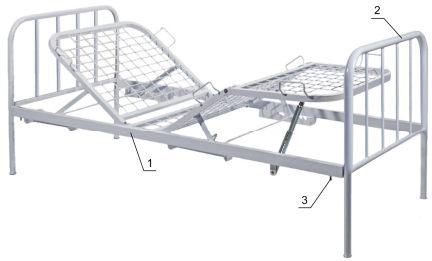


Ложе – поз.1
Боковая спинка – поз.2
Болт – поз.3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# П А С П О Р Т
# ТУ BY 600182902.006-2007

ISO 9001

## КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ
## модель КБ.15

**ЗАО «СТРУМ»**

222304 Республика Беларусь, Минская область,
г. Молодечно, ул. Металлистов, 8.
Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676
E-mail: strum@tut.by www.strum.by

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кровать больничная (в дальнейшем – изделие) предназначена для размещения на ней больных в медицинских учреждениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Изделие изготовлено из металлических деталей с полимерным покрытием. Ложе четырёхсекционное (три секции регулируемые). Регулировка углов наклона секций механическая. Угол наклона спинной секции регулируется от 0° до +60°. Угол наклона секции бедра от 0° до +30°. Угол наклона секции голени от 0° до -20°. Максимальная нагрузка на изделие не более 150кг.

Масса изделия – не более 80 кг.

## 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие поставляется в разобранном виде. В стандартный комплект поставки входит упакованное изделие (ложе – 1шт., боковая спинка – 2 шт.)

По желанию заказчика, изделие может комплектоваться дополнительными принадлежностями (ограждение кроватное боковое, стойка телескопическая инфузионная и т.д.)

| № | Поставляемое изделие | Обозначение модели | Габаритные размеры, мм | Особенности конструкции |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **КБ.15 СГКН.750031** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 2 | | **КБ.15 СГКН.750054** | 2040x902x1008 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; подвижные опоры Ø125 мм, две из них с тормозом |
| 3 | | **КБ.15 СГКН.750071** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия имеют деревянные (из ламинированного ДСП) вставки; неподвижные опоры |
| 4 | | **КБ.15 СГКН.750072** | 2040x902x1015 | Боковые спинки изделия изготовлены из стальной трубы; неподвижные опоры |

## 4. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Боковые спинки изделия поз. 2 кронштейнами вставляются в отверстия трубы ложа поз. 1 и крепятся болтами поз. 3.

## 5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию изделия проводить с применением дезинфицирующе-моющих средств, разрешенных к применению Министерством Здравоохранения Республики Беларусь, методом протирания салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором и тщательной отжатой . Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

## 6. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И ХРАНЕНИИ

Для механической регулировки головной секции необходимо вручную приподнять подголовник и переставить фиксатор в нужное положение. Для установки секции бедра и голени в исходное положение, секцию голени поднять до упора вверх и опустить. Колесные опоры (при их наличии), оснащенные тормозом, расположены по диагонали. Фиксация тормоза происходит путем нажатия ногой на выступающую педаль.

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от +10°С до +35°С, относительной влажности не более 80% при температуре окружающего воздуха +25°С в помещениях согласно вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования изделия вида климатического исполнения УХЛ 4.2 должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться на складе поставщика (потребителя) по условиям хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня выпуска изделия.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня получения изделия потребителем, если иное не предусмотрено договором.

Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня ввода изделия в эксплуатацию

## 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При потере своих потребительских качеств изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства РБ как твердые бытовые отходы.

## 9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением данного паспорта по адресу:

222304, Республика Беларусь, г. Молодечно, ул. Металлистов, 8

Тел./факс: +375 176 581616, +375 176 541676

E-mail: strum@tut.by **www.strum.by**

## 10. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Изделие соответствует техническим условиям ТУ BY 600182902.006-2007 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

## 11. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- **несоблюдение потребителем предписаний паспорта по назначению, эксплуатации, транспортированию и хранению изделия;**
- **наличие на изделии признаков самостоятельного ремонта или изменение конструкции изделия в гарантийный срок эксплуатации;**
- **повреждения, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия;**
- **внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки потребителем;**
- **внешние и внутренние повреждения, полученные в результате воздействия огня, влаги, активных химических веществ, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки;**
- **повреждения, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования, такие как стеклянные, пластмассовые детали.**