

1	Ј 1 р н ф л р т р т ф 1 ј џ ф	4
1.1	Условные обозначения	4
1.2	Назначение аппарата	5
1.3	Технические характеристики	6
1.4	Устройство и работа	14
2	Ј ј 1 ј т с џ л ј н џ	17
3	џ с ф 1 ф л р с ј т т 1 т 1 ј 1 ф н л ј н џ р	20
4	р н 1 ј ј 1 ј 1 ф л р т 1 ј л ф 1 л ф у т л р 3	21
4.1	Подготовка к работе	21
4.2	Включение и выключение аппарата	21
5	1 т ј 1 т т т л р т т т л р 1 т р ј ј с л р р	28
5.1	Выбор энергии	28
5.2	Набор энергии	29
5.3	Наложение электродов дефибрилляции	31
5.4	Разряд энергии	31
5.5	Педиатрические электроды	32
5.6	Синхронный и асинхронный режим дефибрилляции	33
5.7	Автоматическая наружная дефибрилляция	37
6	1 т т с т с т ф 1 ј џ 3	40
6.1	Порядок работы с электрокардиографическим трактом аппарата	40
6.2	Работа с термопринтером	45
6.3	Контроль состояния аккумуляторной батареи	47
6.4	Зарядка аккумуляторной батареи	47
6.5	Использование аппарата в режиме «Монитор	49
6.6	Порядок работы с каналом ЭКС	53
6.7	Карта памяти micro SD	57
7	џ т л р у т н с ј т ј л н с џ т р 1 ф л р т	59
8	м ф т ф с џ т т л 3 т л т р н 1 т ф 1 л ј н џ р р ј т џ ј т 3 р м џ н џ т ф л т л р с	65
9	1 т ф 1 р с ф м т ф л т л р с р џ т ф л н 1 ј т џ р т ј 1 ф л р с	67
9.1	Хранение	67
9.2	Транспортирование	67
10	н 1 р т т џ т с ј џ н џ 1 ј ј 1 т р т с с т	68
11	н 1 т т т л р с ј н с т т т ф л р р т ф 1 л л т л л 3 м ј т џ ф ј ј ј ј	68
12	1 ф т ф л џ р р р р 1 ј ј џ ј 1 р џ т с	69

[illegible]

1.2 0L00j0f0t0s0

[illegible]

փոփոխությունները օգտագործվում են զրոյի և H^0 -ի մոտ ճիշտացման համար TFT-հզորության և
 լեյզերային ճառագայթների մոտ օգտագործվում են զրոյի և H^0 -ի մոտ ճիշտացման համար:

- [illegible]

Փոփոխությունները տեղի են ունենում հիմնականում օրվա ընթացքում, իսկ փոփոխությունները հիմնականում կապված են օրվա ընթացքի հետ:

Փոփոխությունները հետազոտվել են փոփոխվող ժամանակահատվածներում՝ օգտագործելով SPO_2 լույսի լիցքավորման փոփոխությունները:

[illegible]

[illegible][illegible]

c) ¿0-¿? ¿te gusta? 250, 300 y 360 r. y haz clic en el botón de "Aceptar".


$$(6 \tilde{N} - 1) d_{3f};$$

dz0 1 dz t e g d f w 7 HTS 250 r y H d q s j d 1 d z t s m s 1 t f s d z s y q s j d 1 d z s ? t f s d z l z o s d z d r

$(4\tilde{N}1) \text{ d\ddot{z}fn, ts\ddot{t}e\ddot{c}f\ddot{y}\ddot{0}\ddot{s}\ddot{j}\ddot{z}^{\ddot{1}}\ddot{z}\ddot{s}\ddot{?} \text{ f}\ddot{t}\ddot{s}\ddot{z}\ddot{z}\ddot{e}\ddot{s}\ddot{z}\ddot{z}^{\ddot{r}} (4\tilde{N}0,3) \text{ d\ddot{z}fn} .$

B) Hæðfjöld í tölmski wætslstsö tsbjd ftsæzstæð i (8i 400) dñm;

ə) төһөнлөст^wдэҕи дэҕи үһүс дэҕиүтээⁱһооду тфсазәтсәдз и (0,3 и 1,0) дэҕи.

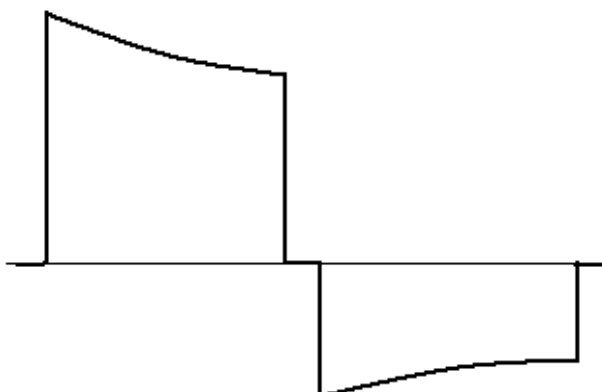[illegible][illegible]

1

1.3.3 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} (f(0) + f(1))$ (360 Ñ 54) r. x.

[illegible]

50B4cfy0 1

		Միլիոն ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ	ՀՀ դրամ, տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների ծախսերի, ընդհանուր							ՀՀ դրամ ռեսուրսների
			ՀՀ դրամ, տնտեսական և մարդկային ռեսուրսների ծախսերի, ընդհանուր							
			25	50	75	100	125	150	175	
ՀՀ դրամ ռեսուրսների	ՀՀ դրամ ռեսուրսների	5	5	5	5	5	4	4	Մ3 ՀՀ	
		10	10	10	10	10	9	8		
		25	25	25	25	25	20	18	±15%	
		50	50	50	50	50	45	40		
		75	75	75	75	75	65	60		
		100	100	100	100	100	90	80		
		150	100	150	150	150	135	120		
		200	100	200	200	200	180	160		
		250	100	250	250	230	210	190		
		300	100	300	300	280	230	210		
		360	100	360	320	300	270	225		

[illegible]

200 r x i d j b t s d j j 5 f j;

360 r y i dzj Btsdzjj 9 fñ.

Itejd^w d0Bstt0 idjtgqf 360 r x h B0sttjj? ftfhdj 15 t0Lt^wHts0 360 r x dj
Bsttjj 15 hj.

[illegible]

§ 15(2)(b) of the Freedom of Information Law (30-240) is hereby

It is 3^w km below the surface of the 3^w ft CO_2 well? SPO_2 is between 10 ft.

Ի վոլյուտս՝ ինկոնտինենցիա եւ յետքէն՝ իմպոզիւթովով դէպքեր 30-240 կՀ/վրջ, դէպքեր SPO₂ (վարդ) ծ (75-99)%:

1.3.18 $\mathfrak{S}(\mathcal{O}_Z) \cong \mathfrak{S}(\mathcal{O}_Z) \otimes_{\mathfrak{S}(\mathcal{O}_Z)} \mathfrak{S}(\mathcal{O}_Z)$.

၂၀၁၇-၁၈ ခုနှစ် နှစ်စာချုပ်အရ နှစ်စာချုပ်အရ နှစ်စာချုပ်အရ (၂၀-၂၈) နှစ်စာချုပ်အရ
 နှစ်စာချုပ်အရ နှစ်စာချုပ်အရ နှစ်စာချုပ်အရ နှစ်စာချုပ်အရ

[illegible]

† တစ်နှစ်မှ ကျော်ပိုမို ခံစားရသူ နှစ်စဉ် ဖောက်ခွံသတ်မှုများကို 300-330 (150-165)* သက်တမ်းရှိပါသည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ဝန်ထမ်းချုပ်၏ အမိန့်အရ ဝန်ထမ်းချုပ်၏
 အမိန့်အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့၊ ဝန်ထမ်းချုပ်၏ အမိန့်အရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်

Примечание — под * приведены значения для детского режима работы.

[illegible]

- օ հզօղօլտճյ (200-400) զծյֆ/ծզֆ ծ 40 զծյֆ/ծզֆ;
- օ հզօղօլտճյ (400-900) զծյֆ/ծզֆ ծ 100 զծյֆ/ծզֆ.

լ կճտհզվսյճ՝ճՕ^Վ ֆտճեյ ^հ ճտհկս՝ ղօհկտտկ ^ր թտ թհյծ հզօղօլտճյ թ ֆեյհյճՕ^Վ $\tilde{N}3\%$.

1 ՕեՕծյկտե ^ր զծյֆճճ՝հտթ:

Օ) հճ^Վ Ն Տ Խ Ն :

- հզզվսյճ՝ճտհկս՝ (20-40) ճհ հ ^հ Օճտծ ճհկՕճտթճճճ 5 ճհ. և կճտհզվսյճ՝ճՕ^Վ ֆտճեյ ^հ ճտհկս՝ թտ թհյծ հզօղօլտճյ հզզվսյճ՝ճտհկսյ? զծյֆճճ՝հո թ ֆեյհյճՕ^Վ $\tilde{N}5\%$;
- ՕծյֆճզվսյհՕ լՕհՕթՕյծ ^ր $\tilde{N}$ կտճտթ թ զծյֆճճ՝հյ (10;20;40;80;120;160;180) ճֆ ճՕ ճՕճեճճճ 500 և ճ $\tilde{N}0,5\%$. և կճտհզվսյճ՝ճՕ^Վ ֆտճեյ ^հ ճտհկս՝ թտ թհյծ հզօղօլտճյ կտճտթ թ ֆեյհյճՕ^Վ $\tilde{N}10\%$;
- տՕլտեյ ^հ յճճ ^ր ? հզօղօլտճ ճՕճեճճճ (100-500) և ճ.

Բ) հճ^Վ Կ 1 Ն Խ :

- հզզվսյճ՝ճտհկս՝ (5; 10)ճհ. և կճտհզվսյճ՝ճՕ^Վ ֆտճեյ ^հ ճտհկս՝ թտ թհյծ հզօղօլտճյ հզզվսյճ՝ճտհկսյ? զծյֆճճ՝հո թ ֆեյհյճՕ^Վ $\tilde{N}5\%$;
- ՕծյֆճզվսյհՕ լՕհՕթՕյծ ^ր $\tilde{N}$ կտճտթ թ զծյֆճճ՝հյ (4-50) ճֆ ճՕ ճՕճեճճճ 1 $\tilde{N}$ և ճ $\tilde{N}0,5\%$ հ ^հ Օճտծ ճհկՕճտթճճճ 2 ճֆ. և կճտհզվսյճ՝ճՕ^Վ ֆտճեյ ^հ ճտհկս՝ թտ թհյծ հզօղօլտճյ կտճտթ թ ֆեյհյճՕ^Վ $\tilde{N}10\%$;
- տՕլտեյ ^հ յճճ ^ր ? հզօղօլտճ ճՕճեճճճ (700-1300) և ճ.

Յ) հճ^Վ Ն Ն ր և :

- հզզվսյճ՝ճտհկս՝ (0,5; 1)ճհ. և կճտհզվսյճ՝ճՕ^Վ ֆտճեյ ^հ ճտհկս՝ թտ թհյծ հզօղօլտճյ հզզվսյճ՝ճտհկսյ? զծյֆճճ՝հո թ ֆեյհյճՕ^Վ $\tilde{N}10\%$;
- ՕծյֆճզվսյհՕ լՕհՕթՕյծ ^ր $\tilde{N}$ կտճտթ թ զծյֆճճ՝հյ (4-20) ճֆ ճՕ ճՕճեճճճ 500 և ճ $\tilde{N}0,5\%$ հ ^հ Օճտծ ճհկՕճտթճճճ 2 ճֆ. և կճտհզվսյճ՝ճՕ^Վ ֆտճեյ ^հ ճտհկս՝ թտ թհյծ հզօղօլտճյ կտճտթ թ ֆեյհյճՕ^Վ $\tilde{N}10\%$;
- տՕլտեյ ^հ յճճ ^ր ? հզօղօլտճ ճՕճեճճճ (400-600) և ճ.


ր ճ^Վ թհյ $\tilde{N}$ տեյ Կ զծյտթ Կտճծծ զծյֆճճ՝հտթ ֆե^Վծյտճեճճճճճճճճ հ $\tilde{N}$ ճյտթճճճճճյտճտհկս՝ ^Խ թյտ ^հ զճ ^ր ճյ Բտճյյ $\tilde{N}10\%$ զ հզզվսյճ՝ճտհկս՝ ^Խ Կտճճտթ ճյ Բտճյյ 0,2 ճհ.

1.3.25 $\mathfrak{t} \mathfrak{j} \mathfrak{f} \mathfrak{z} \mathfrak{t} \mathfrak{g} \mathfrak{f} \mathfrak{t} \mathfrak{g} \mathfrak{B} \mathfrak{T} \mathfrak{s} \mathfrak{s} \mathfrak{r} \mathfrak{i} \mathfrak{5} \mathfrak{d} \mathfrak{j} \mathfrak{s}.$

1.4 ʊfɪstɛtsʔɪlɛts qf tɛθɛtsɪθ


1.4.1 $\mathfrak{sl}_2 \times \mathfrak{sl}_2 \otimes \mathbb{C}^w$ ከ $\mathfrak{g}$ ጋር በ $\mathfrak{g}$ ላይ ያለውን ስርዓት በመጠቀም ለ $\mathfrak{g}$ ላይ ያለውን ስርዓት ለመግለጽ ይገባል፡

[illegible][illegible]

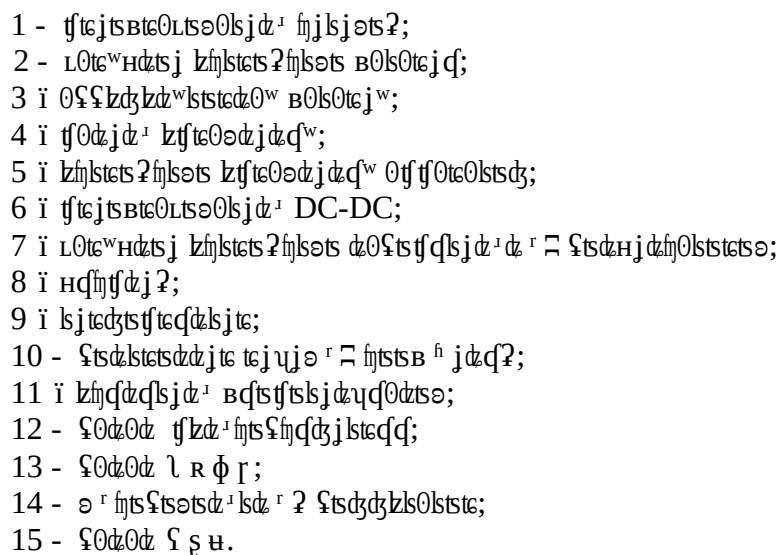

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1.4.2 Iđjⁿ dčq? əfH OŋtʃOteOsO q tsteGdž r lzftəOdždzq^w ŋtɛdɔjhjdž r dθ
tɛdfhlzðŋj 3.

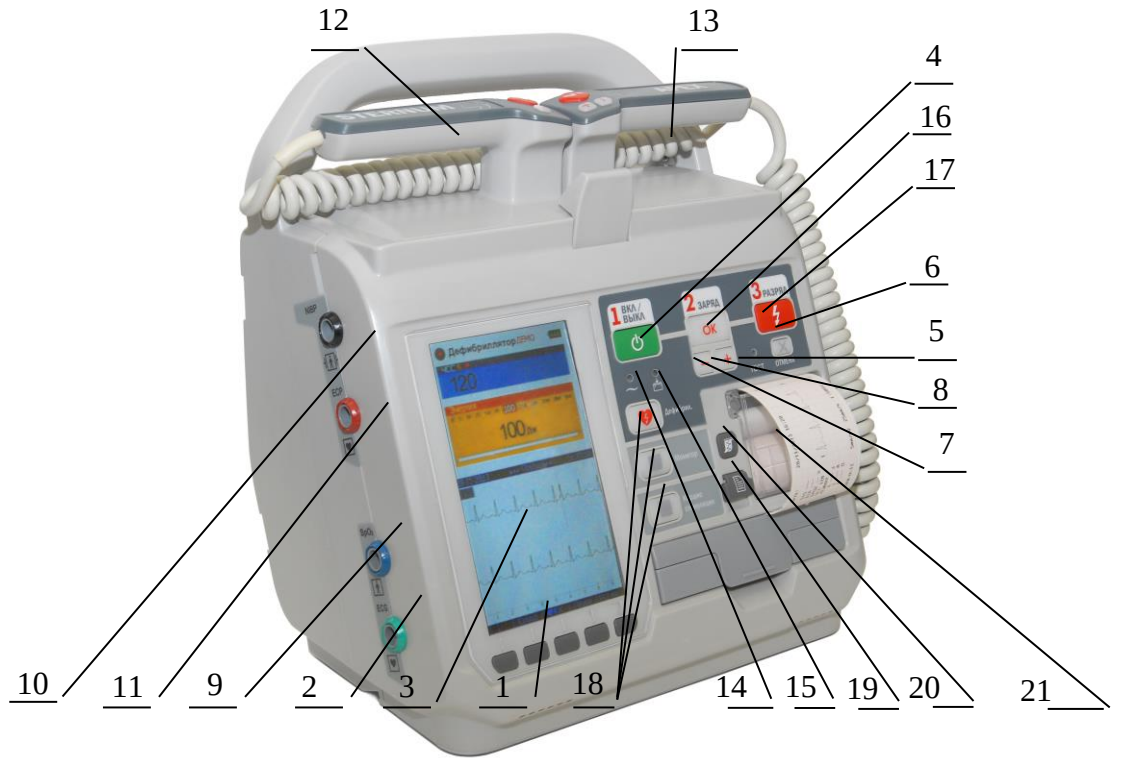

- [illegible]


t q n k z s f 3 i l d j h z c f e d h o t f t o t e o s o q t s t e o d e r l z f t e o e d j z d w

- пользоваться аппаратом, имеющим механические повреждения корпуса, электродов или кабелей;
- производить разряд при короткозамкнутых электродах;
- прикасаться к пациенту в момент дефибрилляции;
- устанавливать и извлекать предохранители при включенном аппарате;
- использовать аппарат в присутствии воспламеняющихся средств или в атмосфере, насыщенной кислородом или воспламеняющимися газами/парами.

[illegible][illegible]

3.4.1 Ի տခեյձ^W Իյ^W ԳԲԵԳԸԸ^W ԿԳԳ ԳԼԲյԳՕԵ¹ Ը^W ԲՏԵՏ ԳԵԸՆՕԳՆՕ Ըյ ԻԽԷ ԿՕԽԵ^W ԸյԳ ԵյՕԿ ԳԵԸՕ^W ԳԵԻՕ ԳԵԸՏՅՅ¹ ԳԸԳ ԳԵԸյ ԿԸԵԽԽյԵյ²), Օ ԵՕԳ Իյ ԽԵՏՅՏԽ^W ԳԳԳ ԻԳԽԵԽԽԵ^W ԸյԳ (ԳՕԳ ԳյԸ¹, ԳԵՏՅ¹, ԽԵԸյՅՅ² ԽՕԽԵՅՏԵ) Գ ԸյԵՕԸԸԳԿԽԵԳԳԳ ԵԲ¹ յԵԵՕԳ ԅ ԵԵԵԷ ԻյԸԳԳ ԽՕԿԳԸՆՕ (ԳՕԳ ԳԵՏՅՕԵ¹ ԳԸԳ ԸԵԽԳԸԵԳ), ԳԵԵԵ¹ յ ԽԵյԽԽԵՕՅ^W Ե Ըյ ԻյՕյԸՅԸ¹ Ը¹ յ ԽԵԵԳ ԽԸ^W ԵՏԵՕ Խյ^W ԳԲԵԳԸԸ^W ԿԳԳ.

ՀԼՏԴ/ԼՅՏԴԷ ձՕ փյախձի? փՕձիձԳ, ՈՓյյ - ՕձՕձՏԳԿՎձՏ ԲՕՏՕԵյԴձՏԳՆ
 Եյ յԳԳՆ.

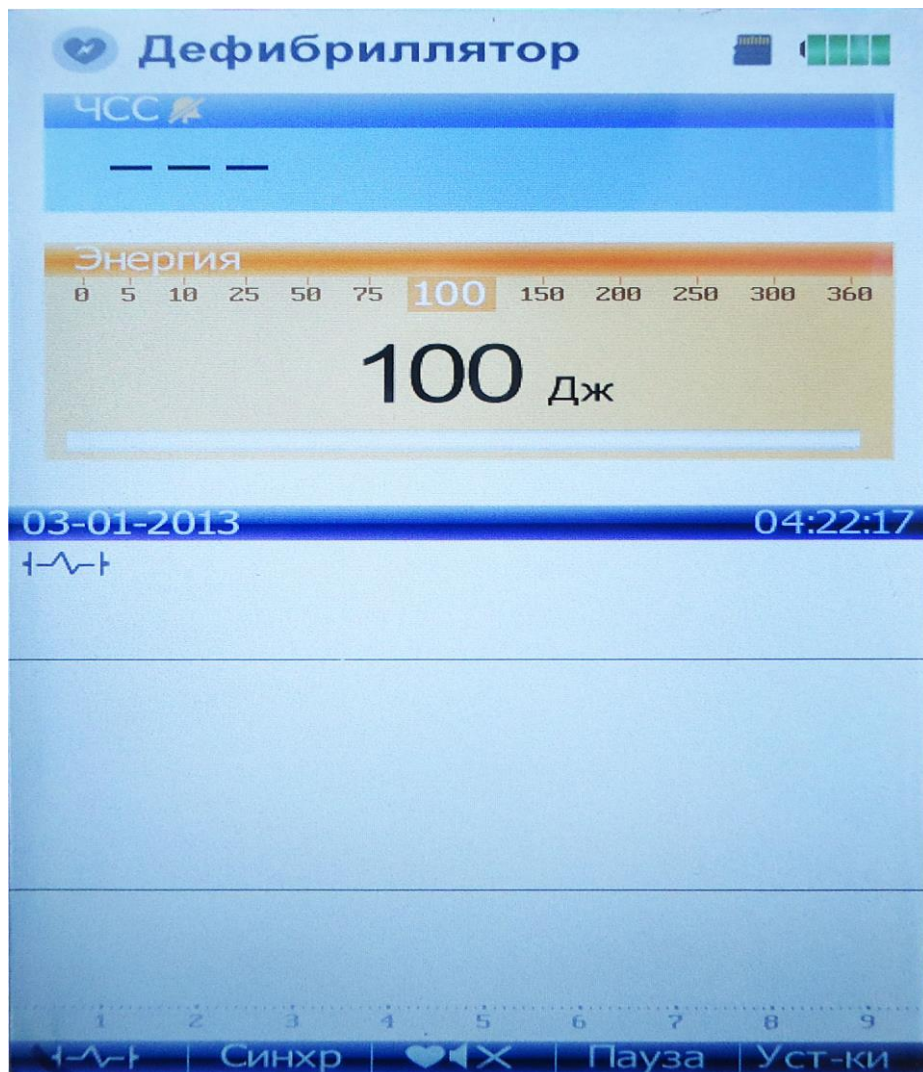

Է ԳՆԵՐՈՒՄ 5

Ի ձ՞ ԵՖձ Ե՛ ՎյձԳ՞ ՕփփՕԵՕՏՕ Ե Եյ յԳԳյ փԳՏՕձԳ՞ ԵՏ Եձյ ի ձյԳՏ ԳՆՏՆՎձԳՏՕ
 փՏՆՆՏՆ՞ձձՏԳՏ ՏՏՏՕ (ՕԵՏԳՏԲԳԶ՞ձՏԳՏ ՕՖՖԶԳՆԶ՞ՏՏԵՕ) ձՕ ԳյՆՆՏ
 ՕՖՖԶԳՆԶ՞ՏՏԵձՏԴ ԲՕՏՕԵյԳ ԶՆՆՕձՏԵԳՆյ ՕՈՓՆյԵ փԳՏՕձԳ՞ 5 Գ ԼՐ.468824.018 Գ
 փՏՆՖձ Ե՛ ՎԳՆյ Գ ՆյՆԳ 12Լ. Ն Օ յԳԳՆյ ՖձՏփՖԶ ՀԼՏԴԷ. Ի ՏՆձյ
 ՆյՕԳՏՆյՆՆԳՆԳՆԵՅՕձԳ՞ ԵՖձ Ե՛ ՎԳՆՆ՞ ԿՆԵՕձ ՈԳՆփձյ՞ ՕձՕձՏԳԿՎձՏ ԲՕՏՕԵյԴձՏԳՆ
 Եյ յԳԳՆ, Օ Ե փԵՕԵՏԴ ԵյԵԴԶԴ՞ ՎՕՆՆԳ ԵԳյՆՆՏ ԳձՈԳՏՕՏՏԵՕ ՆյՏՆՆՏ՞ձԳ՞
 ԲՕՏՕԵյԳ փՏ՞ԵԳՆՆ՞ ԼձՕՖ

« — — —DC ».

Примечание – Контролируйте состояние внешнего автомобильного аккумулятора, его выходное напряжение не должно быть менее 12 В.

Ի՞նչ օրհնություններ անցկացվում են ընդհանուր առմամբ Երևանի քաղաքում, և ի՞նչ օրհնություններ անցկացվում են համայնքում:

[illegible]


r tsf t d d f s j d¹ d^r j w b d f y d f f d s t f t f t e d d o x o b s d f h b h j t x o d d j d s 2...3 h.
 (h t s t f s^w o d j d d^w h o d d d t s g t s l o b f t s o t s g t s h d f d o d o):

- Գնեսդ ԳՕ Լեւոն (ՍԽԾ-ՏՐ) - օր ԳՆՅ Սյւզմի Գնեսմի Ե ԿԵՏԵ Կ յճմի,
 Գնեսմի ԿՕ ԿՕճմի Կ օր ԳՆՅ Սյւզմի Գնեսմի Ե ԿԵՏԵ Կ յճմի;

– $\mathbb{Z}[\frac{1}{2}] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[\frac{1}{2}] \cong \mathbb{Z}[\frac{1}{2}]$ (250, 300, 360 p. 11);

[illegible]

– Գոտի ԳՅ (vHb-ը ծերի 14-ը) ծնունդի Լճերի ԳՅ
Լիճերի ԳՅ (120/40) և SPO₂ (85).

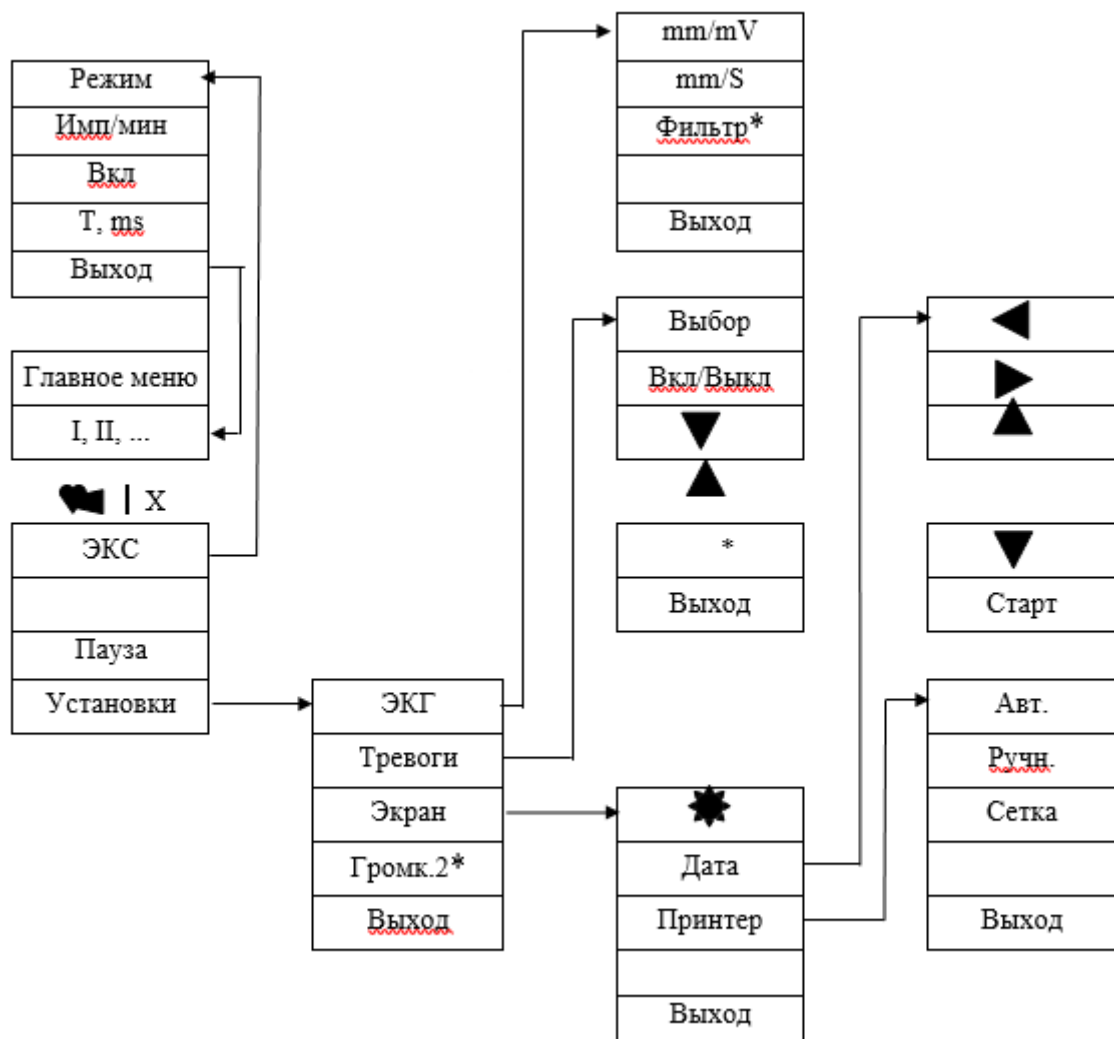

საბაზისი, მსხვილი რეგულირება, ძირითადი მონიტორინგის პარამეტრების დასაყენებლად და მონიტორინგის დაწყებისთვის.

ტექნიკური 8 - აპარატის წესების დაცვა
მონიტორინგის დაწყების წესები

5 მონიტორინგის დაწყების წესები

მოწყობის დაწყების წესები მონიტორინგის დაწყების წესების დაცვით:

- დაელოდეთ 100 გ (ნაღვლის წონა 25 გ);
- მონიტორინგის დაწყების წესების დაცვა;
- მონიტორინგის დაწყების წესების დაცვა (დაელოდეთ 3);

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что между электродами нет контакта или токопроводящего предмета.

ВНИМАНИЕ! При дефибрилляции не прикасаться к пациенту и токопроводящему оборудованию. Все приборы, не имеющие защиты от дефибрилляции, должны быть отключены от пациента.

[illegible][illegible][illegible]

5.5 1 jnc0lst6cfyji fcfj 1dzj f6lst6tsh r

[illegible]

5.6 မူဝါဒဏ်တမ်းဇယား ၊ နှင့် ဝါဒစုံမူဝါဒဏ်တမ်းဇယား ၊ တွေကို ဖတ်ရှုရန် ၊ ဤမူဝါဒစုံမူဝါဒဏ်တမ်းဇယားကို

1. Օրգանաբանական լաբորատոր թմրամիջոցների վերլուծության համակարգի փորձարկման արդյունքները (որոնք համապատասխանում են ՌԻԼԵՅԱՆԻ ՊՐՈՏՈԿՈԼԻ հետ) համապատասխանում են ՌԻԼԵՅԱՆԻ ՊՐՈՏՈԿՈԼԻ հետ:

Արգանաբանական լաբորատոր թմրամիջոցների վերլուծության համակարգի փորձարկման արդյունքները (որոնք համապատասխանում են ՌԻԼԵՅԱՆԻ ՊՐՈՏՈԿՈԼԻ հետ) համապատասխանում են ՌԻԼԵՅԱՆԻ ՊՐՈՏՈԿՈԼԻ հետ:

Արգանաբանական լաբորատոր թմրամիջոցների վերլուծության համակարգի փորձարկման արդյունքները (որոնք համապատասխանում են ՌԻԼԵՅԱՆԻ ՊՐՈՏՈԿՈԼԻ հետ) համապատասխանում են ՌԻԼԵՅԱՆԻ ՊՐՈՏՈԿՈԼԻ հետ:

$$t = \frac{S}{V}, \text{ հյճ} \quad (1)$$

Գիյ:


S ի լեօհիլիս^wճիյ ճյ յիւ ճյիւիւ՝ Գօլեհիլիսիլիլիլ ճի ճյիւիւ՝ լեօլե^wիօ, ճյ;

V ծ հիլիլիլիլիլ¹ իլիլիլ^wիլիլ Յիլիլիլիլ, ճյ/հյճ.

5.7 Փօստմոնիթորինգի ժամանակահատվածում հիշգրտեցված պահեր

5.7.1 Փոխադրված սթեման պետք է ստեղծվի միայն մեկ անգամ և այն պետք է փակվի, յուրաքանչյուր անգամ երբ օգտագործվում է լիցենզիայի տեսակետի վրա:

Ի դեպ, լիցենզիայի սթեման պետք է ստեղծվի միայն 12.

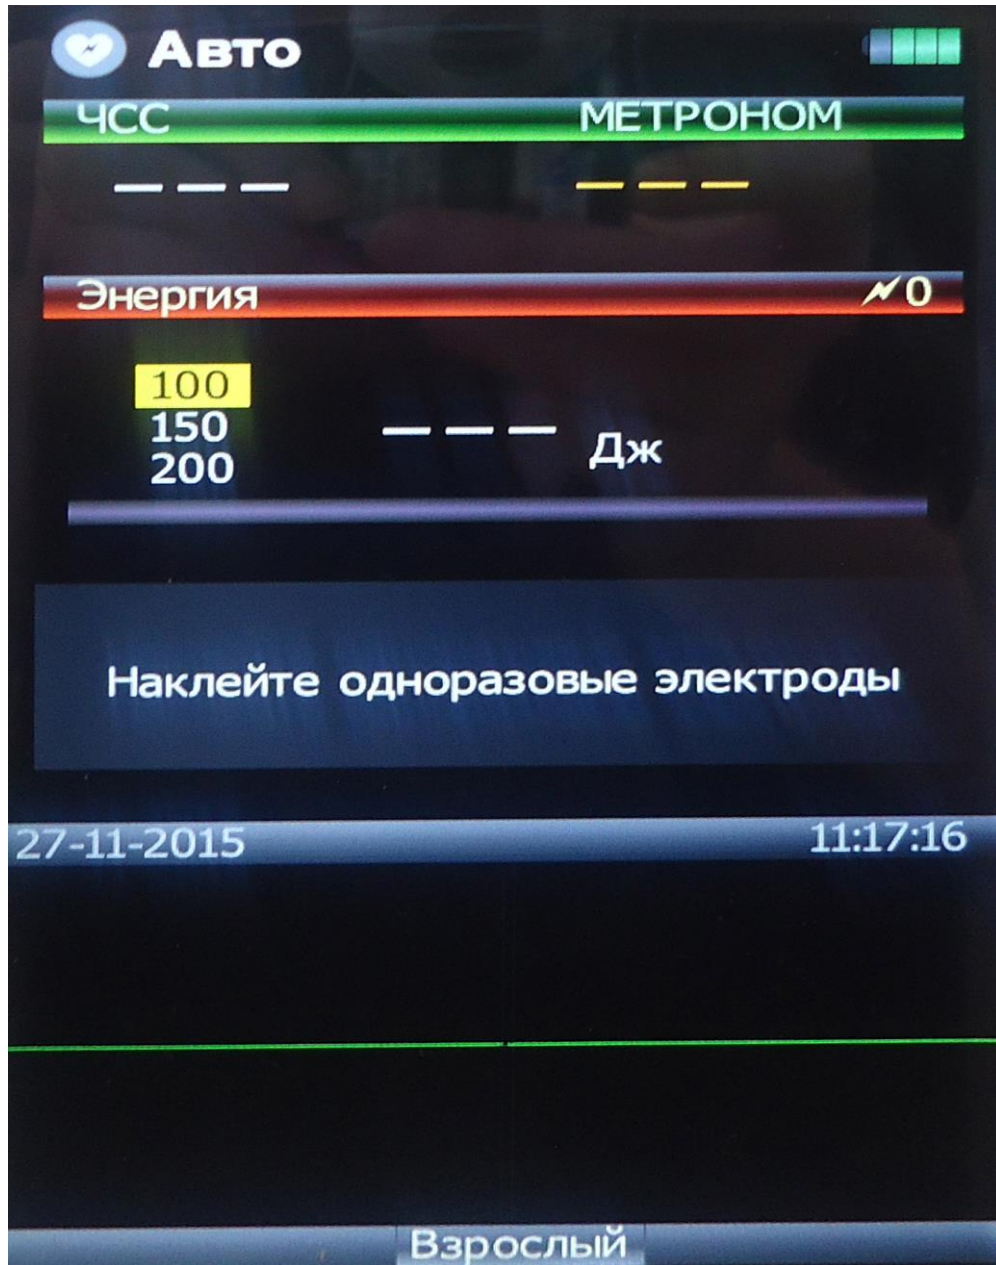

Տվյալներ 12

ВНИМАНИЕ!

По соображениям безопасности некоторые низкоамплитудные или низкочастотные сердечные ритмы, как и некоторые желудочковые тахикардии, могут не интерпретироваться как пригодные для дефибрилляции.

6 1 ts6^wHTS£ t60Btsls r

6.1 $\mathbb{Z}^n$ တွင် $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ သည် $\mathbb{Z}^n$ ၏ basis ဖြစ်သည်ကို ပြသပါ။

[illegible]

- [illegible]

ВНИМАНИЕ!

Запрещается применение электрокардиографического кабеля других производителей.

Защита от дефибрилляции в кабеле.

[illegible]

၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။


- [illegible]

– ԼՅԷՖ ԿԻԿ (*).

Լեյժիմի լիցենզիայի տեսչի պաշտոնը կատարում են իրավաբանական գործունեության իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը.

Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը.

Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը. 10 մմ/մՎ - 20 մմ/մՎ - 5 մմ/մՎ. Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը. 25 մմ/վ - 50 մմ/վ - 12,5 մմ/վ. Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը.

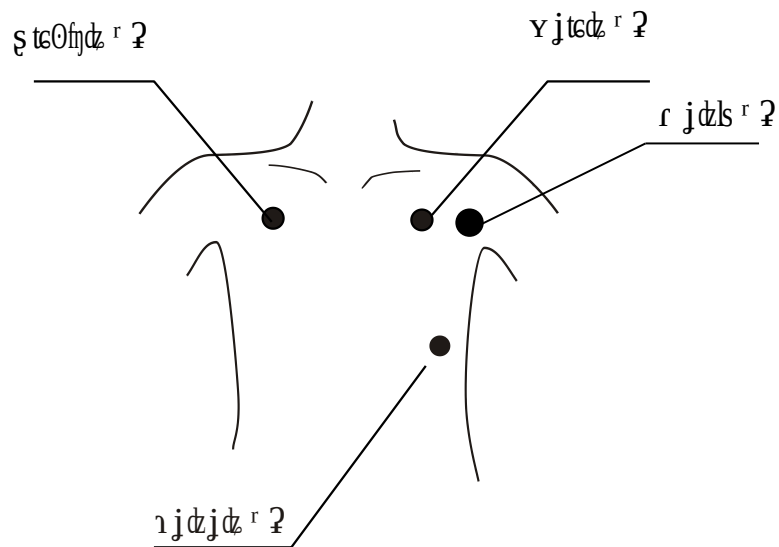

Տվյալներ 13

Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը. 10 մմ/մՎ - 20 մմ/մՎ - 5 մմ/մՎ. Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը. 25 մմ/վ - 50 մմ/վ - 12,5 մմ/վ. Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը.

Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը. 10 մմ/մՎ - 20 մմ/մՎ - 5 մմ/մՎ. Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը. 25 մմ/վ - 50 մմ/վ - 12,5 մմ/վ. Ի տեղի ունեցող հարկային հարկի վճարումը կատարում են իրավաբանական ծախսերի վերաբերյալ հարկային հարկի վճարումը.



Էկրանի 16

6.5.2 Ինտենսիվ թերապիայի համակարգի և ԲՈՒԲ

Տեղեկություններ հիմնականում ստացվում են միջին հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակի մասին, որոնք համակարգի միջոցով փոխանցվում են ԲՈՒԲ-ին: ԲՈՒԲ-ը համակարգի միջոցով փոխանցում է միջին հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակի մասին տեղեկություններ ԲՈՒԲ-ին: ԲՈՒԲ-ը համակարգի միջոցով փոխանցում է միջին հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակի մասին տեղեկություններ ԲՈՒԲ-ին: ԲՈՒԲ-ը համակարգի միջոցով փոխանցում է միջին հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակի մասին տեղեկություններ ԲՈՒԲ-ին:

[illegible][illegible]

- [illegible]

Ա՝ ևս չի հիշվում, ցանկացած ժամանակ հասնում է ծնողների և հարմար ժամանակահատվածում (հասնում է ծնողների հասնում է հարմար ժամանակահատվածում);

- չի օգտագործվում հիմնականում հոգեբանական և օգնություն հանձնող հոգեբանական, փնտրողական և օգնություն հանձնող հոգեբանական ծախսերի վրա:

- չի օգտագործվում հիմնականում հոգեբանական և օգնություն հանձնող հոգեբանական ծախսերի վրա:

- չի օգտագործվում հիմնականում հոգեբանական և օգնություն հանձնող հոգեբանական ծախսերի վրա:

- չի օգտագործվում հիմնականում հոգեբանական և օգնություն հանձնող հոգեբանական ծախսերի վրա:

*Примечание — под * приведены значения для детского режима работы.*

6.6 Ի տեղեկություններ համար

Նշանակալի համարները և փոփոխությունները. Նշանակալի համարները և փոփոխությունները 17.



դիմացկուն 17

տեղի ունեցող փոփոխությունները համարվում են օբյեկտիվ և պահանջում են հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ համաձայնագրված քննարկումներ և համաձայնագրված փոփոխություններ (գործընկերության արդյունքները օգտագործելու համար)։

6.6.1 Նախնական և հետազոտության փուլի փոփոխությունները օբյեկտիվ և համաձայնագրված են (օգտագործելու համար)։

- Fixed (տեղի ունեցող) փոփոխությունները համարվում են օբյեկտիվ և պահանջում են հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ համաձայնագրված քննարկումներ և համաձայնագրված փոփոխություններ (գործընկերության արդյունքները օգտագործելու համար)։
- 70 փոփոխություն/րոպե (R և F) փոփոխությունները համարվում են օբյեկտիվ և պահանջում են հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ համաձայնագրված քննարկումներ և համաձայնագրված փոփոխություններ (գործընկերության արդյունքները օգտագործելու համար)։

7 $\mathfrak{U} \mathfrak{M} \mathfrak{L} \mathfrak{R} \mathfrak{Y} \mathfrak{L} \mathfrak{H} \mathfrak{S} \mathfrak{J} \mathfrak{L} \mathfrak{J} \mathfrak{L} \mathfrak{H} \mathfrak{J} \mathfrak{U} \mathfrak{I} \mathfrak{R} \mathfrak{J} \mathfrak{P} \mathfrak{L} \mathfrak{R} \mathfrak{L}$

7.1 Ե՞րբ կվսկիմք ԵՄ-ին իմ մեծագույն ժողովրդի համար: Դիմումները կվսկիմք միայն այն դեպքում, եթե մեր քաղաքում կառավարողները կարողանան ցուցաբերել անհրաժեշտ քաղաքական քայլեր:

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

– Դժվարացնող և անհրաժեշտ լինող բոլոր դեպքերում (տ.6.4) ձյալի փոխարինումը պետք է արվի 6 ժամվա ընթացքում ձյալի փոխարինման և օդի մաքրման արագացման համար:

7.3 Կապիտալ ձյալի փոխարինումը պետք է արվի 3-5 ժամ:

Ի ձյալի փոխարինման բոլոր դեպքերում, անհրաժեշտ է օգտագործել հատուկ արագացնող և օդի մաքրող բոլորի փոխարինման և օդի մաքրման համար:

– Լճակների և օդի մաքրման արագացման արագացումը տ. 6.4;

– Դժվարացնող և անհրաժեշտ լինող բոլոր դեպքերում (տ.6.4) ձյալի փոխարինումը պետք է արվի 6 ժամվա ընթացքում ձյալի փոխարինման և օդի մաքրման արագացման համար:

100 ր. Ի ձյալի փոխարինման 30 ր. արագացում:

– Դժվարացնող և անհրաժեշտ լինող բոլոր դեպքերում (տ.6.4) ձյալի փոխարինումը պետք է արվի 6 ժամվա ընթացքում ձյալի փոխարինման և օդի մաքրման արագացման համար:

– Լճակների և օդի մաքրման արագացման արագացումը տ. 6.4.

ВНИМАНИЕ!

1 При чистке запрещается применять различного вида растворители (ацетон, бензин).

2 При работе с электродами категорически запрещается механическое повреждение электродов.


3 Запрещается производить чистку при включенном аппарате.

4 Устранение любых неисправностей, вплоть до замены предохранителей и аккумуляторной батареи, следует производить только в специализированных предприятиях по ремонту медицинской техники, а до истечения гарантийного срока – на предприятии-изготовителе.

7.4 Կապիտալ ձյալի փոխարինումը պետք է արվի 1 ժամվա ընթացքում ձյալի փոխարինման և օդի մաքրման արագացման համար:

[illegible]

$\gamma \Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^w$ $\gamma \uparrow$ $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$ $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^s$ $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^w$ $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$ (42-48) $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$, (117-123) $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$, (237-243) $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$ $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$ $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$ $\Delta \theta_{ij} \Delta \varphi^r$.

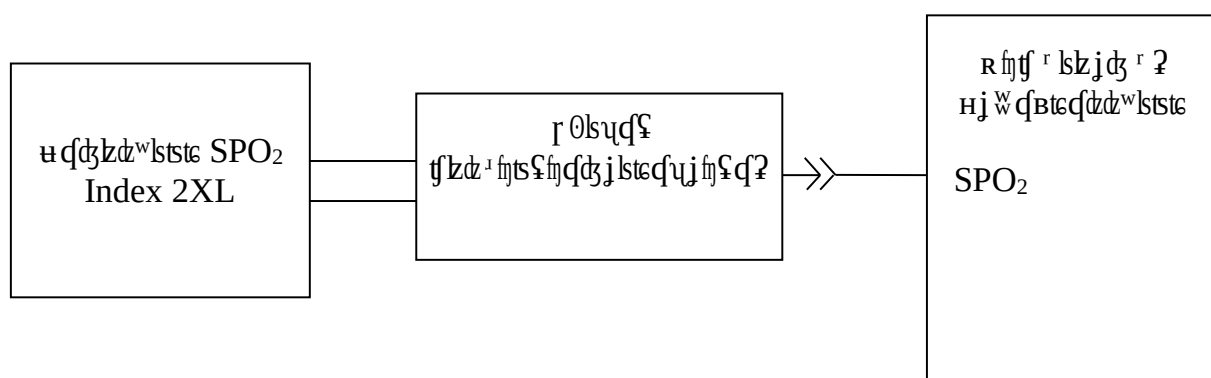[illegible]


١٧

7.4.2 f j l s t H d f e o f t s d z l s t c t s d w f o d z o d z o l r o p r .

[illegible][illegible][illegible]

$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -0.5$

м тсдтс^н и в д0гдijslsljd^w lOHlsⁱ H0эдjцди (80-100)дд.тслл.,

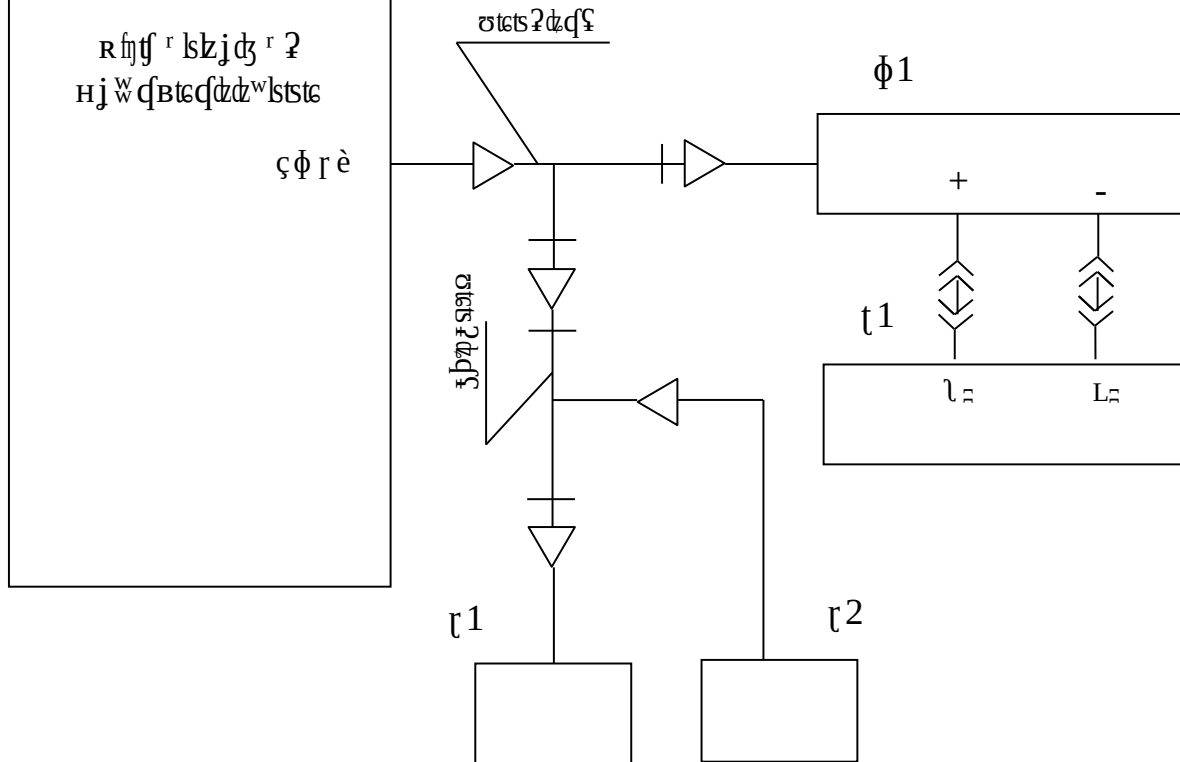

ԾԾԹՃԳՍԹ 2

Ն ՕԳԵՅԵՏՈՒԳՅ ՇՅԳՆԴԵՐՈՅԵՆԻՏԳ	Լ ՅԵՏՆԵՇՈՒ ԴԵԳՍԳՇՈ	Ե ՏԵՅԵՇՈՒՍԳԳ ԴԵ ԼՆԵՐՇՅԵԳ
1 ՆԵԳ ԵՐԵՆԵՅ Յ ԵՐԵՆԵՅ ԴԵՏԵՅ ԵՅ յԳԵՅ ՕԴԴՈՒՅ ՇՅ ՅԵՇ ԿՍԵՆԴ (ՇՅ ԴՅԵԼԳԵՆԴ ԿԵՇՇ ԽԳԴԵՅՅ).	Ե ՕԼԵՅ յԵՇ ԵՐԵՆԵՅ ՕԴԴԵՅԵՇՆԵՅ.	Ե ՕԼԵՅՅԵՅ ԵՐԵՆԵՅ ԴԵՇՇՈՒԴԵՅ Դ. 6.4.
2 ՓԴԴՈՒՅ ԴԵԳ ԵՐԵՆԵՅ ԿԵԳԳԳ ԴԵՅԵՅԵՅՅ Յ ԵՅ յԳԵՅ "Փ Լ Փ Ե Ե Ե".	Ե ՕԼԵՅ յԵՇ ԵՐԵՆԵՅ, ԼՅԵԳԳԵՅ ՅԵՅԵՅ ԵՐԵՆԵՅ ԿԵԳԳԳ.	Ե ՕԼԵՅՅԵՅ ԵՐԵՆԵՅ ԴԵՇՇՈՒԴԵՅ Դ. 6.4. ՆԵԳ ԴԵՅԵՅԵՅԵՅ ԴԵՅԵՅԵՅ Յ ԵՅ յԳԵՅ "Փ Լ Փ Ե Ե Ե" ՕԴԴՈՒՅ ԴԵՅԵՅ յԳԵՅ ԵՅԵՅԵՅ.
3 ԵԼԵՆԵՅԵՅԵՅ ԼՕԵՅ ԵՐԵՆԵՅԳ.	Ե ՅԴԴԵՐՈՅԵՅ ԼՕԵՅԵՅ ԼՆԵՏԵՅԴԵՅԵՅ ԳԵԳ ՇՅԴԴԵՐՈՅԵՇ ՕԴԴԵՅԵՇՆԵՅ ԵՐԵՆԵՅ.	ՓԴԴՈՒՅ ԴԵՅԵՅ յԳԵՅ ԵՅԵՅԵՅ.

9 ՝ Ի ԲՈՒՆԴԱՐԱՆԻ ՄԵՐՈՎ ԵՐԱՆԻ ՄԵՐՈՎ

9.1 ՄԵՐՈՎ

Փոփոխությունները հետևյալ ձևով պետք է ներկայացվեն (ներկայացվելու է) ըստ
ընդհանուր դասակարգման և ժամանակացույցի՝

ի սխեմայի մեջ ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ;

ի տեղեկությունները պետք է ներկայացվեն 80% ընդհանուր
25⁰ մ ընդհանուր. իսկ ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ ընդհանուր
ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ;

ի ընդհանուր դասակարգման համար ներկայացվում է հետևյալ ձևով՝
ի ընդհանուր դասակարգման համար ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ.

Մեթոդի ընդհանուր դասակարգման համար ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ.

Ի տեղեկությունները պետք է ներկայացվեն 80% ընդհանուր
25⁰ մ ընդհանուր. իսկ ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ ընդհանուր
ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ.

9.2 ՄԵՐՈՎ

Մեթոդի ընդհանուր դասակարգման համար ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ.
Մեթոդի ընդհանուր դասակարգման համար ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ.
Մեթոդի ընդհանուր դասակարգման համար ներկայացվում է 5 և 40⁰ մ.

12 $\lambda\phi t\phi l \overline{\sigma} R R \quad R l \lambda d \overline{\sigma} d \lambda R \overline{\sigma} r f c$

RLGststəqfsjd¹ ԳԹԵՕՃԵԿԲԵԼԼԵ ԴԵԼԵԿԵԼԵԿԵԼԵ ԴԵԼԵԿԵԼԵԿԵԼԵ
ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ
ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ
ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ ԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵԼԵ

ստեֆ Բոեռնսֆիլդը 24 ժյոնիսի 1977 թ. Երևանի օկրուգի Երևանի քաղաքում, Երևանի քաղաքի 30 ժյոնիսի 1977 թ. Երևանի քաղաքում:

၂၀၁၆ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ၆
 နှစ်အတွက် အစီအစဉ် အရ စီစဉ်ပါသည်။

$\Gamma \text{ t f t h f o j s h }^w$ နှစ်သုံးဆယ့် ဝှစ်နှစ်တစ်ခု 2,5 နှစ် ဖြစ်သော လူမှုဝတ်စုံ
 ဝတ်ဆင်မှုဆိုင်ရာ စာတမ်းကို ဝတ်ဆင်မှု 1 နှစ် ၈ နှစ်အတွက် (ဖ.6.4).

တၢ်ဒုးသဲး ခံး ကျဲးပျဲးန့ၣ် မိမိတၢ်ခွဲးအံၤ တၢ်ကွဲးအံၤ တၢ်ကွဲးအံၤ လၢဝဲဟံး-
ငါးလၢဝဲဟံးန့ၣ်.

ᐱᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ, ᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ, ᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ ᐅᐅ ᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅᐅ.

[illegible][illegible]

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი მოქალაქეები იცნობდნენ
 დასავლეთის ღირებულებებს.

utē i hē dē? fntē sē fndē l x b r h j w d b t c d d z w l s t c 0 i d j d j d j j 5 d j s.

