П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0100
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0100 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	2
3	Стенка задняя	1
3	Двери	1
4 фурнитура	Направляющие под лотки из АВС- пластика	12
5 фурнитура	Ножки	4
6 фурнитура	Петли	3
7 фурнитура	Ручка	1
8 фурнитура	Саморез	302
9 фурнитура	Заглушки - конфирмат	10
10	Паспорт	1
11 фурнитура	Лотки выдвижные 600х400х100мм	4
12 фурнитура	Корзины выдвижные 600х400х200мм	2

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0100, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика


6.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201,
20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0100

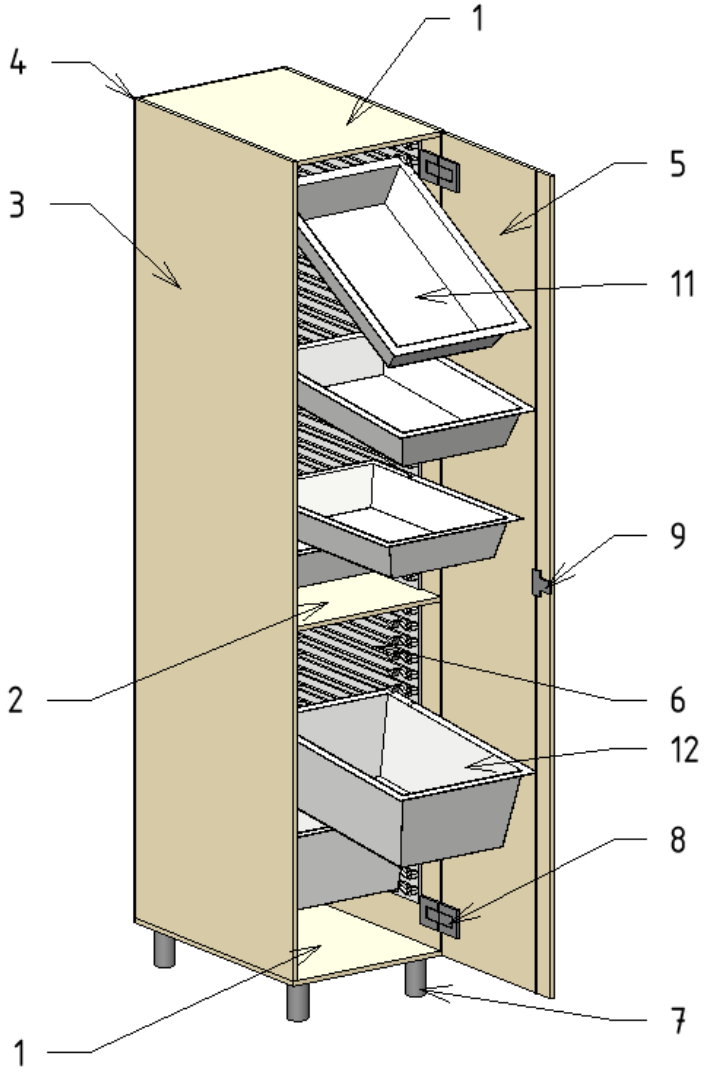

1. Крепим пилястры к боковым стенкам (3)
2. К основанию (1) крепим ножки (7)
3. Из оснований (1) и боковых стенок (3) собираем каркас шкафа
4. Крепим полку (5) к каркасу шкафа
5. Крепим заднюю стенку (3)
6. К двери (9) крепим петли (8) и устанавливаем замок с ручкой
7. Устанавливаем подготовленную дверь в каркас шкафа
8. Устанавливаем телескопические направляющие (6) в пазы пилястров(10) на необходимой высоте
9. Корзины (лотки) (11,12) устанавливаются на штыри в телескопических направляющих

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0101
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0101 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	2
3	Стенка задняя	1
3	Двери	2
4 фурнитура	Направляющие под лотки из АВС- пластика	12
5фурнитура	Ножки	4
6 фурнитура	Петли	6
7 фурнитура	Ручка	2
8 фурнитура	Саморез	302
9 фурнитура	Заглушки - конфирмат	10
10	Паспорт	1
11 фурнитура	Лотки выдвижные 600х400х100мм	4
12 фурнитура	Корзины выдвижные 600х400х200мм	2

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0101, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика


6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.


6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0101

1. К боковым стенкам (1) крепим панели направляющих из АВС-пластика(2)

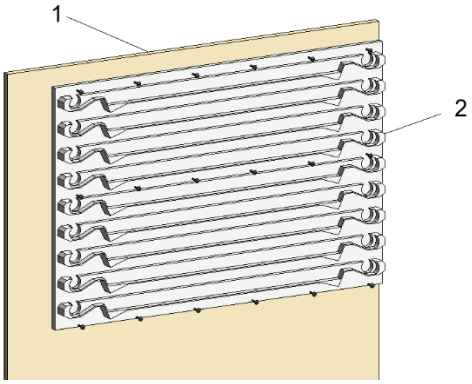


2. Крепим ножки(4) к основанию(3)

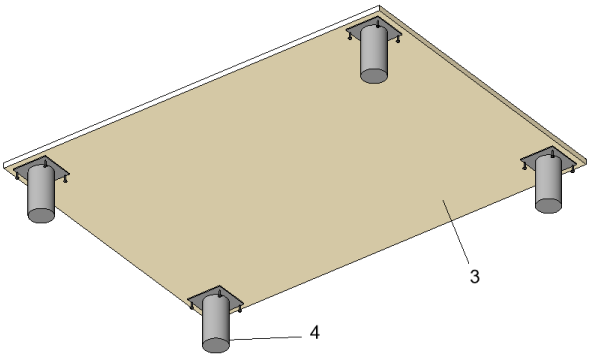


3. Собираем каркас шкафа

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

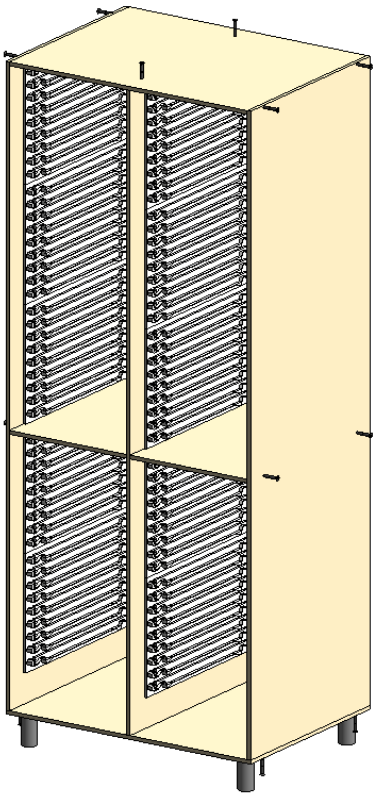


4. Крепим заднюю стенку (5)

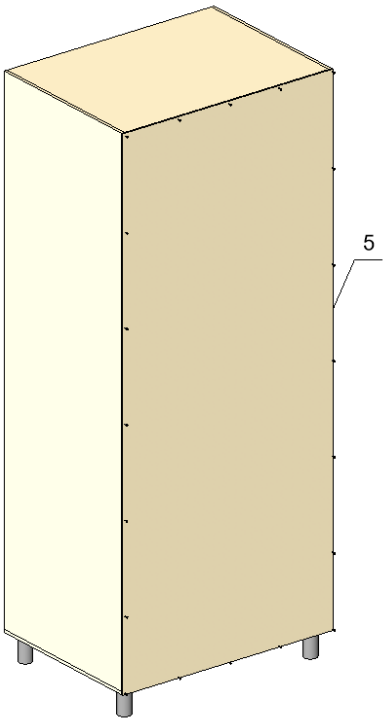


5. К двери(8) крепим петли(6) и ручку с замком(7)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

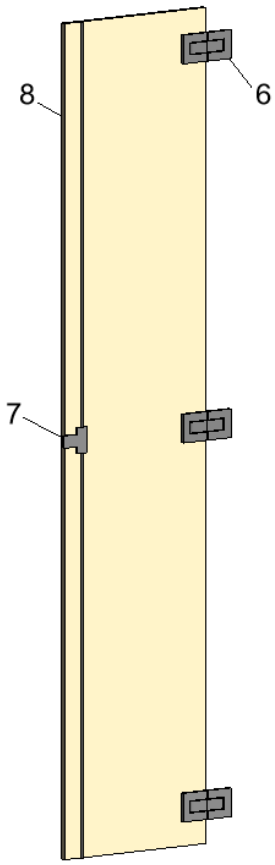

6. Крепим дверь к основному каркасу, заполняем необходимым количеством лотков

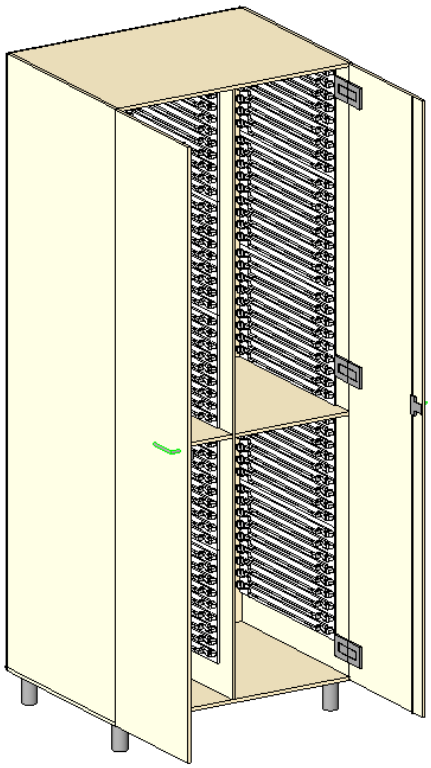

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0200
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0200 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	2
3	Стенка задняя	1
3	Двери	1
4 фурнитура	Направляющие под лотки из АВС- пластика	12
5 фурнитура	Ножки	4
6 фурнитура	Петли	3
7 фурнитура	Ручка	1
8 фурнитура	Саморез	302
9 фурнитура	Заглушки- конфирмат	10
10	Паспорт	1
11 фурнитура	Лотки выдвижные 600х400х100мм	4
12фурнитура	Корзины выдвижные 600х400х200мм	2

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0200, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика


6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201,
20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0200

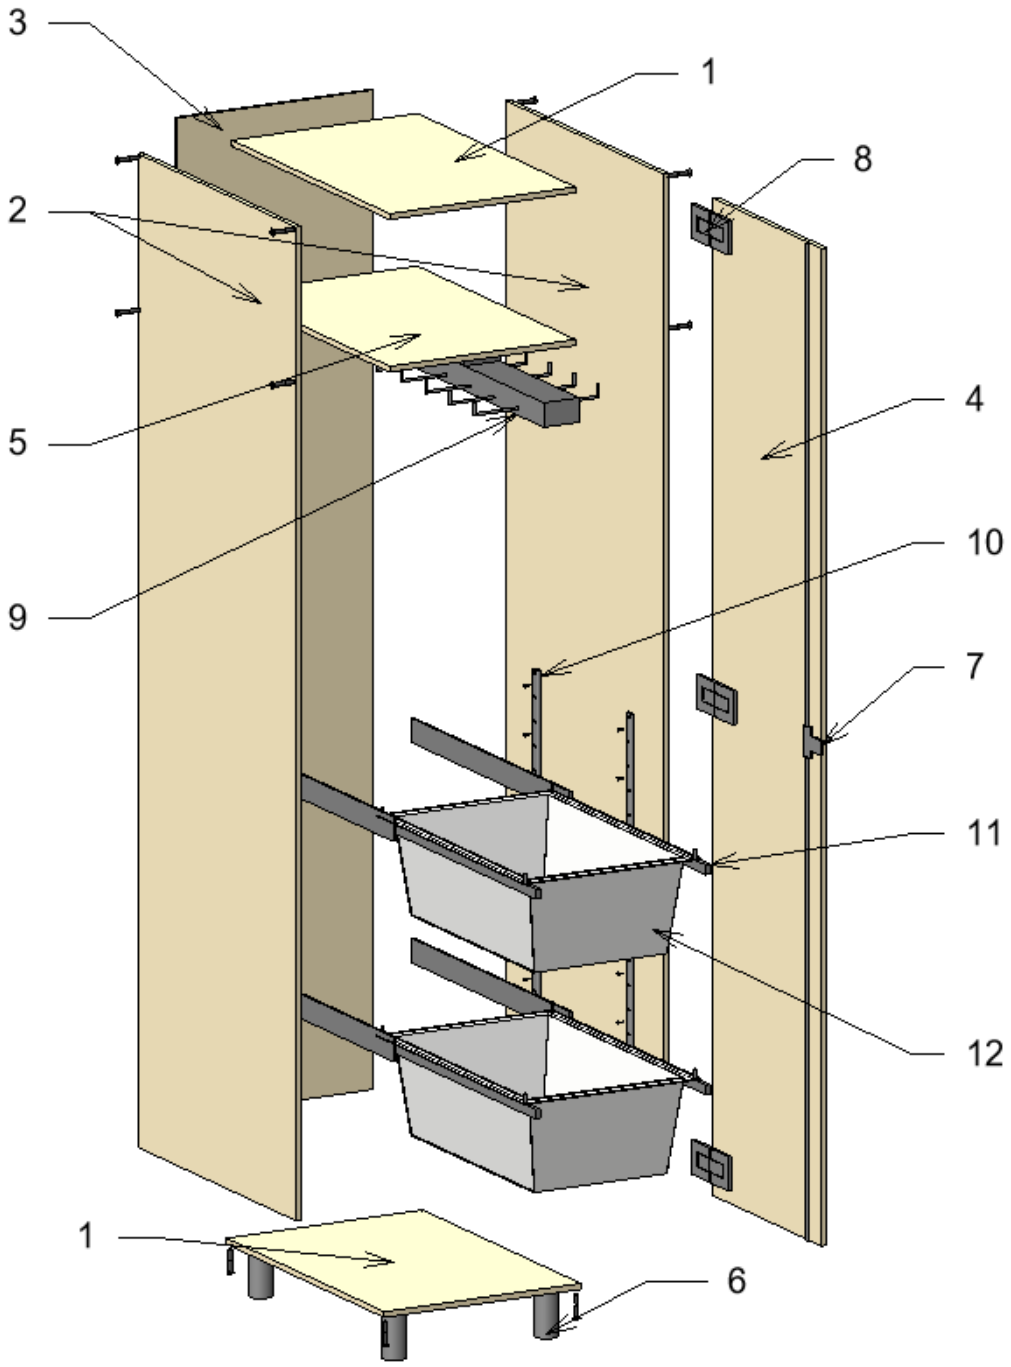

1. Крепим пилястры (10) к боковым стенкам (2)
2. К основанию (1) крепим ножки (6)
3. Из оснований (1) и боковых стенок (2) собираем каркас шкафа
4. Крепим выдвижную раму для катетеров (9) к полке (5)
5. Крепим полку (5) к каркасу шкафа
6. Крепим заднюю стенку (3)
7. К двери (4) крепим петли (8) и устанавливаем замок с ручкой (7)
8. Устанавливаем подготовленную дверь в каркас шкафа
9. Устанавливаем телескопические направляющие (11) в пазы пилястров(10) на необходимой высоте
10. Корзины (лотки) (12) устанавливаются на штыри в телескопических направляющих

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0201
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0201 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	3
3	Стенка задняя	1
4	Дверь	2
5	Полка	2
6 фурнитура	Ножка	4
7 фурнитура	Ручка с замком многостороннего запирания	2
8 фурнитура	Петли	6
9 фурнитура	Выдвижная рама для катетеров	2
10 фурнитура	Пилястр	8
11 фурнитура	Роликовая направляющая полного выдвижения	4 пары
12 фурнитура	Корзина из ABS-пластика 600х400х200мм	4
13	Паспорт	1

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0201, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК


6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0201

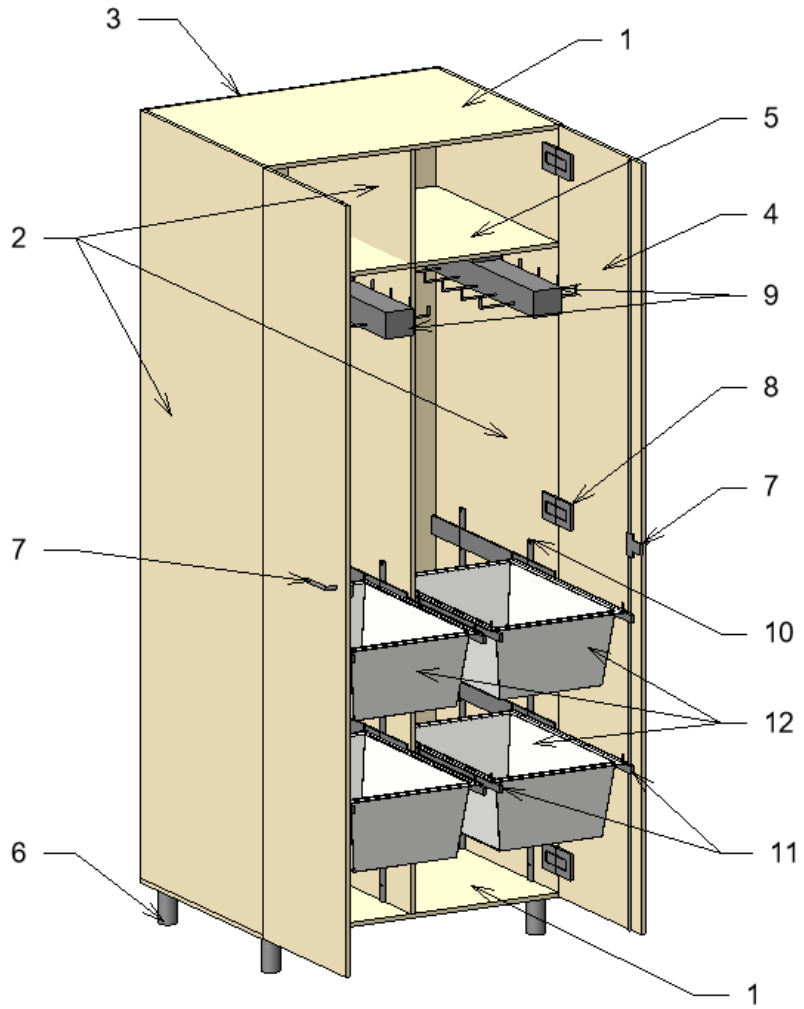

1. Крепим пилястры (10) к боковым стенкам (2);
2. 2. К основанию (1) крепим ножки (6)
3. Из оснований (1) и боковых стенок (2) собираем каркас шкафа;
4. Крепим выдвижную раму для катетеров (9) к полке (5);
5. 5. Крепим полку (5) к каркасу шкафа; 6.Крепим заднюю стенку (3)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. К двери (4) крепим петли (8) и устанавливаем замок с ручкой (7)
7. Устанавливаем подготовленную дверь в каркас шкафа
8. Устанавливаем телескопические направляющие (11) в пазы пилястров(10) на необходимой высоте
9. Корзины (лотки) (12) устанавливаются на штыри в телескопических направляющих

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0300
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0300 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия - 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	2
3	Стенка задняя	1
3	Двери	1
4 фурнитура	Направляющие под лотки из АВС- пластика	12
5 фурнитура	Ножки	4
6 фурнитура	Петли	3
7 фурнитура	Ручка	1
8 фурнитура	Саморез	302
9 фурнитура	Заглушки - конфирмат	10
10	Паспорт	1
11 фурнитура	Лотки выдвижные 600х400х100мм	4
12 фурнитура	Корзины выдвижные 600х400х200мм	2

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0300, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика


6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201,
20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0300

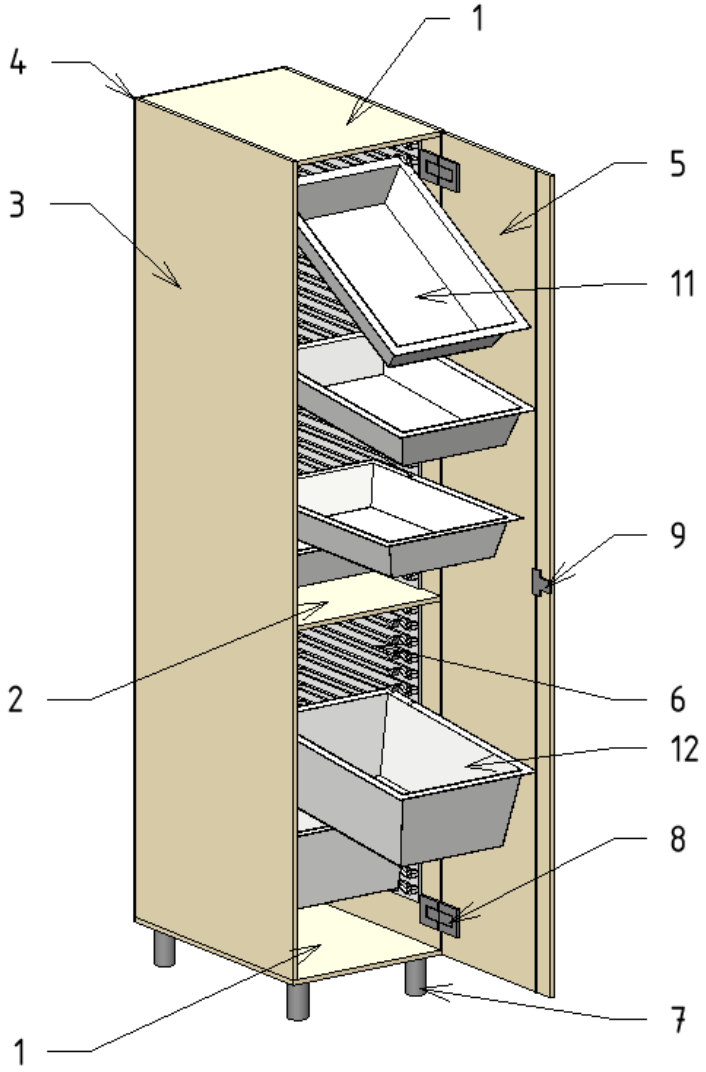

1. Крепим пилястры к боковым стенкам (3)
2. К основанию (1) крепим ножки (7)
3. Из оснований (1) и боковых стенок (3) собираем каркас шкафа
4. Крепим полку (5) к каркасу шкафа
5. Крепим заднюю стенку (3)
6. К двери (9) крепим петли (8) и устанавливаем замок с ручкой
7. Устанавливаем подготовленную дверь в каркас шкафа
8. Устанавливаем телескопические направляющие (6) в пазы пилястров(10) на необходимой высоте
9. Корзины (лотки) (11,12) устанавливаются на штыри в телескопических направляющих

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0301
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0301 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	1
3	Стенка боковая	3
4	Стенка задняя	1
5	Двери	2
6 фурнитура	Направляющие под лотки из АВС - пластика	24
7 фурнитура	Ножки	4
8 фурнитура	Петли	3
9 фурнитура	Ручка с замком многостороннего запирания	1
10	Паспорт	1
11 фурнитура	Лотки выдвижные 600х400х100мм	8
12 фурнитура	Корзины выдвижные 600х400х200мм	4

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0301, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика


6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.


6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ – 0301

1. К боковым стенкам (1) крепим панели направляющих из АВС-пластика(2)

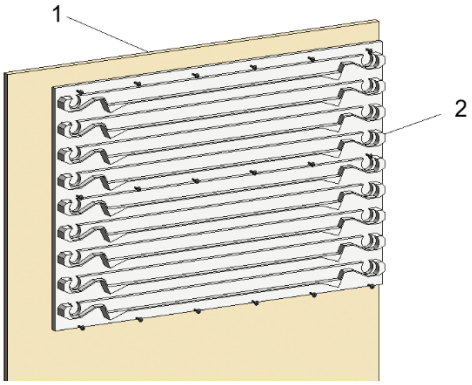


2. Крепим ножки(4) к основанию(3)

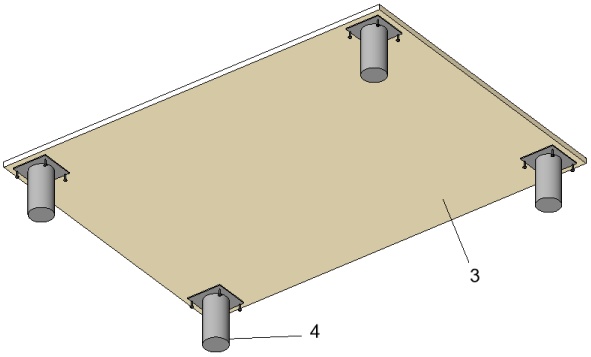


3. Собираем каркас шкафа

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

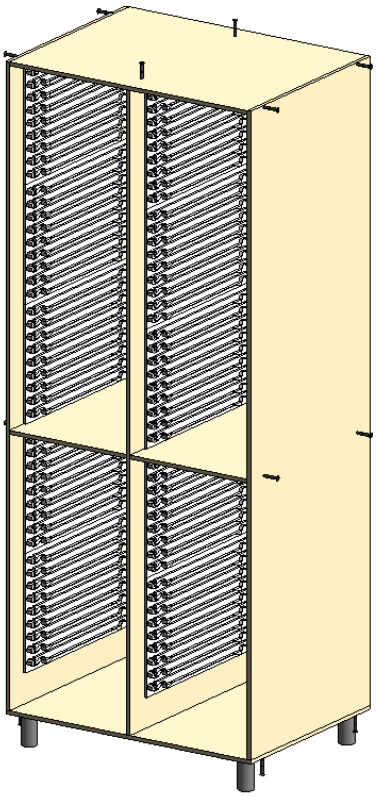


4. Крепим заднюю стенку (5)

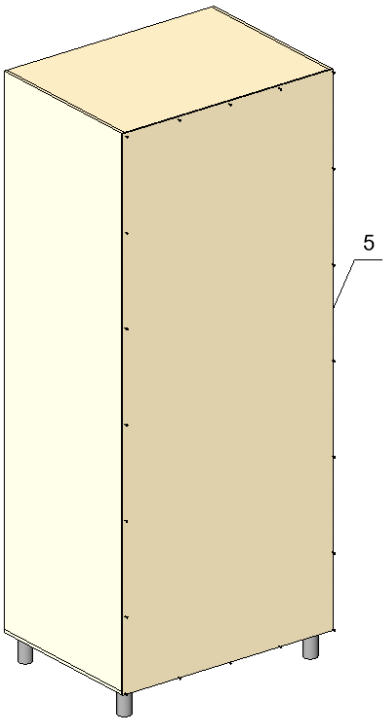


5. К частично остеклённой (либо стеклянной) двери(8) крепим петли(6) и ручку с замком(7)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

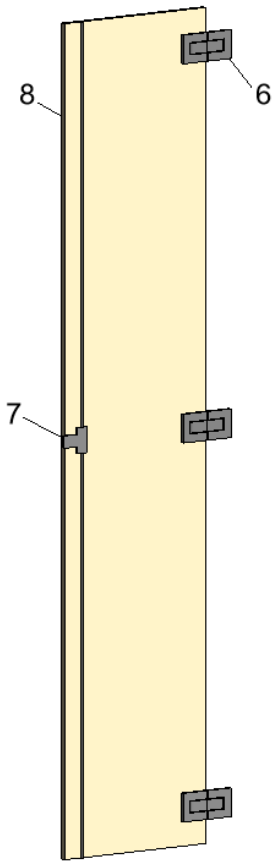

6. Крепим дверь к основному каркасу, заполняем необходимым количеством лотков

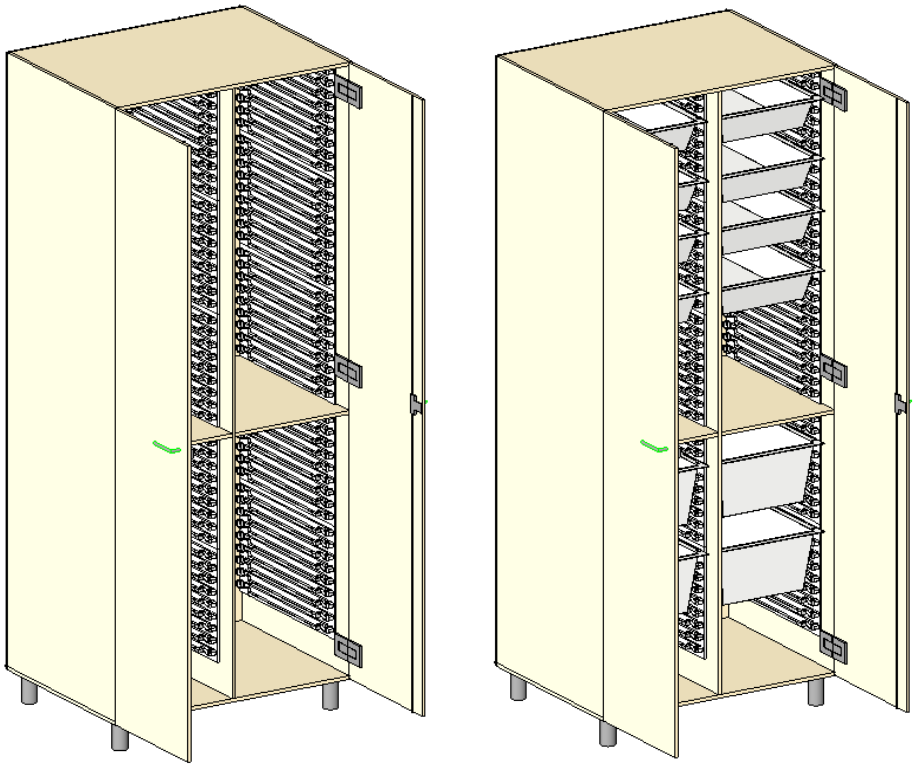

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0400
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0400 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	1
3	Стенка боковая	3
4	Стенка задняя	1
5	Двери	2
6 фурнитура	Направляющие под лотки из АВС - пластика	24
7 фурнитура	Ножки	4
8 фурнитура	Петли	6
9 фурнитура	Ручка с замком многостороннего запирания	2
10	Паспорт	1
11 фурнитура	Лотки выдвижные 600х400х100мм	8
12 фурнитура	Полки 600х400х200мм	2

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0400, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика


6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0400

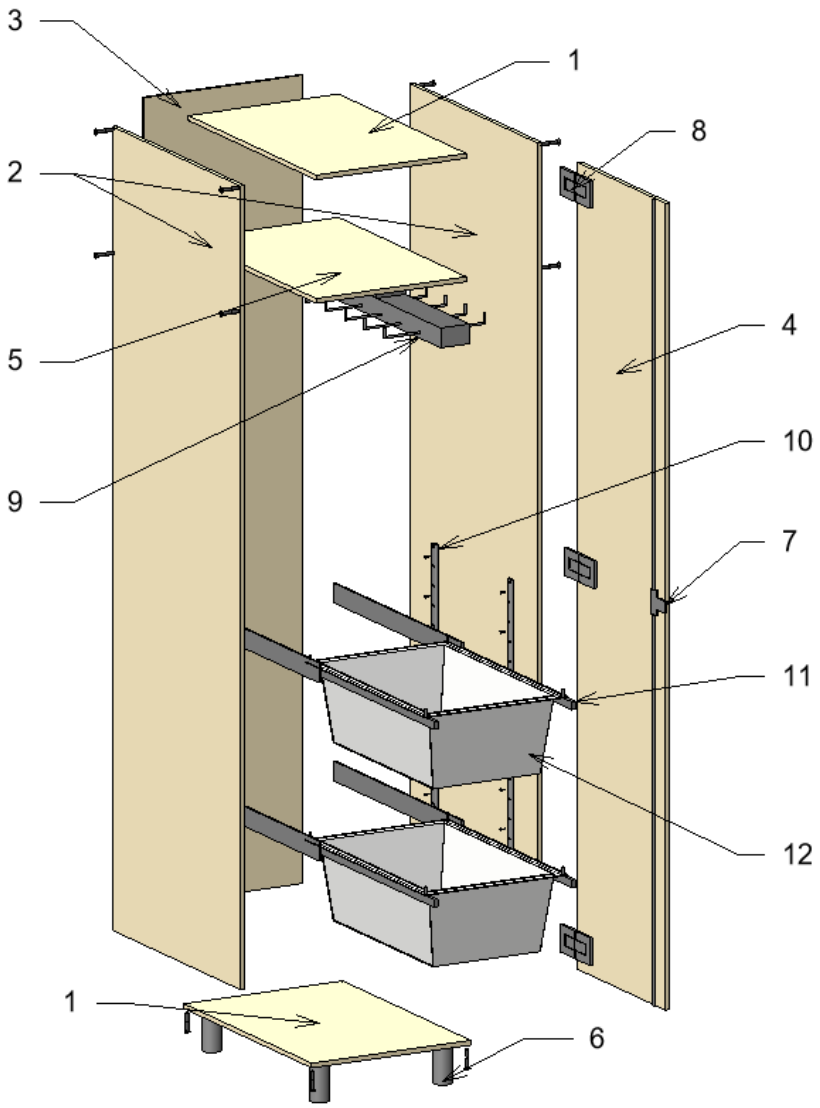

1. Крепим пилястры (10) к боковым стенкам (2)
2. К основанию (1) крепим ножки (6)
3. Из оснований (1) и боковых стенок (2) собираем каркас шкафа
4. Крепим выдвижную раму для катетеров (9) к полке (5)
5. Крепим полку (5) к каркасу шкафа
6. Крепим заднюю стенку (3)
7. К двери (4) крепим петли (8) и устанавливаем замок с ручкой (7)
8. Устанавливаем подготовленную дверь в каркас шкафа
9. Устанавливаем телескопические направляющие (11) в пазы пилястров(10) на необходимой высоте
10. Корзины (лотки), полки (12) устанавливаются на штыри в телескопических направляющих

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0401
ТУ BY 100289278.008-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0401 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС пластика.


2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	1
3	Стенка боковая	3
4	Стенка задняя	1
5	Двери	2
6 фурнитура	Направляющие под лотки из АВС - пластика	24
7 фурнитура	Ножки	4
8 фурнитура	Петли	3
9 фурнитура	Ручка с замком многостороннего запирания	1
10	Паспорт	1
11 фурнитура	Лотки выдвижные 600х400х100мм	8
12 фурнитура	Корзины выдвижные 600х400х200мм	4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

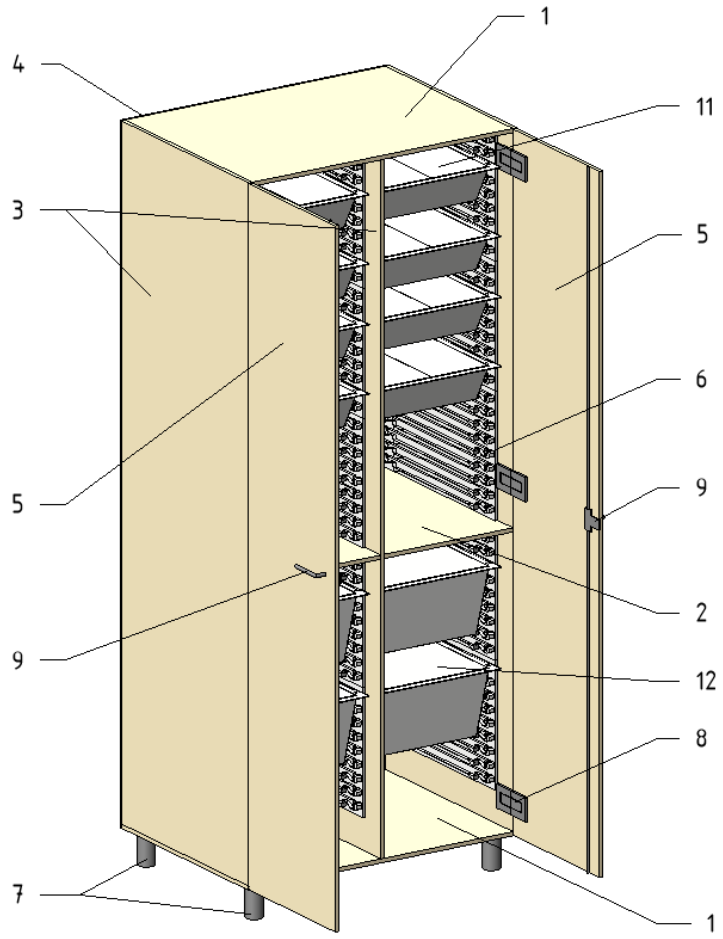

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов двухсекционный ШМИ-0401, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.


6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по сборке Шкаф для медицинских изделий и инструментов двухсекционный ШМИ-0401


1. К боковым стенкам (1) крепим панели направляющих из АВС-пластика(2)

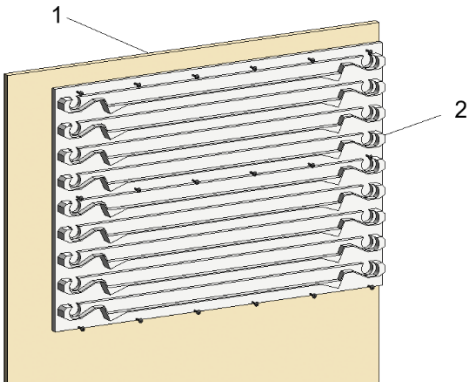

2. Крепим ножки(4) к основанию(3)

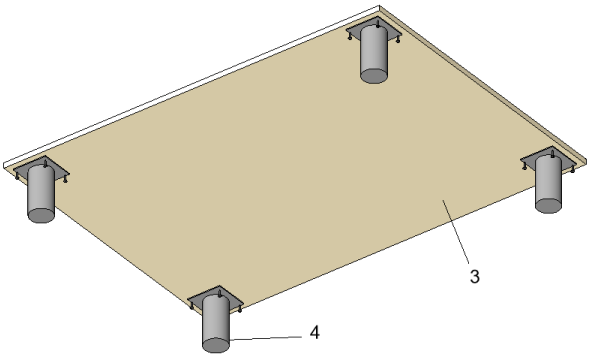


3. Собираем каркас шкафа

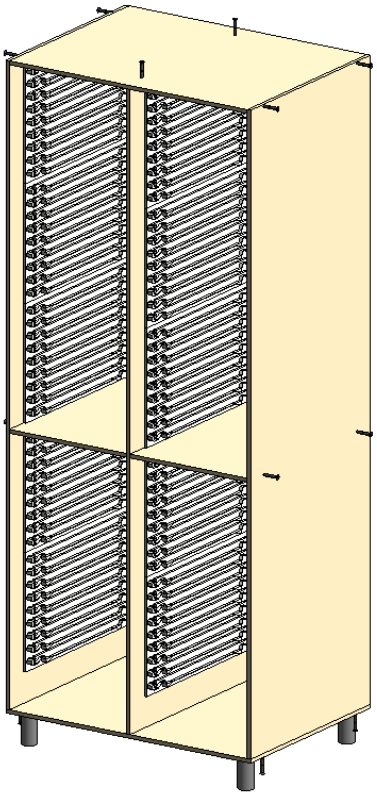


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Крепим заднюю стенку (5)

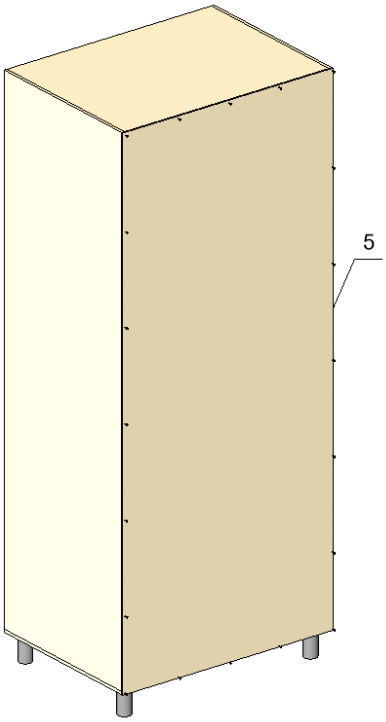


5. К частично остеклённой (либо стеклянной) двери(8) крепим петли(6) и ручку с замком(7)

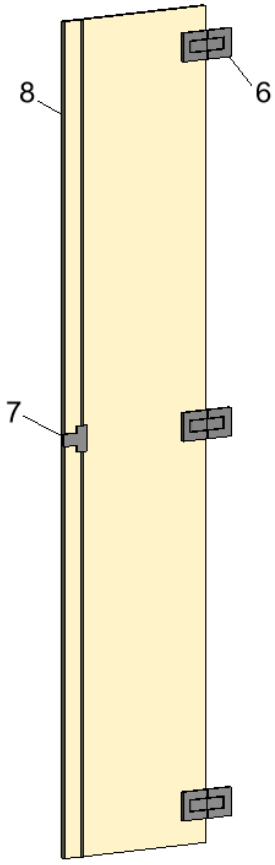

6. Крепим дверь к основному каркасу, заполняем необходимым количеством лотков

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

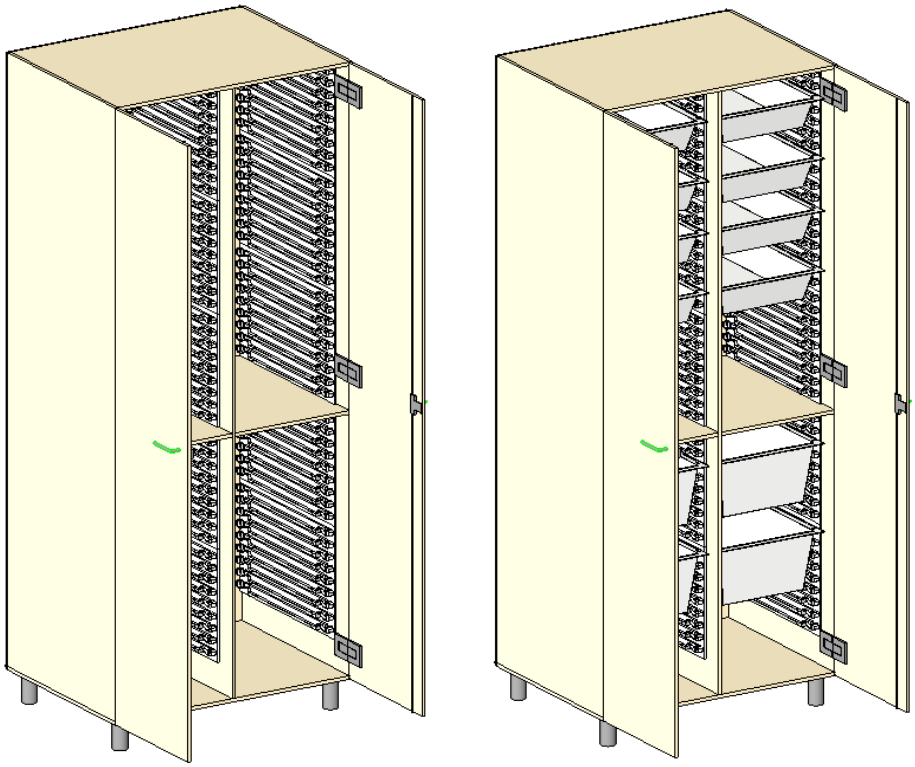

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0500
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0500 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	3
3	Стенка боковая	3
4	Стенка задняя	1
5	Двери	1
6 фурнитура	Ножки	4
7 фурнитура	Петли	3
8 фурнитура		
9 фурнитура	Ручка с замком многостороннего запирания	1
10	Паспорт	1

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0500, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК


6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке Шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0500

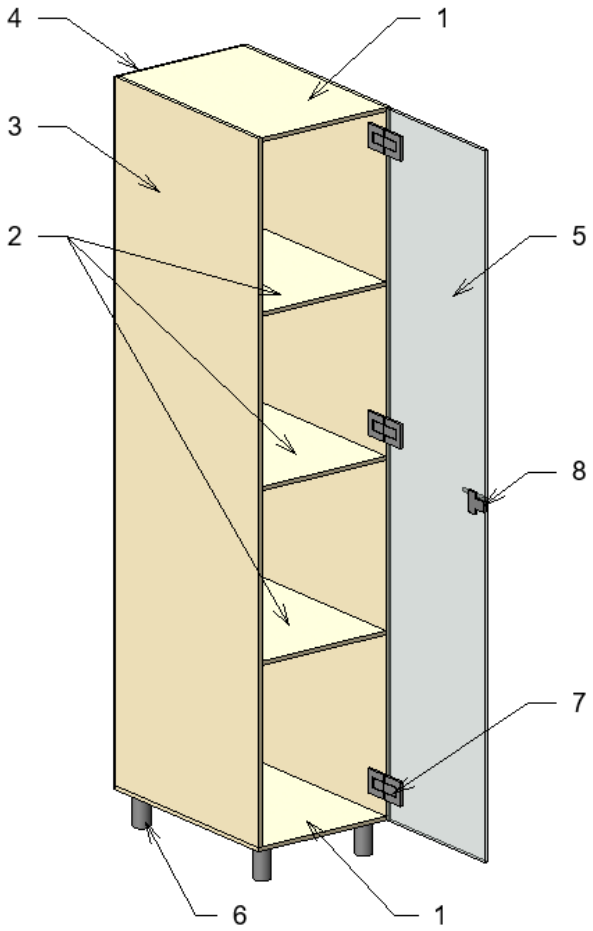

1. крепим к основанию (1) боковые стенки (3)

2. к боковой стене (3) крепим петли (7)

3. к дверному полотну (5) прикручиваем замок (8)

4.монтируем полки (2) на направляющие

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов двухсекционный ШМИ-0501
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0501 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	4
3	Стенка боковая	2
4	Стенка задняя	1
5	Двери	2
6	Ножки	4
7	Петли	6
8	Ручка с замком многостороннего запирания	2
9	Паспорт	1

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов двухсекционный ШМИ-0501, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке
Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0501



1.крепим к основанию боковые стенки

2.к боковой стене крепим петли

3.к дверному полотну прикручиваем замок

4.монтируем полки на направляющие

**данная инструкция является типовой наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0600
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0600 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	2
3	Стенка задняя	1
3	Двери	1
4	Выдвижные ящики	4
5 фурнитура	Ножки	4
6 фурнитура	Петли	3
7 фурнитура	Ручка	1
8	Паспорт	1
9	Полки	2

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0600, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Гарантии поставщика

6.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0600



1.крепим к основанию (2) боковые стенки (1)

2.к боковой стене (1) крепим петли (4)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.к дверному полотну (6) прикручиваем замок

4.монтируем полки (3) выдвижные ящики (5)на направляющие.

**данная инструкция является типовой, наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0601
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов двухсекционный ШМИ-0601 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезсредствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	4
3	Ящики выдвижные	4
4	Стенка боковая	2
5	Стенка задняя	1
6	Двери	2
7	Ножки	4
8	Петли	6
9	Ручка с замком многостороннего запирания	2
10	Паспорт	1

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов двухсекционный ШМИ-0601, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.008-2021 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке
шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0601



1.крепим к основанию (2) боковые стенки (1)

2.к боковой стене (1) крепим петли (4)

3.к дверному полотну (6) прикручиваем замок (8)

4.монтируем полки (3) и выдвижные ящики (5) на направляющие.

**данная инструкция является типовой, наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0700
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0700 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	2
3	Стенка задняя	1
3	Двери	1
4	выдвижные ящики	4
5 фурнитура	Ножки	4
6 фурнитура	Петли	3
7 фурнитура	Ручка	1
8	Паспорт	1

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0700, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке
шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ - 0700



1.крепим к основанию (2) боковые стенки (1)

2.к боковой стене (1) крепим петли (4)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.к дверному полотну (6) прикручиваем замок

4.монтируем выдвижные ящики (5)на направляющие.

**данная инструкция является типовой, наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0701
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов двухсекционный ШМИ-0701 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), направляющие под лотки из АВС- пластика.

2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Стенка боковая	3
3	Стенка задняя	1
4	Двери	2
5	Ножки	4
6	Петли	6
7	Ручка с замком многостороннего запирания	2
8	Полка выдвижная	8
9	Паспорт	1

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-0701, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Инструкция по сборке шкафа для медицинских изделий и инструментов ШМИ – 0701



1.крепим к основанию (2) боковые стенки (1)

2.к боковой стене (1) крепим петли (4)

3.к дверному полотну (6) прикручиваем замок (8)

4.монтируем ящики (5) на направляющие.

**данная инструкция является типовой, наполняемость изделия может меняться в зависимости от его наименования.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов с частично остекленными дверями
ШМИ-О-0510
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-О-0510 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), дверь частично остеклённая, полка.


2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	3
3	Стенка боковая	2
4	Стенка задняя	1
5	Дверь частично остеклённая	1
6	Ножки	4
7	Петли	3
8	Ручка	1
9	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

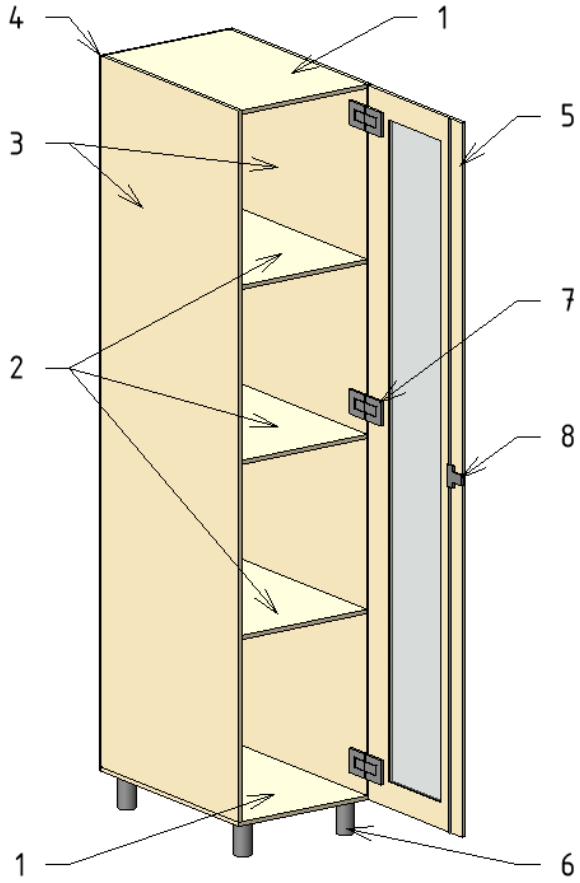

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-О-0510, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов с частично остеклёнными дверями двухсекционный ШМИ-О-0511
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-О-0511 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли),дверь частично остеклённая, полка.


2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	6
3	Стенка боковая	3
4	Стенка задняя	1
5	Дверь частично остеклённая	2
6	Ножки	4
7	Петли	3
8	Ручка	2
9	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

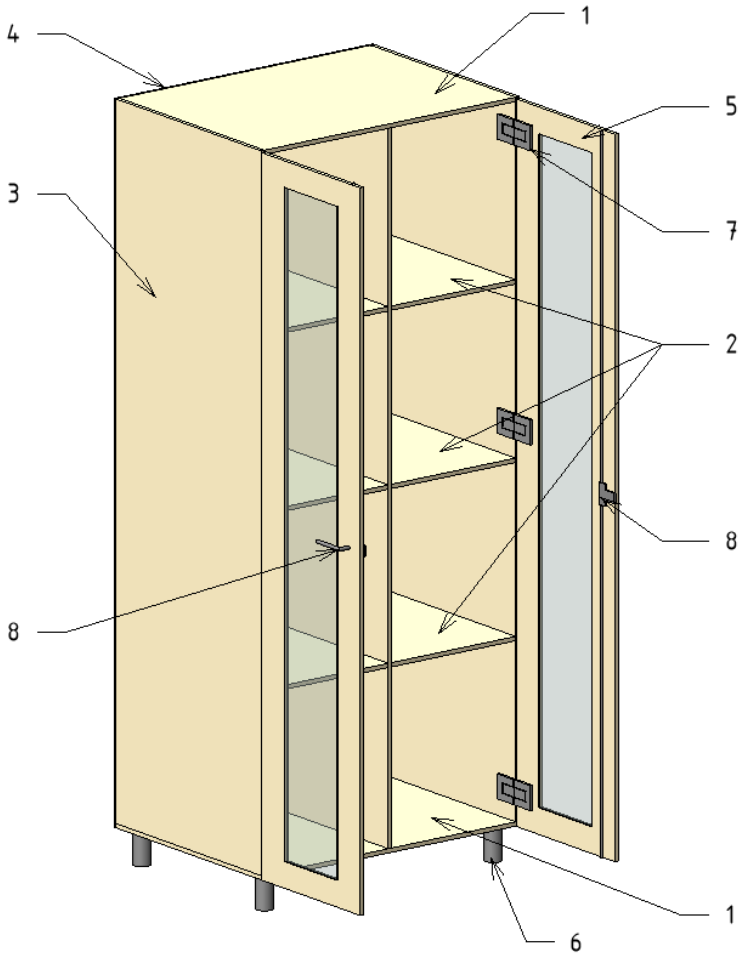

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-О-0511, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201,
20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов со стеклянными дверями ШМИ-С-0520
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-С-0520 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 400/1000х500/770х1700/2400

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), дверь частично остеклённая, полка.


2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	3
3	Стенка боковая	1
4	Стенка задняя	1
5	Дверь частично остеклённая	1
6	Ножки	4
7	Петли	3
8	Ручка	1
9	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

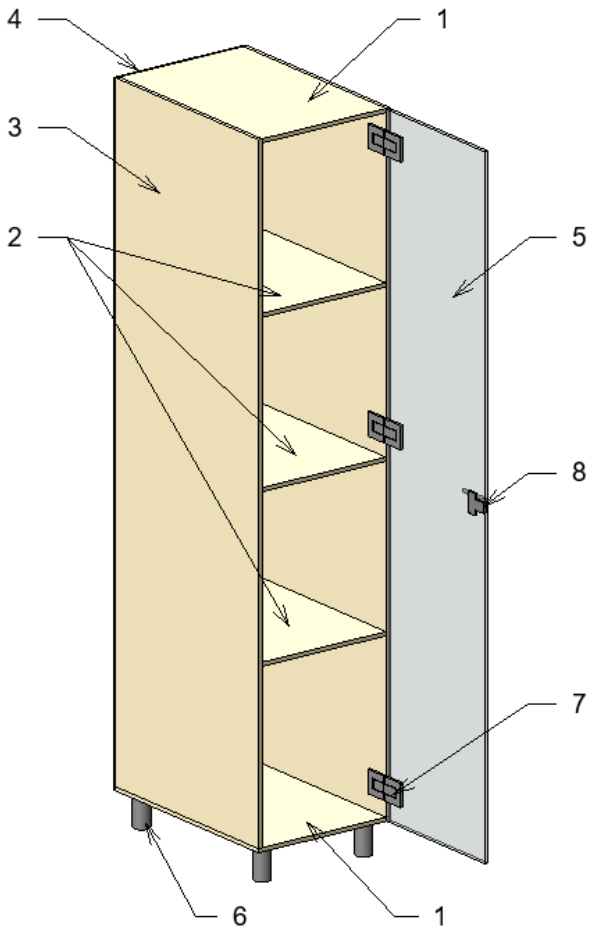

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-С-0520, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201, 20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

П А С П О Р Т

Шкаф для медицинских изделий и инструментов со стеклянными дверями двухсекционный ШМИ-С-0521
ТУ BY 100289278.011-2022

1.Назнчение изделия

1.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-С-0521 (далее по тексту - изделие) предназначен для установки в медицинских учреждениях. Используется в организациях системы здравоохранения.

1.2 Изделие должно эксплуатироваться в закрытых помещениях с естественной или искусственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 2°С и относительной влажности от 45% до 70%.

2. Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры изделия- 600/1400х500/700х1700/2400 мм

2.2 Масса не более 100 кг. Допустимая нагрузка до 200 кг.

2.3 Средний срок службы изделия до капитального ремонта не менее 5 лет.

2.4 Изделие изготовлено из HPL-панелей марки WDP-201, металлическая фурнитура (ножки, ручка, петли), дверь остеклённая, полка.


2.5 Изделие устойчиво к колебанию температуры, не воспламеняется, устойчиво к ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и безопасно для обслуживающего персонала, выдерживает обработку дезинфицирующими средствами.

3.Комплектность

3.1 Комплектность изделия соответствует таб.3.1

№ позиции	Наименование	К-во, шт.
1	Основание	2
2	Полка	6
3	Стенка боковая	3
4	Стенка задняя	1
5	Дверь остеклённая	2
6	Ножки	4
7	Петли	6
8	Ручка	2
9	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

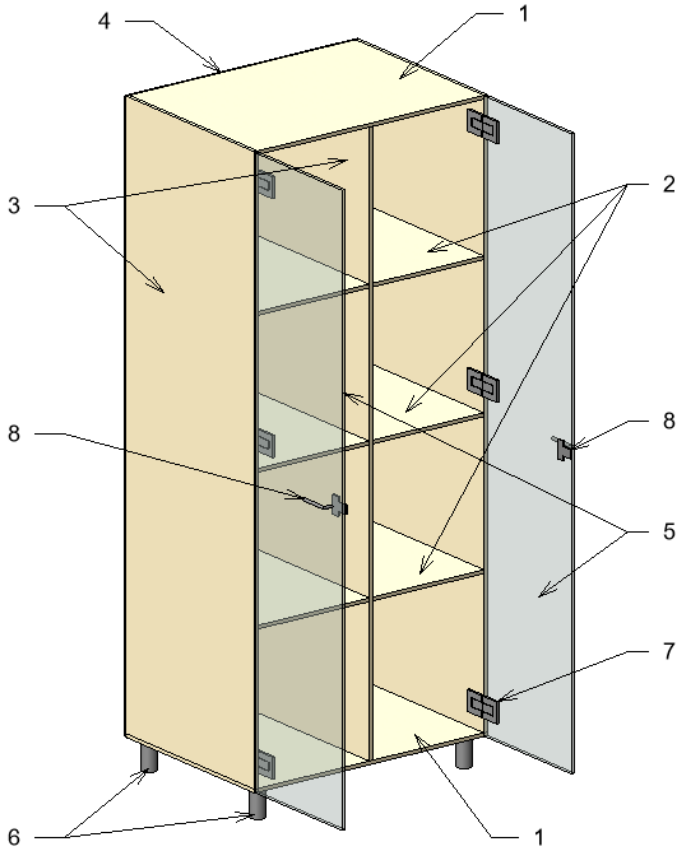

4. Подготовка к работе

4.1 Изделие поставляется в собранном виде.

4.2 Распакуйте изделие.

4.3 Проверьте комплектность изделия согласно раздела 3 настоящего паспорта.

4.4 Проверьте состояние изделия и его элементов после транспортировки.

4.5 Установите изделие на место эксплуатации.

5. Свидетельство о приёмке

5.1 Шкаф для медицинских изделий и инструментов ШМИ-С-0521, заводской номер_____, соответствует ТУ BY 100289278.011-2022 и признан годным в эксплуатации.

Дата выпуска_____

М.П. Начальник ОТК

6.Гарантии поставщика

6.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортировки и монтажа.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - **18** месяцев с даты продажи.

6.3 Наименование и адрес изготовителя - ОАО «Стройтрест №35» филиал СУ-201,
20075, г. Минск, ул. Селицкого, 31а.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru