DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Стекло Покровное

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Покровное стекло предназначено для покрытия образца и защиты его от механического воздействия и воздействия окружающей среды.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Внимание			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP
Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:15.07.2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Стекло Предметное

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Предметное стекло предназначено для сбора, хранения и транспортировки образца или мазка.

3. Символы

No.	Symbol		No.	Symbol	Explain
1		Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Сертификация CE
3		Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12		Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Медицинское изделие не подвергалось процессу стерилизации	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.



DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel.: +86 025-52733215 Fax：+86 025-52733215 Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:15.07.2021

Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Кассета Гистологическая

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Кассета гистологическая предназначена для проводки и хранения клинических образцов тканей.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Внимание			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.08.2021

Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Микротомное лезвие

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

MB03-0515,MB03-0616,HS300-000,HS400-000.

2. Назначение

Микротомное лезвие предназначено для установки в микротом или рукоятку для разрезания микротонких срезов ткани во время диагностической процедуры in vitro.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Сертификация CE
3		Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Внимание			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.08.2021

Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd
CE

Инструкция по применению

Губка для биопсии

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

. EC00-200

2. Назначение

Губка для биопсии предназначена для использования с гистологическими кассетам при обработке биопсий и небольших образцов, что помогает избежать потери небольших фрагментов ткани.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Внимание			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Лабораторный контейнер

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно


1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Лабораторный контейнер предназначен для использования в качестве специализированного сосуда для хранения лабораторных субстанций, биологических образцов и других материалов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3		Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11		Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.



DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP

Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Сентября,2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Криопробирки CryoMo

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Криопробирки CryoMo предназначены для криоконсервации, хранения и последующего извлечения биологических образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.07.2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Криопробирки CryoTrust

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Криопробирки CryoTrust предназначен для криоконсервации, хранения и последующего извлечения биологических образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.07.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Криопробирки CryoTrust

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Криопробирки CryoTrust предназначены для криоконсервации, хранения и последующего извлечения биологических образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.07.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Криопробирки MoleSOL

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Криопробирки MoleSOL предназначены для криоконсервации, хранения и последующего извлечения биологических образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.07.2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Петля микробиологическая

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Петля микробиологическая предназначена для переноса и распространения инокулята в культуральную среду для диагностической обработки или тестирования in vitro.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Держатель стёкол

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SR88-0112,SR88-0124,SR89-0112,SJ01,SJ02,SJ03,SR07,SJ07,SR04,SJ04,SR05,SJ05,SR06,SJ06,SP20-0100,SP20-0200,SP20-0300, SP20-0400,SS112,SS103,SS010,SS020.

2. Назначение

Держатель стёкол — это устройство, используемое для удержания стекла во время подготовки, окрашивания и транспортировки.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	LOT	Код партии
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8		Дата изготовления
3		Производитель	9		Использовать до
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Не допускать попадания воды
5		Хрупкий	11		Внимание
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP
Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Августа,2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Чашка Петри

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Чашка Петри предназначена для исследования микроорганизмов и клеточных культур.

3. Symbols

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Наконечники для пипеточных дозаторов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

Наконечники SupaLiq : PT01, PT02, PT04, PT05, PT07, PT08, PT09, PT11, PT12, PT13, PT14, PT15, PT16, PT17,PT18, PT20, PT22, PT26

Наконечники с фильтром SupaLiq : FT41, FT42, FT48, FT49, FT43, FT44, FT46, FT47

Наконечники MoleTek : FT10, FT11, FT12, FT13, FT14, FT16, FT17, FT18, FT20, FT21, FT22, FT23, FT24, FT26, FT27, FT28, FT19, FT29

Наконечники с фильтром MoleTek : FT50, FT51, FT52, FT53, FT54, FT56, FT57, FT58, FT59, FT60, FT61, FT62, FT63, FT64, FT66, FT67, FT68, FT69

2. Назначение

Наконечники для пипеточных дозаторов выполненные в виде заостренного цилиндрического наконечника, который прикрепляется к дозирующему отверстию пипетки или дозатора и откуда отбирается необходимый объем жидкости для доставки в целевую ёмкость.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	7		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	9		Использовать до
4		Производитель	10	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	11		Не допускать попадания воды
6		Внимание	12	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

Внимание!: Только для профессионального использования

Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel.: +86 025-52733215

Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 15 Июня,2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Наконечники для пипеточных дозаторов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

Наконечники с фильтром SupaLiq : FT41-2201, FT42-2201, FT48-2201, FT49-2201, FT43-2201, FT44-2201, FT46-2201, FT47-2201

Наконечники MoleTek : FT11-2201, FT21-2201, FT12-2201, FT22-2201, FT18-2201, FT28-2201, FT19-2201, FT29-2201, FT13-2201, FT23-2201, FT14-2201, FT24-2201, FT16-2201, FT26-2201, FT17-2201, FT27-2201

Наконечники с фильтром MoleTek : FT51-2201, FT61-2201, FT52-2201, FT62-2201, FT58-2201, FT68-2201 FT59-2201, FT69-2201, FT53-2201, FT63-2201, FT54-2201, FT64-2201, FT56-2201, FT66-2201, FT57-2201, FT67-2201

2. Назначение

Наконечники для пипеточных дозаторов выполненные в виде заостренного цилиндрического наконечника, который прикрепляется к дозирующему отверстию пипетки или дозатора и откуда отбирается необходимый объем жидкости для доставки в целевую ёмкость.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	7		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	9		Использовать до
4		Производитель	10	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	11		Не допускать попадания воды
6		Внимание	12	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

Внимание!: Только для профессионального использования

Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel.: +86 025-52733215

Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 15 Июня,2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Наконечники для пипеточных дозаторов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

Наконечники SupaLiq : PT01, PT02, PT04, PT05, PT07, PT08, PT09, PT11, PT12, PT13, PT14, PT15, PT16, PT17,PT18, PT20, PT22, PT26

Наконечники с фильтром SupaLiq : FT41, FT42, FT48, FT49, FT43, FT44, FT46, FT47

Наконечники MoleTek : FT10,FT11,FT12, FT13, FT14, FT16, FT17, FT18, FT20,FT21,FT22, FT23, FT24, FT26, FT27, FT28,

Наконечники с фильтром MoleTek : FT50, FT51, FT52, FT53, FT54, FT56, FT57, FT58, FT60, FT61, FT62, FT63, FT64, FT66, FT67, FT68

2. Назначение

Наконечники для пипеточных дозаторов выполненные в виде заостренного цилиндрического наконечника, который прикрепляется к дозирующему отверстию пипетки или дозатора и откуда отбирается необходимый объем жидкости для доставки в целевую ёмкость.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	7		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	9		Использовать до
4		Производитель	10	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	11		Не допускать попадания воды
6		Внимание	12	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

Внимание!: Только для профессионального использования

Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel.: +86 025-52733215

Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 15 Июня,2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Контейнер для образцов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Контейнер для образцов предназначен для хранения реагентов, буферов, биологических образцов или других материалов в целях подготовки к процедурам диагностики in vitro.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP
Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Тампоны TipSWAB

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Тампоны TipSWAB предназначены для кратковременного взятия образцов с поверхности тела или из отверстий тела или для очистки кожи и поверхности устройства.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие
3		Внимание	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Способ применения

Откройте упаковку и приступите к использованию.

5. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Июля, 2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Пипетки

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно


1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Пипетки предназначены для ручного забора, переноса, дозирования и введения небольших объемов жидких материалов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Сертификация CE
3		Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12		Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.08.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Пипетки

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Пипетки предназначены для ручного забора, переноса, дозирования и введения небольших объемов жидких материалов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.08.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Тампоны TubSWAB

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Тампоны TubSWAB предназначен для кратковременного взятия проб с поверхности тела или в отверстиях тела и транспортировки.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие
3		Внимание	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Способ применения

Откройте упаковку и приступите к использованию.

5. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Июля, 2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Центрифужная пробирка

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

TG06-0005,TG06-0010,TG06-0015,TG06-0025,TG06-0050,TG07-0005,TG07-0010,TG07-0015,TG07-0025,TG07-0050,TP31-0001,TP31-0002,TP31-0101,TP41-0001,TP41-0002,TP41-0101,TP71-0001,TP72-0001,TP81-0001,TP82-0001,TP83-0001,TP84-0001,TP85-0001,TP86-0001,TC62,TC63,TC64,TC410,TC420,TC411,TC421,TC412,TC422,TC413,TC423,TC610,TC620,TC611,TC621,TC612,TC622,TC613,TC623,TC450,TC460,TC451,TC461,TC452,TC462,TC650,TC660,TC651,TC661,TC652,TC662,CT605-001,CT615-001,CT620-001,CT605-021,CT615-021,CT620-021,TC01,TC02,TC03,TC04,TC05,TC15,TC06,TC07,TC17,TC10,TC11,TC13,TC12,TC22,TC08,TC09,TC19,TC55,TC51,TC56,TC52,TC53,TC54,TC40-0200,TC40-0250,TC40-0500,TC41-1001,TC41-1002,TC41-1003,TC41-1004,TC41-1005,TC41-1006,TC42-0101,TC42-0100,TC89-4010,TC99-4010.

2. Назначение

Центрифужная пробирка предназначена для разделения путем центрифугирования клинического образца, реагента или другого материала, связанного с диагностическим тестированием in vitro.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8	CE	Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения	14	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Контейнер для хранения стёкол

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SM01,SM02,SM03,SM04,SM05,SM06,SM08,SM50,SM51,SM52,SM53,SM20,SM21,SM22,SM54,SM84,SM58,SM59,SM56,SM55, SM57,SM61,SM60,SM67,SM88,SM89,SM86,SM85,SM87,SM91,SM90.

2. Назначение

Контейнер для хранения стёкол предназначен для организации безопасного хранения окрашенных стёкол для их защиты и представления.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	LOT	Код партии
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8		Дата изготовления
3		Производитель	9		Использовать до
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Не допускать попадания воды
5		Хрупкий	11		Внимание
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Ноября,2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Диспенсер для стёкол

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SH200.

2. Назначение

Диспенсер для стёкол предназначен для выдачи неиспользованных стёкол.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	LOT	Код партии
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8		Дата изготовления
3		Производитель	9		Использовать до
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Внимание
5		Хрупкий	11		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Ноября,2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Пробирки

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

TG57-1858,TG58-1858,TG58-2885,TG51-1275,TG51-1352,TG51-1652,TG51-1653,TG51-2053,TG52-1275,TG52-1352,TG52-1652,TG52-1653,TG52-2053,TG61-1275,TG61-1352,TG61-1652,TG61-1653,TG61-2053,TG62-1275,TG62-1352,TG62-1652,TG62-1653,TG62-2053,TG53-1275,TG53-1352,TG53-1652,TG53-1653,TG53-2053,TG54-1275,TG54-1352,TG54-1652,TG54-1653,TG54-2053,TG63-1275,TG63-1352,TG63-1652,TG63-1653,TG63-2053,TG64-1275,TG64-1352,TG64-1652,TG64-1653,TG64-2053,TG55-1275,TG55-1352,TG55-1652,TG55-1653,TG55-2053,TG56-1275,TG56-1352,TG56-1652,TG56-1653,TG56-2053,TG65-1275,TG65-1352,TG65-1652,TG65-1653,TG65-2053,TG66-1275,TG66-1352,TG66-1652,TG66-1653,TG66-2053,TG02-1050,TG02-1075,TG02-1275,TG02-1252,TG02-1352,TG02-1262,TG02-1652,TG03-1075,TG03-1275,TG03-1252,TG03-1352,TG03-1530,TG03-1552,TG03-1553,TG03-1652,TG03-1630,TG03-1653,TG03-1853,TG03-2053,TG04-1075,TG04-1275,TG04-1252,TG04-1352,TG04-1530,TG04-1652,TG04-1630,TG04-1653,TG04-1853,TG04-2053,TP01-0101,TP01-0201,TP02-0101,TP02-0201,TP02-0301,TP05-0101,TP05-0201,TP03-0101,TP03-0201,TP06-0101,TP06-0201,TP04-0101,TP04-0201,TP11-0101,TP11-0201,TP12-0101,TP12-0201,TP15-0101,TP15-0201,TP13-0101,TP13-0201,TP16-0101,TP16-0201,TP14-0101,TP14-0201,TP32-0001,TP02-0113A.

2. Назначение

Пробирка предназначена для хранения реагентов, буферов, биологических образцов или других материалов при подготовке к процедурам диагностики in vitro.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8	CE	Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения	14	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Дата выпуска:25.11.2021

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Гистологическая система хранения

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SM30,SM31,SM32,SM33,SM34,SM44,SM62,SM63,SC01-1026,SC01-2026,SC01-3026,SC01-4026,SC03-1026,SC03-3026,SC03-4026,SC13-1026,SC13-3026,SC13-4026,SC02-3016,SC02-3008,SC02-3015,SC02-3116,SC02-3108,SC02-3115,SC02-1016,SC02-1008,SC02-1015,SC03-3016,SC03-3116,SC03-4016,SC03-1016,SC03-3008,SC03-3108,SC03-4008,SC03-1008,SC03-3015,SC03-3115,SC03-4015,SC03-1015,SC510-000,SC520-000,SC511-000,SC521-000,SC515-000,SC525-000,SC00-0000.

2. Назначение

Гистологическая система хранения предназначена для организации безопасного хранения образцов с целью их защиты при хранении или транспортировке.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	LOT	Код партии
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8		Дата изготовления
3		Производитель	9		Использовать до
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Внимание
5		Хрупкий	11		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP
Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Ноября,2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Станция для хранения пробирок

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Станция для хранения пробирок предназначена для одновременного хранения центрифужных пробирок разных объемов и размеров.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	MD	Медицинское изделие
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	LOT	Код партии
3		Производитель	9		Дата изготовления
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Не допускать попадания воды
5		Хрупкий	11		Внимание
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Центрифужная пробирка

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно


1. Номер модели

TC62, TC63, TC64, TC55, TC51, TC56, TC52-02XX, TC53, TC54, CT605, CT615, CT620-021

2. Назначение

Центрифужная пробирка предназначена для разделения путем центрифугирования клинического образца, реагента или другого материала, связанного с диагностическим тестированием in vitro.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3		Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11		Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения	14		Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Инструкция по применению

Инструкция

【Наименование】Цервикальная щетка

【Технические характеристики】См. этикетку на упаковке

【Назначение】Цервикальная щетка разработана как компонент набора для взятия биопсии шейки матки или набора для мазка Папаниколау, а также как вспомогательное устройство для взятия проб во время вагинального исследования с целью получения диагноза ткани у женщины с интраэпителиальным заболеванием, таким как тест Папаниколау.

【Способ использования】Вставьте щетку во влагалище и возьмите образец биопсии.

【Запреты】Нет

【Предостережения и меры предосторожности】Устройство одноразового применения, не используйте его повторно. Обратите внимание на срок годности на упаковке перед использованием.

【Инструкция по хранению】Хранить в прохладном, сухом месте, беречь от солнечных лучей и едких жидкостей.

【Утилизация】Утилизируйте продукт в соответствии с политикой больницы или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание: повторное использование устройств может повлиять на диагностику!

【Код партии】См. этикетку на упаковке

Срок годности】См. этикетку на упаковке

【Производитель】

Наименование: DiaTrust Medical Co., Ltd

Address: 1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel.: +86 025-52733215

Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

【Уполномоченный европейский представитель】

Name：Wellkang Ltd

Address：Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry, BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Web site：www.wellkang.ltd.uk　www.CE-marking.eu

【Символы】

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Обратитесь к инструкции перед использованием	7		Медицинское изделие однократного применения
2		Не стерильное медицинское изделие	8	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	9		Использовать до
4		Производитель	10	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	11		Не допускать попадания воды
6		Внимание	12		Не допускать попадания солнечного света

⚠ **Внимание: только для профессионального использования!**

Дата: 15.06.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Инструкция по применению

Инструкция

【Наименование】Цервикальная щетка

【Технические характеристики】См. этикетку на упаковке

【Назначение】Цервикальная щетка разработана как компонент набора для взятия биопсии шейки матки или набора для мазка Папаниколау, а также как вспомогательное устройство для взятия проб во время вагинального исследования с целью получения диагноза ткани у женщины с интраэпителиальным заболеванием, таким как тест Папаниколау.

【Способ использования】Вставьте щетку во влагалище и возьмите образец биопсии.

【Запреты】Нет

【Предостережения и меры предосторожности】Устройство одноразового применения, не используйте его повторно. Обратите внимание на срок годности на упаковке перед использованием.

【Инструкция по хранению】Хранить в прохладном, сухом месте, беречь от солнечных лучей и едких жидкостей.

【Утилизация】Утилизируйте продукт в соответствии с политикой больницы или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание: повторное использование устройств может повлиять на диагностику!

【Код партии】См. этикетку на упаковке

Срок годности】См. этикетку на упаковке

【Производитель】

Наименование: DiaTrust Medical Co., Ltd

Address: 1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel.: +86 025-52733215

Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

【Уполномоченный европейский представитель】

Name：Wellkang Ltd

Address：Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry, BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Web site：www.wellkang.ltd.uk　www.CE-marking.eu

【Символы】

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Обратитесь к инструкции перед использованием	7		Медицинское изделие однократного применения
2	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации	8	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	9		Использовать до
4		Производитель	10	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	11		Не допускать попадания воды
6		Внимание	12		Не допускать попадания солнечного света

⚠ **Внимание: только для профессионального использования!**

Дата: 15.06.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Счетная камера

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

HM330,HM340,HM110,HM111,HM112,HM113,HM114,HM210,HM211,HM212,HM213,HM214.

2. Назначение

Счетная камера предназначена для микроскопического подсчета клеток, клеточных частиц или других биологических компонентов, присутствующих в клинических лабораторных образцах.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	9		Использовать до
4		Производитель	10	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	11		Внимание
6		Не допускать попадания солнечного света	12		Не допускать попадания воды

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.


DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP
Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата:18.08.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Кольцо уплотнительное 0-ring

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

EO01.

2. Назначение

Встраиваемое уплотнительное кольцо предназначено для удержания образцов тканей в адаптере держателя микротома для получения срезов и идентификации блоков тканей при хранении.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие одноразового использования
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Внимание			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата:18.01.2022

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Наборы для сбора образцов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

MS301,MS302,MS303,MS304,MS305,MS306,753410,753510,753610,753710,753411,753511,753611,758410,758510,758610,758710,757510,757710,753420,753520,753620,753720,753421,753521,753621,758420,758520,758620,758720,757520,757720,753011,758011,757011,753021,758021,757021.

2. Назначение

Наборы для сбора образцов предназначены для временного сбора образцов с поверхности тела или в отверстиях тела и транспортировки..

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	MD	Медицинское изделие	8	CE	Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения			

4. Срок годности

2 года.

5. Температура хранения

5~25℃.

6. Время хранения образца

Не инактивированный:PH=7.4±0.2

Образцы должны быть представлены для тестирования как можно скорее после отбора. Если образцы не могут быть протестированы немедленно, их можно хранить при температуре 15–25 ℃ не более 72 часов или хранить при температуре 2–8 ℃ не более 7 дней.

Инактивированный тип

Образцы должны быть представлены для тестирования как можно скорее после отбора. Если образцы не могут быть протестированы немедленно, их можно хранить при 15-25 ℃ не более 24 часов или хранить при 2-8 ℃ не более 3 дней.

7. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностики!
- Надевайте перчатки и маски и принимайте защитные меры при использовании этого продукта!.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- При обнаружении истечения срока годности, помутнения и вытекания раствора для хранения, использовать запрещается!

DiaTrust Medical Co., Ltd
#1001, Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Ave. Jiangning Dist. 211100, Nanjing, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата: 18.01.2022

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Набор для вакуумного сбора мочи

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

VC110-000,VC110-010,VC110-011,VC110-012,VC120-012,VC121-012,VC122-012,VC130-012,VC131-012,VC132-012,VC140-110, VC140-710,VC140-112, VC140-712.

2. Назначение

Система вакуумного сбора мочи предназначена для сбора, хранения и переноса образцов мочи..

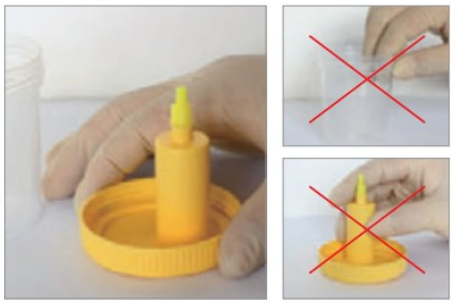
3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1.	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	2.	CE	Сертификация CE
3.		Обратитесь к инструкции перед использованием	4.		Дата изготовления
5.	LOT	Код партии	6.		Использовать до
7.		Производитель	8.	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
9.		Хрупкий	10.		Не допускать попадания воды
11.		Не допускать попадания солнечного света	12.		Внимание

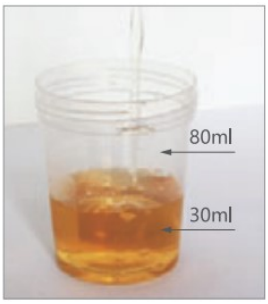
4. Инструкция по эксплуатации системы вакуумного сбора мочи



1.Поверните крышку против часовой стрелки.
(примечание: не открывать защитную этикетку если вы не лаборант.)



2.Поместите отвинченную крышку на чистую столешницу. (Примечание: не прикасайтесь к поверхности всасывающего патрубка и цилиндра, а также к внутренней поверхности чашки).



3.Желательно собрать около 60 мл мочи. Объем сбора должен быть не менее 30 мл и не более 80 мл.



4.Закройте крышку и закрутите её по часовой стрелке.



5.Исследователь осторожно встряхивает образец мочи перед сбором.



6.Снимите защитную этикетку и откройте отверстие для сбора.



7.Возьмите пробирку для сбора мочи, вставьте колпачком вниз вдоль отверстия в крышке и нажмите вниз. Проколите пробку из бутилкаучука пункционной иглой, чтобы моча могла полностью попасть в пробирку (10 мл).



8.После завершения вытяните пробирку для сбора мочи вверх и накройте защитной этикеткой.



9.Возьмите пробирку для сбора мочи для осмотра. Сбор мочи завершен.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Инструкция по эксплуатации системы вакуумного сбора мочи (простая)



6. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Не использовать повторно

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021
Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Чашка для образцов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно


1. Номер модели

SV430-003,V430-103,SV430-113,SV430-002,SV430-102,SV430-112,SV431-003,SV431-103,SV431-113,SV431-002,SV431-102, SV431-112,SV610-003,SV610-103,SV610-113,SV610-002,SV610-102,SV610-112,SV611-003,SV611-103,SV611-113,SV611-002, SV611-102,SV611-112,SV620-003,SV620-103,SV620-113,SV620-002,SV620-102,SV620-112,SV621-003,SV621-103,SV621-113, SV621-002,SV621-102,SV621-112,SV630-003,SV630-103,SV630-113,SV630-002,SV630-102,SV630-112,SV631-003,SV631-103, SV631-113,SV631-002,SV631-102,SV631-112,SV810-003,SV810-103,SV810-113,SV810-002,SV810-102,SV810-112,SV811-003, SV811-103,SV811-113,SV811-002,SV811-102,SV811-112,SV921-001,SV921-006,SV930-016,SV930-002,SV940-016,SV940-006, SV940-002,SV941-016,SV941-006,SV941-002,UC11-0013,UC11-0002,UC11-0016,UC11-1013,UC11-1002,UC11-1016, UC11-1113,UC11-1102,UC11-1116,UC12-0013,UC12-0002,UC12-0016,UC12-1013,UC12-1002,UC12-1016,UC12-1113, UC12-1102,UC12-1116,UC13-0013,UC13-0002,UC13-0016,UC13-1013,UC13-1002,UC13-1016,UC13-1113,UC13-1102, UC13-1116,UC14-0013,UC14-0002,UC14-0016,UC14-1013,UC14-1002,UC14-1016,UC14-1113,UC14-1102,UC14-1116, UC21-0013,UC21-0002,UC21-0016,UC21-1013,UC21-1002,UC21-1016,UC21-1113,UC21-1102,UC21-1116,UC22-0013, UC22-0002,UC22-0016,UC22-1013,UC22-1002,UC22-1016,UC22-1113,UC22-1102,UC22-1116,UC23-0013,UC23-0002, UC23-0016,UC23-1013,UC23-1002,UC23-1016,UC23-1113,UC23-1102,UC23-1116,UC24-0013,UC24-0002,UC24-0016, UC24-1013,UC24-1002,UC24-1016,UC24-1113,UC24-1102,UC24-1116,SV710-001,FC001-000-16,FC001-000-13,FC001-000-17, FC001-000-02,FC001-000-08,FC001-100-16,FC001-100-13,FC001-100-17,FC001-100-02,FC001-100-08,FC001-201-16, FC001-201-13,FC001-201-17,FC001-201-02,FC001-201-08,FC002-000-16,FC002-000-13,FC002-000-17,FC002-000-02, FC002-000-08,FC002-100-16,FC002-100-13,FC002-100-17,FC002-100-02,FC002-100-08,FC002-201-16,FC002-201-13, FC002-201-17,FC002-201-02,FC002-201-08,FC000-000-16,FC000-000-13,FC000-000-17,FC000-100-16,FC000-100-13, FC000-100-17,FC000-201-16,FC000-201-13,FC000-201-17,FC201-000-16,FC201-000-13,FC201-000-17,FC201-100-16, FC201-100-13,FC201-100-17,FC201-201-16,FC201-201-13,FC201-201-17,FC202-000-16,FC202-000-13,FC202-000-17, FC202-100-16,FC202-100-13,FC202-100-17,FC202-201-16,FC202-201-13,FC202-201-17,FC203-000-16,FC203-000-13, FC203-000-17,FC203-100-16,FC203-100-13,FC203-100-17,FC203-201-16,FC203-201-13,FC203-201-17,FC204-000-16, FC204-000-13,FC204-000-17,FC204-100-16,FC204-100-13,FC204-100-17,FC204-201-16,FC204-201-13,FC204-201-17.

2. Назначение

Чаша для образцов предназначена для хранения реагентов, буферов, биологических образцов или других материалов при подготовке к процедурам диагностики in vitro.

3. Symbols

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Сертификация CE
3		Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12		Уполномоченный представитель в Европе

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Внимание			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.



DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021

Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Шпатели, Скребки

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SL100-016,SL100-025,SL100-030,SL110-016,SL110-025,SL110-030,SL200-038,SL300-2202,SL300-0202,SL310-2217,SL310-0217, SL400-2202,SL400-0202,SL500-2217,SL500-0217,SL600-1202,SL610-1202,SL620-1202,SL630-1202.

2. Назначение

Культуральные скребки и шпатели предназначены для работы с клетками в различной культуральной посуде.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8	CE	Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

EC REP Web site：www.diatrust.cn

Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Пакет биопсийный

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

HB101-000,HB102-000,HB103-000,HB104-000,HB105-000,HB201-000,HB202-000,HB203-000,HB204-000,HB205-000.

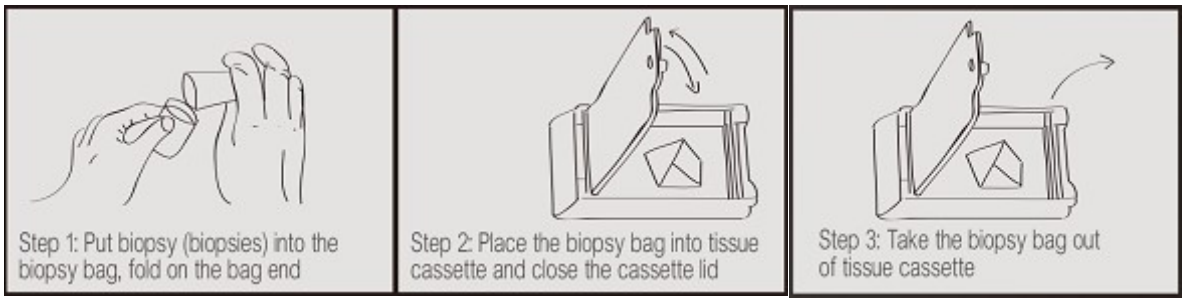
2. Назначение

Пакеты для биопсии предназначены для герметичной упаковки гистологических кассет с тканями при проведении биопсии и небольших образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Инструкция по работе



Шаг1: Поместить ткань в пакет для биопсии, загнуть край пакета.

Шаг2: Поместить пакет для биопсии в гистологическую кассету и закрыть крышкой.

Шаг3: Достать пакет для биопсии из гистологической кассеты.



Шаг4: Открыть пакет для биопсии разогнув края.

Шаг5: Извлечь ткань из пакета для биопсии.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021

Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Форма заливочная

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно


1. Номер модели

BM01-0707,BM01-1515,BM01-2424,BM01-3724,BM01-3024,BM02-0707,BM02-1515,BM02-2424,BM02-3724,BM02-3024, BM03-0707,BM03-1717,BM03-2525,BM03-2532,BM03-2540,BM03-5538.

2. Назначение

Заливочная форма предназначена для облегчения заливки всех моделей уплотнительных колец и гистологических кассет при заливке образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1.		Медицинское устройство для диагностики in vitro	2.		Сертификация CE
3.		Обратитесь к инструкции перед использованием	4.		Дата изготовления
5.		Код партии	6.		Использовать до
7.		Производитель	8.		Уполномоченный представитель в Европе
9.		Хрупкий	10.		Не допускать попадания воды
11.		Не допускать попадания солнечного света	12.		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.08.2021

Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Крышка к штативу для окрашивания стёкол

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SP20-0300,SP20-0400.

2. Назначение

Крышка к штативу для окрашивания стёкол предназначена для защиты патологического образца в штативе для окрашивания стёкол.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	LOT	Код партии
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8		Дата изготовления
3		Производитель	9		Использовать до
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Не допускать попадания воды
5		Хрупкий	11		Внимание
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Сентября,2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Транспортная пробирка LOC

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Транспортная пробирка LOC предназначена для предоставления более стандартизированного и надежного решения для подготовки, транспортировки и хранения биологических образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8	CE	Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения	14	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Транспортная пробирка LOC

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Транспортная пробирка LOC предназначена для предоставления более стандартизированного и надежного решения для подготовки, транспортировки и хранения биологических образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8	CE	Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения	14	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Тампоны MediSWAB

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Model Number

MS301-102, MS302-121, MS303-116, MS304-152, MS305-113, MS306-121

2. Назначение

Тампон MediSWAB предназначен для сбора, транспортировки и хранения клинических образцов.

Среда Стюарта применяется для транспортировки различных патогенных микроорганизмов, например, Neisseria gonorrhoeae, Heamophilus influenzae, Corynebacterium diphteriae, Trichomonas vaginalis, Streptococcus pneumonie, Salmonella sp., Shigella sp. и др.

Среда Эймса применяется для транспортировки таких патогенных микроорганизмов, как Neisseria sp, Heamophilus sp, Corynebacteria, Streptococcus pneumonie, Escherichia coli, Klebsiella pneumonia.

Среда Кэри-Блэйра применяется для транспортировки таких патогенных микроорганизмов, как Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli и др. Рекомендована к использованию для взятия, транспортировки и хранения ректальных и фекальных проб.

3. Symbols

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации
3		Внимание	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Способ применения

Откройте упаковку и приступите к использованию.

5. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.



DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215 Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Июля, 2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Планшеты

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

MP801,MP802,MP803,MP901,MP801,MP804-201,MP804-001,MP805,MP806,MP807,MP904,MP905,MP906,MP907,MP100,MP200,MP110,MP210,MP120,MP220,TC120,TC219,TC220,TC239,TC230,TC319,TC320,TC509,TC510,TC519,TC520,TC521,TC560,TC570,TC700,TC710,TC711,TC209,TC200,TC231,TC208,TC201,TC221,TC309,TC300,TC321,TC539,TC540,TC550,TC003,TC810,TC811,TC820,TC830,TC840,PL110,PL120,PL130,PL140,PL210,PL001,PL002,PL003,PL004,PL005.

2. Назначение

Микропланшет предназначен для содержания небольших объемов клинических образцов, реагентов или других материалов для процедур тестирования, выполняемых лабораторным анализатором.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

#1001, Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Ave. Jiangning Dist. 211100, Nanjing, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Планшеты

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

MP100-001, MP100-016, MP100-006, MP200-001, MP200-016, MP200-006, MP110-001, MP110-016, MP110-006, MP210-001, MP210-016, MP210-006, MP120-001, MP120-016, MP120-006, MP220-001, MP220-016, MP220-006

2. Назначение

Микропланшет предназначен для содержания небольших объемов клинических образцов, реагентов или других материалов для процедур тестирования, выполняемых лабораторным анализатором.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

#1001, Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Ave. Jiangning Dist. 211100, Nanjing, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Планшеты с крышками и без

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

MP801-001, MP801-101, MP901-101, MP802-001, MP802-101, MP902-101, MP803-001, MP803-101, MP803-016, MP803-116, MP803-006, MP803-106, MP903-101, MP903-116, MP903–106, MP801-201, MP802-201, MP804-001, MP805-001, MP806-001, MP807-001, MP904-001, MP905-001, MP906-001, MP907-001

2. Назначение

Микропланшет предназначен для содержания небольших объемов клинических образцов, реагентов или других материалов для процедур тестирования, выполняемых лабораторным анализатором.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

#1001, Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Ave. Jiangning Dist. 211100, Nanjing, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Планшеты, стрипы, крышки для ПЦР

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

TC120-301, TC120-316, TC219-316, TC219-301, TC220-316, TC220-301, TC239-316, TC240-316, TC230-316, TC230-301, TC319-316, TC319-301, TC320-316, TC320-301, TC209-316, TC209-301, TC200-316, TC200-301, TC231-301, TC208-316, TC201-316, TC221-301, TC309-316, TC309-301, TC300-316, TC300-301, TC321-301, CN209-316, CN209-301, CN200-316, CN200-301, CN221-301, CN309-316, CN309-301, CN300-316, CN300-301, CN321-301, PL153-000, PL110-000, PL110-000, PL120-000, PL130-000, PL140-000, PL141-000, PL132-000, PL100-000, PL900-000, PL210-000, PL520-000, PL540-000, TC509-201, TC509-216, TC510-201, TC510-216, TC520-201, TC520-216, TC519-201, TC519-216, TC521-201, TC539-201, TC539-216, TC560-201, TC570-201, TC540-216, TC540-206, TC550-206

2. Назначение

ПЦР-планшеты предназначены для работы с ПЦР-инструментами для полимеразной цепной реакции образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

#1001, Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Ave. Jiangning Dist. 211100, Nanjing, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Дата выпуска:25.11.2021

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Планшеты, стрипы для ПЦР

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

CN219-316, CN219-301, CN220-316, CN220-301, CN319-316, CN319-301, CN320-316, CN320-301, CN509-201, CN509-216, CN510-201, CN510-216, CN540-206, CN540-216, PL153-003, PL153-003, PL110-003, PL120-003, PL130-003, PL140-003, PL141-003, PL132-003, PL100-003, PL900-003, PL210-003, PL520-003, PL540-003

2. Назначение

ПЦР-планшеты предназначены для работы с ПЦР-инструментами для полимеразной цепной реакции образцов.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

#1001, Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Ave. Jiangning Dist. 211100, Nanjing, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Чашка Петри

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

PD550,PD558,PD551,PD552,PD553,PD554,PD555,PD556.

2. Назначение

Чашка Петри предназначена для исследования микроорганизмов и клеточных культур.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации	14		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Штатив к наконечникам для пипеточных дозаторов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Штатив к наконечникам для пипеточных дозаторов предназначен для хранения наконечников для пипеточных дозаторов и для удобного дозирования.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	MD	Медицинское изделие
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	LOT	Код партии
3		Производитель	9		Дата изготовления
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Не допускать попадания воды
5		Хрупкий	11		Внимание
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Контейнер для стула

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно


1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Контейнер для стула предназначен для сбора, переноса и хранения образцов стула.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1.		Медицинское устройство для диагностики in vitro	2.		Сертификация CE
3.		Обратитесь к инструкции перед использованием	4.		Дата изготовления
5.		Код партии	6.		Использовать до
7.		Производитель	8.		Уполномоченный представитель в Европе
9.		Хрупкий	10.		Не допускать попадания воды
11.		Не допускать попадания солнечного света	12.		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021
Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Крышки/Пробки/вставки в пробирки

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно


1. Номер модели

TS01,TS02,TS03,TS04,TS05,TS06,TS07,TS08,TS11,CD2001,CD2002,M100.

2. Назначение

Крышка/пробка/вставка для пробирок предназначены для герметизации верхней части пробирки или резервуара для реагентов, чтобы предотвратить проливание содержимого во время транспортировки или обработки. Вставка в крышку криопробирок предназначена для легкой и быстрой идентификации групп пробирок по цвету.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1		Медицинское изделие	8		Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3		Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11		Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Тампоны TipSWAB

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Тампоны TipSWAB предназначены для кратковременного взятия образцов с поверхности тела или из отверстий тела или для очистки кожи и поверхности устройства.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации
3		Внимание	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Способ применения

Откройте упаковку и приступите к использованию.

5. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Июля, 2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Тампоны TubSWAB

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку.

2. Назначение

Тампоны TubSWAB предназначен для кратковременного взятия проб с поверхности тела или в отверстиях тела и транспортировки.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	STERILE	Медицинское изделие, прошедшее процесс стерилизации
3		Внимание	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Способ применения

Откройте упаковку и приступите к использованию.

5. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска: 25 Июля, 2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Контейнер для мочи

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

См. этикетку

2. Назначение

Контейнер для мочи предназначен для сбора, переноса и хранения образцов мочи.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1.	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	2.	CE	Сертификация CE
3.		Обратитесь к инструкции перед использованием	4.		Дата изготовления
5.	LOT	Код партии	6.		Использовать до
7.		Производитель	8.	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
9.		Хрупкий	10.		Не допускать попадания воды
11.		Не допускать попадания солнечного света	12.		Внимание

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021

Версия A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust

DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Пробирка для мочи

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

TP52-0000, TP53-0000, TP51-0002, TP54-0002, TP54-0002.

2. Назначение

Пробирка для мочи предназначена для сбора, хранения и переноса образцов мочи.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8	CE	Сертификация CE
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9		Дата изготовления
3	LOT	Код партии	10		Использовать до
4		Производитель	11	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
5		Хрупкий	12		Не допускать попадания воды
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Внимание
7		Медицинское изделие однократного применения	14	NON STERILE	Не стерильное медицинское изделие

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Повторное использование может повлиять на результаты диагностику!
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd
CE

Инструкция по применению

Система для окрашивания стёкол

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SS112-000, SS103-000, SS010-000, SS020-000

2. Назначение

Система для окрашивания стёкол предназначена для ручного окрашивания предметных стекол.

Состоит из стального основания, резервуара для окрашивания стекол и штатива

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	CE	Сертификация CE	7	MD	Медицинское изделие
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	8	LOT	Код партии
3		Производитель	9		Дата изготовления
4	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе	10		Не допускать попадания воды
5		Хрупкий	11		Внимание
6		Не допускать попадания солнечного света			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd

1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China

Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215

Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd

Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.11.2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DiaTrust
DiaTrust Medical Co., Ltd

CE

Инструкция по применению

Чашка для образцов

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и применяйте правильно

1. Номер модели

SC0701-00, SC0702-00, SC0703-00, SC0707-00, SC0801-00, SC0802-00, SC0603-01, SC0603-02, SC1201-00, SC1202-00, SC1203-00, SC1204, SC0901-00, SC0902-00, SC0904-00, SC0905-00, SC0906-00, SC0907-00, SC0908-00, SC0903-00, SC1101-00, SC1102-00, SC1105-00, SC1103-00, SC1104-00, SC0501-00, SC1301-00, SC1301-02, SC1302-00, SC2001-00, SC2002-00.

2. Назначение

Чашка для образцов предназначена для хранения реагентов, буферов, биологических образцов или других материалов при подготовке к процедурам диагностики in vitro.

3. Символы

No.	Символ	Описание	No.	Символ	Описание
1	IVD	Медицинское устройство для диагностики in vitro	8		Медицинское изделие однократного применения
2		Обратитесь к инструкции перед использованием	9	CE	Сертификация CE
3	LOT	Код партии	10		Дата изготовления
4		Производитель	11		Использовать до
5		Хрупкий	12	EC REP	Уполномоченный представитель в Европе
6		Не допускать попадания солнечного света	13		Не допускать попадания воды
7		Внимание			

4. Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с правилами медицинского учреждения или государственными и местными правилами обращения с биологически опасными материалами.

⚠ Внимание!

- Только для профессионального использования
- Будьте предельно внимательны во время работы, чтобы избежать возможных травм. В случае получения травмы немедленно обратитесь за медицинской помощью.

DiaTrust Medical Co., Ltd
1001 Jingfeng Plaza, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing City, 211100, P.R. China
Tel:+86 025 52733215 Fax：+86 025-52733215
Web site：www.diatrust.cn

EC REP Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road,Derry,BT48 8SE, Northern Ireland,UK

Дата выпуска:25.09.2021
Версия. A/0

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru