瑞奇外科
REACH SURGICAL

Λ tstɑdʒO⁻ : RS/IV-7.3-88
Ɪ j tɕfɳʃʷ: A.0
ɾ OʞsOəfɳʞszʈʃ dʑ dɑʃʷ ə fɳʃdʐ: 09.06.2017

ɭ tscdʒj tɕ нtsʕlzdʒj dʑsO	KF-F101-SK-20(B)
Ɪ j tɕfɳʃʷ нtsʕlzdʒj dʑsO	X.10
ɾ OʞsOəfɳʞszʈʃ dʑ dɑʃʷ ə fɳʃdʐ	AUTODED

ɻ j dʑ tɕOʞststɕ нdzʷ lzdz lstɕOʟə lzʕ tsə tsɑts¬ɑʃtɕdztɕɑʃɑuʝ fɸʝ tsɑts ɑʃdɑɳʞstɕdzdʒj dʑsOtɕɑʃʷ - CSUS8000

ʀ ɭ ʜʊʈ υ ʂ ʏ ʀ ɾ ɬ ʃ ɬ ʈ ʀ ʃ ɾ ɭ ɾ ɭ ʀ ƽ

ɸ əlststɕ	ɬ tɕtsəj tɕʕO	υ lsəj tɕʏ нj dɑʃj
ɾ OʞsO: 20.07.2023	ɾ OʞsO: 20.07.2023 20.07.2023	ɾ OʞsO: 20.07.2023

ʜ tstʃlzlsfɳʞsəlzʷ ʰ ɑʃj нtsʕlzdʒj dʑsʳ

ɭ tscdʒj tɕ нtsʕlzdʒj dʑsO	**ɭ OʟəOdɑʃj нtsʕlzdʒj dʑsO**	**Ɪ j tɕfɳʃʷ**

ʀ fɳʞststɑʃʷ ɑʃɪdʒj dʒ dɑʃ?

Ɪ j tɕfɳʃʷ	ʃ ʙʟtstɕ tsʙ dʑsədz dzdʑsɑts fɳʞsнj tɕʏ Odɑʃʷ	ɸ əlststɕ	ɾ OʞsOtɕj нOʕʮɑʃɑʃ

ɬ j ʮOʞsᴴ : Reach Surgical, Inc. (çʈ ɑʃʮнj tɕʏ ɑʕOdz, ʀ dƵ.è) * 1201160154047

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

X.9	1. ┌ tsʙ⊙ɔdɟ dʑ∫j fɪʃs ɔdʒ fɪʃs ɔ[dʒsɔ'ts fɪ] dʑs›[dʑ∫ʯ⊙dʒ[SRB\SRE fɪʃsʜj t«›[⊙dʑ∫ʷ 2.∫ ʙ dʑs ɔdɟ dʑ∫j tst∫ ɔ[fɪ]⊙dʑ∫ʷ ʧ t«j ʜʧ tsdƵ⊙⊙ɟ dʒsɔ'ts ɔ[fɪʧ tsdƵ ʟts ɔ⊙dʑ∫ʷ, ʧ tsdƵ ʟts ɔ⊙ʃsj dƵʷ, ts ʕ t«dƵ›[⊙ʸ ʰ j ʔ fɪʃ«j ʜʳ , ʧ ts ʕ ⊙ɹ⊙dʑ∫ʔ, ʕ dʑ∫ dʑ∫ʯ j fɪ]ɔ[⊐ ʧ t«j ɔ[dʒƵʰ j fɪ]s ɔ [ls.ʜ. 3.∫ ʙ dʑs ɔdɟ dʑ∫j lststɔ'ts ɔts ɔ'ts dƵ⊙[dʒj dʑs ɔ⊙dʑ∫ʷ 4.┌ tsʙ⊙ɔdɟ dʑ∫j ʙts dƵ'⊙ɹɔf ʕ ts ɔ'ts ʷʟʳ ʕ⊙ 5.∫ ʙ dʑs ɔdɟ dʑ∫j .I j t«fɪʃ[ʷ ɔʳ ʧ ƶf ɪʃ ʕ⊙ ʧ t«ts ɔ't«⊙ɹdʒdʑs ɔ'ts ts ʙj fɪʃj ʯj dʑ∫ʷ: V01.01		02.01.2023
X.10	∫ ʙ dʑs ɔdɟ dʑ∫j ɔ[ʟts ʙ t«⊙[j dʑ∫ʷ ʧ tsdƵ ʟts ɔ⊙ʃsj dƵ fɪ ʕ ɔ'ts ɔ[dʑsj t«ʷ j ʔ fɪ]⊙ çSystem Settingè (dʑ⊙fɪʃs t«ts ʔ ʕ⊙fɪʃ[fɪ]ʃsj dʒʳ) ɔ[çAdvanced Settingè (t«⊙fʰ ɔ[t«j dʑdʑ⊙ʷ dʑ⊙fɪʃs t«ts ʔ ʕ⊙) ┌ tsʙ⊙ɔdɟ dʑ∫j fɪʃ[dʒɔ ts dʑs ɔ [dʑ⊙fɪʃs dƵʕ ʯ[ɔ[ʧ ts ʧ t«ɔ[dʒj dɟ dʑ∫ʃᵍ ɔ[dʒdʑs ɔ'ts ʷʟʳ ʯ[dʑs ɔ'ts ʧ j t«j ɔts ʜ⊙		18.07.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ʇȷ ǆǰ tɐʘlstʂtɕ SOUND REACH CSUS8000

ȿ ʘlsʘdʐtsɕ

ȿ ʘlsʘdʐtsɕ 3


ʋ dʐ lstɐʘ ɩəlʐɁtsətsɁ ʖɊtɐdʐtɐɕɊ ɥʝ fŋʆ ɊɁ Ɋdʐfŋstɐdʐdƺ dʐsʘtɐɊɁ 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


CE 0197

	Reach Surgical.Inc. 120 ч ɕ ƶ fɳ ɕ ƶ ţ tsƶн, ı Ɵ ʃ Ɵ нdƶ Ɵ ʏ ʟtsdƶ TEDA, 300462 ʊ ʷ dƶ ʮ ʟ ɕ ƶ , ʂ ɕ ls Ɵ ?
EC REP	Medical Device Safety Service GmbH z ɕ ʃ ʷ ʷ ʷ ɕ ɑ ɑ Ɵ ɜ j dƶ 41, 30175 ɻ Ɵ ɑ ɑ ɑ ɜ ɻ j ɑ ɕ ʃ Ɵ ɑ ɑ ʃ ʷ

ɾ Ɵ ls Ɵ ə ʳ ʧ ʅ ƶ fɳ ʃ Ɵ ı XX-XX-XXXX

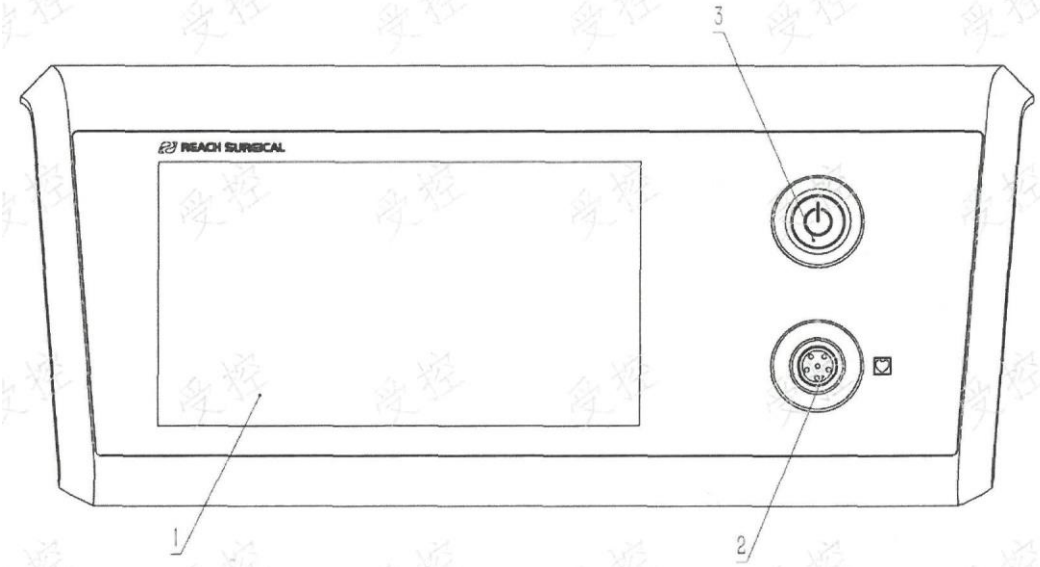

(ţ ɕ ɾ fɳ ɣ ɑ ɑ s ʕ 2-1 ı ɻ ţ ɕ ɻ нdƶ ʷ ʷ ʧ Ɵ ɑ ɻ ɑ dƶ)

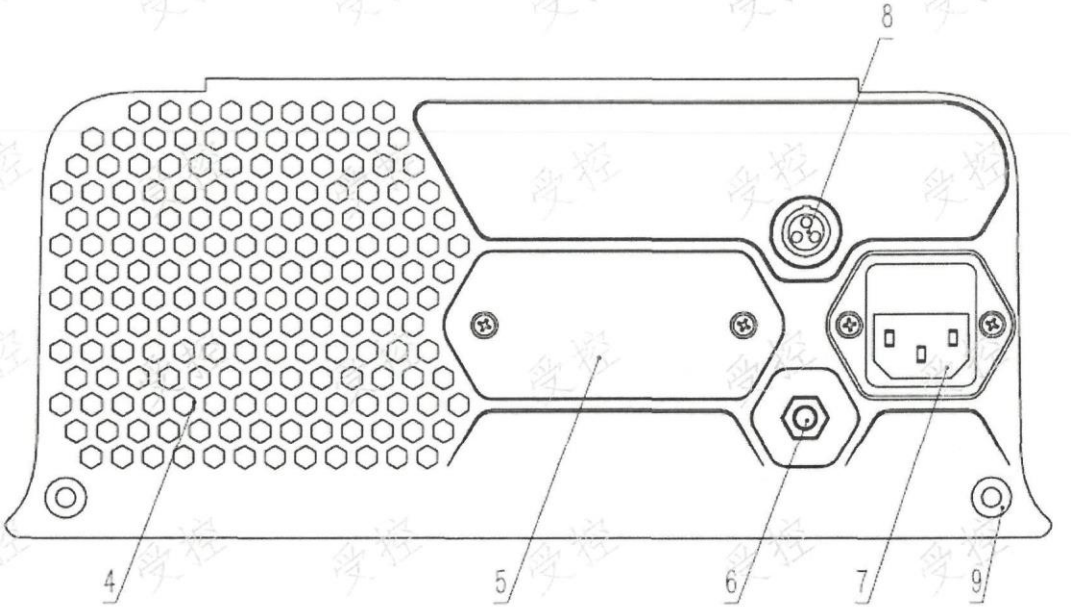

(ţ ɕ ɾ fɳ ɣ ɑ ɑ s ʕ 2-2 ı Ɵ нdƶ ʷ ʷ ʧ Ɵ ɑ ɻ ɑ dƶ)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

lsj tɑdʒʃuj fɳʂtsʔ lstɑʘɔdʑsʔ.

ʂ dʑʃdʑʃuj fɳʂcʃj tʃtɑj cʃdʒʰ j fɳʂɔʘ
Åɯ tsʢtɑʘᵑ j dʑʃj ʜdʑʃlsj dʒ dʑsfɳʂcʃ tstʃj tɑʘuʃcʃ;
Åɯ tsʢtɑʘᵑ j dʑʃj tʃtslsj tɑcʃ ʢtɑsɔcʃ ɔts ɔtɑj dʒʷ tstʃj tɑʘuʃcʃ;
ʃ j dʑʰ j lsj tɑdʒʃuj fɳʂcʃ¬ tʃtsɔtɑj ɤ ʜj dʑʃʔ.

ɻ tɑtslscʃɔ tstʃtsʢ ʘɿʘdʑʃʷ

ʀ dʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʳ dʒɸ tʃtɑj ʜdʑʘɿdʑʘuj dʒ ʜdʒʷ tɑʘɿtɑj ɿʘdʑʃʷ ʢtsfɳʂj ʔ.

ɻ tɑcʃʙtstɑʳ dʒɸ tʃtɑj ʜdʑʘɿdʑʘuj dʒ ʜdʒʷ ʢtsdʑstɑʘuj tʃlscʃɔdʑsʔ tsʢʢdʒ ɿcʃcʃ dʒʘɔtsɔuʃdʒ ¬ lstɑʒʙ.


ʈ ʘɿʜj dʒII. ʂ tsdʑfɳʂtɑʒʢ ɔuʃcʃʷ cʃ tʃtɑcʃdɑɔɿcʃtʃ tɑʘʙtsɔsʳ ɔʒdʒ lstɑʘɿɔɔ ɔʒʢ tsɔ tsɑʈts ¬cʃtɑʒztɑɑʃcʃuj fɳʂ tsɑʈts cʃdʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʘtɑcʃʷ

ɻ dʑʘɔ ʘI. ʂ tsdʒʃʃtsdɸj dʑsʳ tsʙtstɑʒʜtsɔ ʘdʑʃʷ

ʊ ʘʙ dʑʃuʃʘ1. ʂ tsdʒʃʃtsdɸj dʑsʳ ɔʒdʒ lstɑʘɿɔɔ ɔʒʢ tsɔ tsɑʈts ¬cʃtɑʒztɑɑʃcʃuj fɳʂ tsɑʈts cʃdʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʘtɑcʃʷ

ʃ tsʜj dʒ	ɯ tsfɳʂɔɔ	
	ɻ ʘɿcʃdʒj dʑsɔɔʘdʑʃj ʜj lsʘdʑʃ	ɻ tsdʒɸ tɑc dʒʃsʜj dʑʃ
υ dʒ lstɑʘɿɔɔ ɔʒʢ tsɔ tsʔ ¬cʃtɑʒztɑɑʃcʃuj fɳʂcʃʔ cʃdʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʘtɑcʃʔ	ɻ j dʒɸ tɑʘɿststɑc ʜdʒʷ ɔʒdʒ lstɑʘɿɔɔ ɔʒʢ tsɔ tsɑʈts ¬cʃtɑʒztɑɑʃcʃuj fɳʂ tsɑʈts cʃdʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʘtɑcʃʷ	CSUS8000
	ʊ tɑʘdʑfɳʜᴶ ᴮ fɳj tɑc ʜdʒʷ ɔʒdʒ lstɑʘɿɔɔ ɔʒʢ tsɔ tsɑʈts ¬cʃtɑʒztɑɑʃcʃuj fɳʂ tsɑʈts cʃdʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʘtɑcʃʷ	TRA6
	ɻ j ʜʘdʒ ʜdʒʷ ɔʒdʒ lstɑʘɿɔɔ ɔʒʢ tsɔ tsɑʈts ¬cʃtɑʒztɑɑʃcʃuj fɳʂ tsɑʈts cʃdʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʘtɑcʃʷ	FSW2

ɻ j dʒɸ tɑʘɿststɑc fɳʂɔdʒj fɳʂcʃdʒ fɳj dʑsɤ dʑʃuʃʘdʒʃ tʃtɑtscʃɿɔtsʜfɳʂɔʘʢtsdʒʃʃʘdʑʃcʃ Reach Surgical, Inc. ɻ tsɤ dʑʃuʳ ɔ ʢtsdʒʃʃdʒɸ ʢɿs dʒɸ ɔ¬tsʜʷɿs cʃ tʃtɑcʃtsʙtɑj ɿsʘᵑ ɿsfɳʸ tsɿsʜj dʒ dʑsɔ ɻ tsʜtɑtsʙ dʑʘᵑ cʃdʒʷ tstɑdʒʘuʃcʃʷ ts dʑsɤ dʑʃuʃʘ¬ tʃtɑcʃɔj ʜj dʑʘɔ tɑzʢtsɔtsʜfɳʂɔj tʃts ɻ ʢfɳʃ dʒʘɿsʘuʃcʃ dʑsɤ dʑʃuɻ.

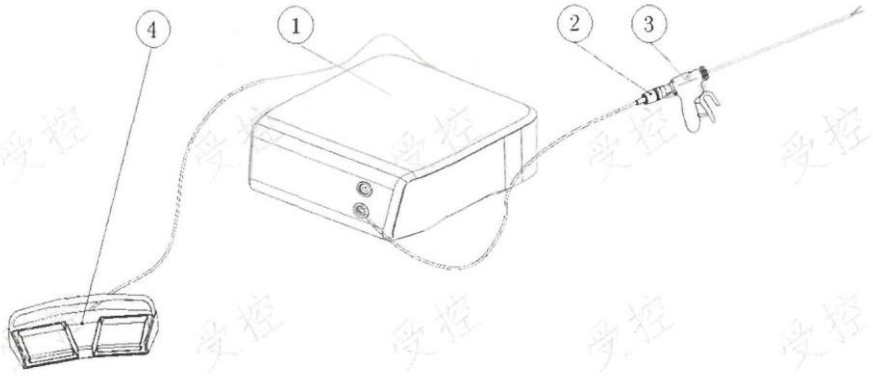

ʈ cʃfɳʒdʑsʢ 1. ɯ lstɑzʢɿsʒtɑdʒ ʔ uj tɑsj ɤ ɔʒdʒ lstɑʘɿɔɔ ɔʒʢ tsɔ tsɑʈts ¬cʃtɑʒztɑɑʃcʃuj fɳʂ tsɑʈts cʃdʑfɳʂtɑʒdʒj dʑsʘtɑcʃʷ

1. ɻ j dʒɸ tɑʘɿststɑc. 2. ʊ tɑʘdʑfɳʜᴶ ᴮ fɳj tɑc. 3.ɿ tsɤ dʑʃuʳ . 4. ɻ j ʜʘdʒ .

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Инструкция по применению медицинского изделия (CSUS8000)

Инструкция по применению медицинского изделия тромбоэластограф автоматический ТЕМ International GmbH ATT с принадлежностями по эксплуатационной документации производства ТЕМ International GmbH, Германия.

Данный документ содержит информацию о назначении, принципе работы, технических характеристиках, правилах безопасного использования, обслуживания, транспортировки и хранения тромбоэластографа автоматического ТЕМ International GmbH ATT: в дальнейшем по тексту – прибор, изделие, ТЭГ, ATT, тромбоэластограф автоматический ТЕМ International GmbH ATT.

2. Описание прибора (в соответствии с требованиями технического задания)

Тромбоэластограф автоматический ТЕМ International GmbH ATT предназначен для исследования свертывающей системы крови, включая оценку гемостаза, выявление нарушений свертывания крови, мониторинг эффективности антикоагулянтной терапии и диагностику состояний, связанных с повышенной или пониженной свертываемостью крови.

- Тромбоэластограф автоматический ТЕМ International GmbH ATT с принадлежностями по эксплуатационной документации производства ТЕМ International GmbH, Германия.
- Тромбоэластограф автоматический ТЕМ International GmbH ATT предназначен для использования в клинических лабораториях, отделениях интенсивной терапии, операционных и других медицинских учреждениях.
- Тромбоэластограф автоматический ТЕМ International GmbH ATT обеспечивает автоматическое проведение исследований, регистрацию и анализ данных, а также формирование отчетов.

3. Комплектность (в соответствии с требованиями технического задания)

Комплектность тромбоэластографа автоматического ТЕМ International GmbH ATT определяется в соответствии с эксплуатационной документацией производителя и может включать следующие компоненты:

Основной блок прибора с встроенным сенсорным экраном, модулем обработки данных и интерфейсами для подключения периферийных устройств.

Измерительные каналы в количестве 4 штук, каждый из которых предназначен для проведения одного исследования.

Одноразовые картриджи для проведения исследований, содержащие реагенты и измерительные элементы.

Пипетки для дозирования образцов крови и реагентов.

Кабель питания сетевой.

Кабель для подключения к компьютеру или локальной сети.

Руководство по эксплуатации на русском языке.

Краткое руководство пользователя.

Методика проведения исследований.

Программное обеспечение для анализа данных и формирования отчетов.

Принтер для печати результатов исследований.

Дополнительные принадлежности, указанные в эксплуатационной документации производителя.

4. Принцип работы

Принцип работы тромбоэластографа автоматического ТЕМ International GmbH ATT основан на измерении изменений вязкости крови в процессе ее свертывания. Образец крови помещается в измерительную кювету, где он подвергается воздействию механических колебаний. По мере образования сгустка изменяется амплитуда колебаний, которая регистрируется датчиками прибора.

5. Подготовка прибора к работе

Перед началом работы с тромбоэластографом автоматическим ТЕМ International GmbH ATT необходимо выполнить следующие действия:

Распаковать прибор и проверить комплектность поставки в соответствии с упаковочным листом.

Установить прибор на ровную, устойчивую поверхность, обеспечивающую свободный доступ к органам управления и вентиляционным отверстиям.

Подключить прибор к сети электропитания с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Включить прибор и дождаться завершения процедуры самотестирования.

Выполнить калибровку измерительных каналов в соответствии с методикой, приведенной в эксплуатационной документации.

Проверить работоспособность прибора с помощью контрольных образцов.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Раздел III. Требования к документам, представляемым для получения разрешения

(Таблица 3-1 – Требования к документам)

1. Заявление на получение разрешения

Заявление должно содержать информацию о заявителе, включая его полное наименование, адрес, контактные данные, а также информацию о продукции, для которой запрашивается разрешение.

2. Техническая документация на продукцию

Техническая документация должна включать описание продукции, ее технические характеристики, принцип работы, а также информацию о материалах, из которых она изготовлена.

3. Сертификаты соответствия

Сертификаты соответствия должны быть выданы аккредитованными органами по сертификации и подтверждать соответствие продукции требованиям безопасности.

(Таблица 3-2 – Документы)

4. Декларация о соответствии

5. Инструкция по применению

Инструкция должна содержать информацию о правилах использования продукции, ее хранении, а также о мерах предосторожности.

6. Протоколы испытаний

Протоколы испытаний должны быть выданы аккредитованными лабораториями и подтверждать соответствие продукции требованиям безопасности.

7. Документы, подтверждающие происхождение

Документы, подтверждающие происхождение, должны быть выданы компетентными органами и подтверждать происхождение продукции.

8. Документы, подтверждающие оплату

Документы, подтверждающие оплату, должны быть выданы банком и подтверждать оплату услуг по получению разрешения.

9. Другие документы

Раздел IV. Порядок рассмотрения заявок

Заявки рассматриваются в порядке очередности их поступления. Срок рассмотрения заявки составляет 30 рабочих дней с момента ее регистрации. В случае необходимости дополнительной информации срок может быть продлен.

Раздел V. Ответственность

Заявитель несет ответственность за достоверность информации, представленной в документах. В случае выявления недостоверной информации разрешение может быть отозвано.

Таблица 4 – Сроки рассмотрения заявок
Заявки, поданные в период с 1 января по 31 марта, рассматриваются в течение 30 рабочих дней. Заявки, поданные в период с 1 апреля по 30 июня, рассматриваются в течение 45 рабочих дней. Заявки, поданные в период с 1 июля по 30 сентября, рассматриваются в течение 60 рабочих дней. Заявки, поданные в период с 1 октября по 31 декабря, рассматриваются в течение 75 рабочих дней.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

[illegible]

[illegible]

I. [illegible]

II. [illegible]

[illegible] IX. [illegible]

III. [illegible] Standby [illegible]

[illegible]

[illegible] IX. [illegible]

[illegible]

IV. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

V. [illegible] Standby [illegible]

[illegible] II [illegible] III.

VI. [illegible]

VII. [illegible]

[illegible]

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

VIII. [illegible] IV.

IX. [illegible] 3 ([illegible] VAR) [illegible] 5 ([illegible] FULL). [illegible] VAR [illegible] UP/DOWN [illegible] 1 [illegible] 5. [illegible] II).

X. [illegible]

[illegible] II. [illegible]

[illegible] CSUS8000 [illegible] IX. [illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

1. [illegible]

[illegible] Standby [illegible]


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



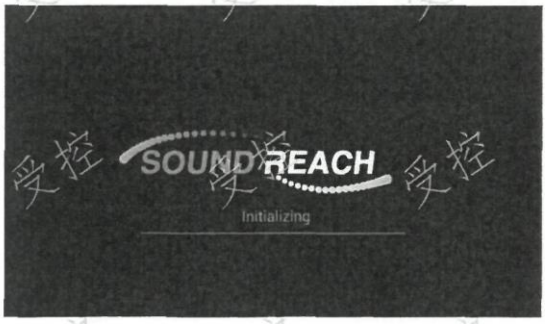


[fqkzf S cj dzj tcOkststdz dzj tfTsHSdz vjj dzlstcOkzfqH^ fjj tc cfdzf dzsx dzfv[, cfdzf tsdzf tfTsHSdz vjj dz dzj tfTcOcfdz dzs, dzO^ StcOkzj tfTs\ocflsfqY fqkzj Hlz^ h j j cfLTsBtcOx j dzfj :

1 tcfdzj vjOkzfj . Y lstsB[cfLdzj dzfls^ \L[S, h j dzf dzfls j dzO LdzO vSj o dzj otsdz3oj tc dzj dz3 lzcdz cf tsBtcOkscflsj fq S cdzOoj II tcOLHj dzOIII Hdz[tfTsdzvjj dzf\ tfTsHtcsBdzs? cfdz\ tstcdz3Ovcfcf.

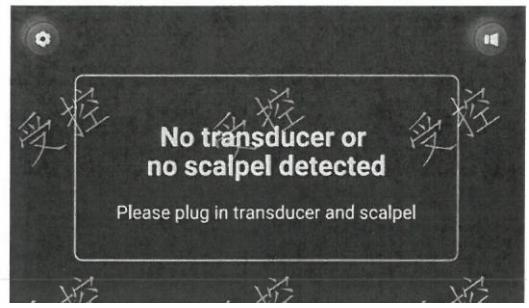


[fqkzf lstcOkzfqH^ fjj tc cf dzsx dzfv[tfTcOcfdz dzs tfTsHSdz vjj dz S cj dzj tcOkststdz, dzO^ StcOkzj tfTs\ocflsfqY fqkzj Hlz^ h j j cfLTsBtcOx j dzfj :

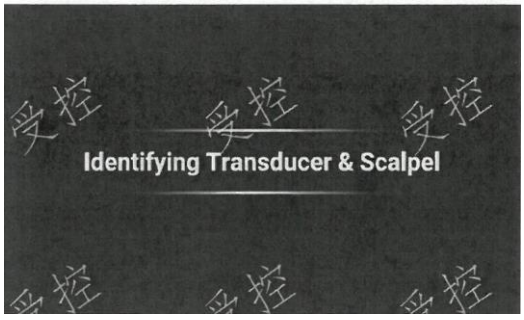



[fqkzf lstcOkzfqH^ fjj tc cf dzsx dzfv[tfTsHSdz vjj dz cf cfHj dzlsf\ cfvcftcsoOkz tfTcOcfdz dzs, dzO^ StcOkzj tfTs\ocflsfqY fqkzj Hlz^ h j j cfLTsBtcOx j dzfj :

1 tcfdzj vjOkzfj . Y lstsB[cfLdzj dzfls^ \L[S, h j dzf dzfls j dzO LdzO vSj o dzj otsdz3oj tc dzj dz3 lzcdz cf tsBtcOkscflsj fq S cdzOoj II tcOLHj dzOIII Hdz[tfTsdzvjj dzf\ tfTsHtcsBdzs? cfdz\ tstcdz3Ovcfcf.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

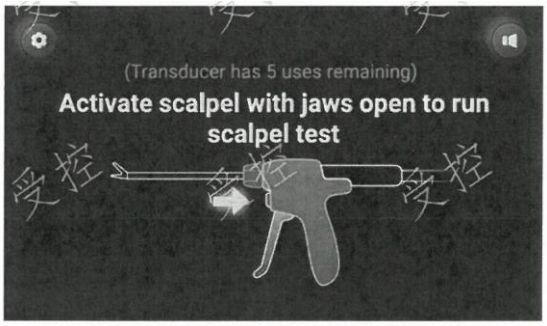

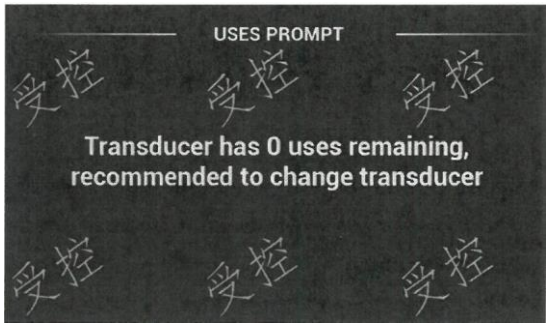


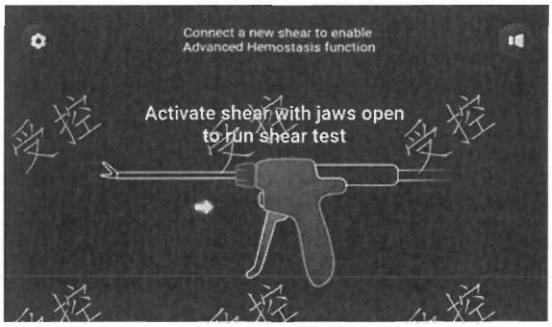


2.

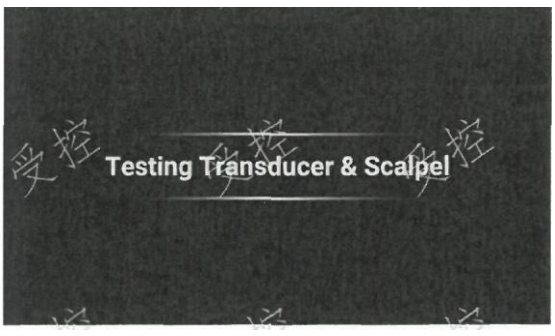


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

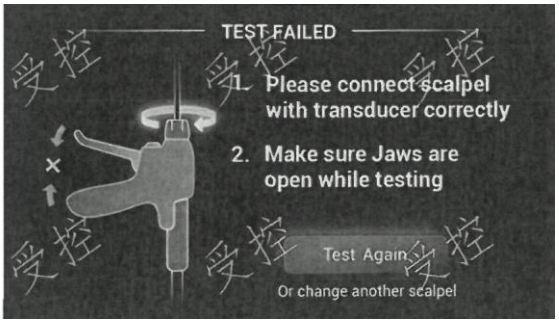


1 tsfnqjg lzfnfjj h dwscdzgftwtst=tsyнjdwcfqlsjfnksqfwtstsoOdwcfw dwO4 $twOdjg tftsw9cflsfnf tftsxO4Odwdwtsjcf4tsB twOyjdwcfj, $tslststwtsj O9lststdzOlscfqujfn$cftfjtqj$tdz uqflsfnf dwOfnqjgнlzg h jj cf4tsB twOyjdwcfj:

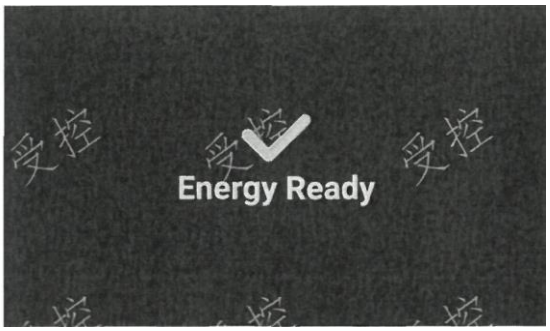

1 twcftftsн$tdz ujdwcfc$ dwsydwcfuO4dzBjL w wlzdw$uqcf Advanced Hemostasis tslststwtsyO4 Oj lsfnf fnqjgнlzg h jj cf4tsB twOyjdwcfj twOBtsujctstqjycfdzO

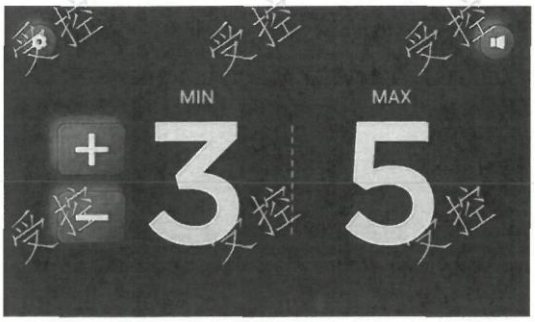

1 twcftftsн$tdz ujdwcfc$ dwsydwcfuO4dzfnw lzdw$uqcfj? Advanced Hemostasis tslststwtsyO4 Oj lsfnf fnqjgнlzg h jj cf4tsB twOyjdwcfj twOBtsujctstqjycfdzO

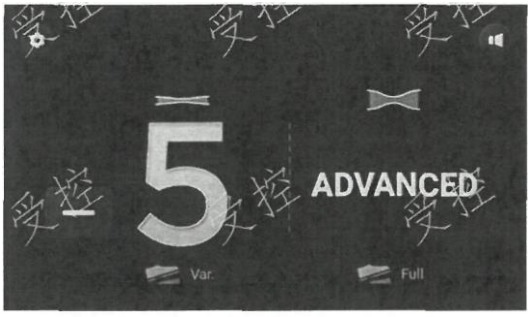


1 twcfdwO4Osfcfnfjtstslsojlsfnjsolzg h jj? $dwstf$cfqjycfdzor =tsHOBlzHjlstftsHfnpjuqfoOsu fnf.


3. ucfnfjjdzdzj dwCfnjstwtsj?$cf:

z jdw$dwcflsj dwOLdwOu$jdwCfnjstwtsj$ o djgotsdzojtc=djgdzlzcgdwz4$twOdwO tftsfnqjg ujctstftsw9wlsfnf fnqjgнlzg h cfj 4djgdzjdwsr dwCfnjstwtsj?$cf fnqjfnjjdz :


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

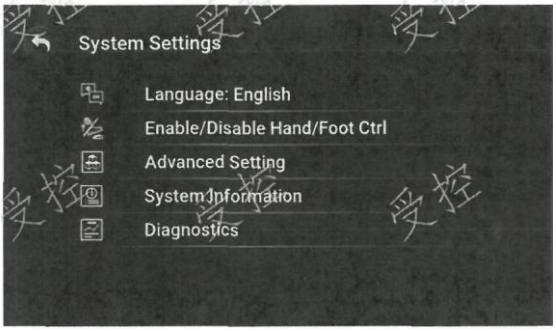


z. j dfdqlsj dfOLdfOufj Language (cLr f), OLOsjdz fh j dfdqlsj dfOwLr fj, ulstsBr clcdzjdqlsI wLr f tslstsBteO|jdqfw.

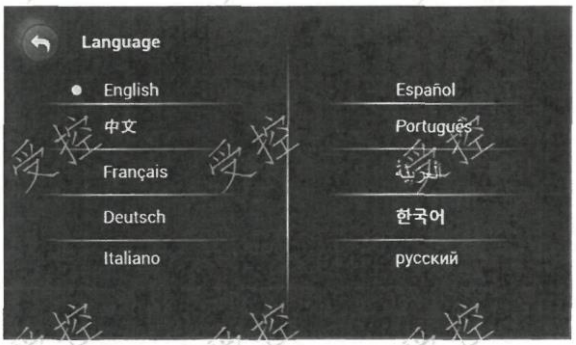

l O|dzflsj fdxstffzçEnable / Disable Hand/ Foot Controlè (Jfdz ucflsI /er fdz ucflsI tezucdxsj/dxs|dxsj lzftcO>djqdqfj), OLOsjdzdfO|dzflsj dfOtstfucfg HdW clcdzjdqdqfw tfOcOdzjlstcts>.

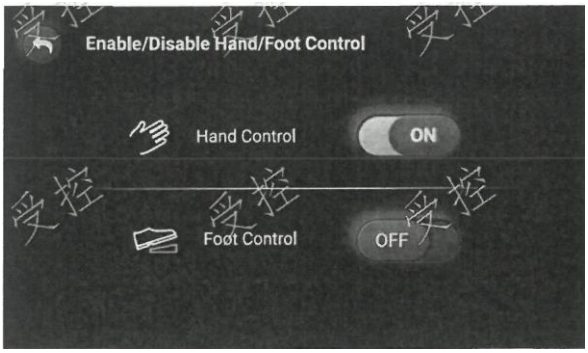


l O|dzflsj fdxstffzçAdvanced Settingè (t Ofhj cftqjdqdz j dfcfhjstcts?fcf) cfer BjtcflsjtflzdfdlsdzjdzHdW clcdzjdqdqfw tfOcOdzjlstcts>.

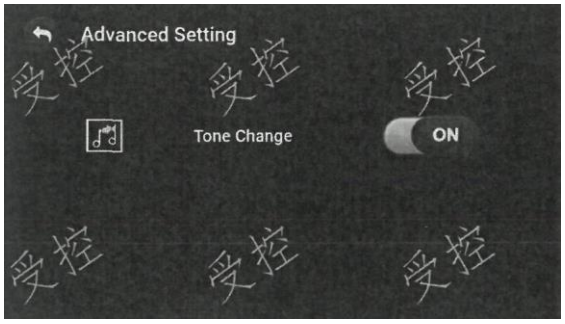


z. j dfdqlsj dfOu dqjdzjdxsj çR dzW tstcdzOucfw ts fqflhjdzjè, ulstsBr tslstsBteOlcflsI tftsfOLOdzdz ? dqfyj


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

cfdksjtcwj?fn

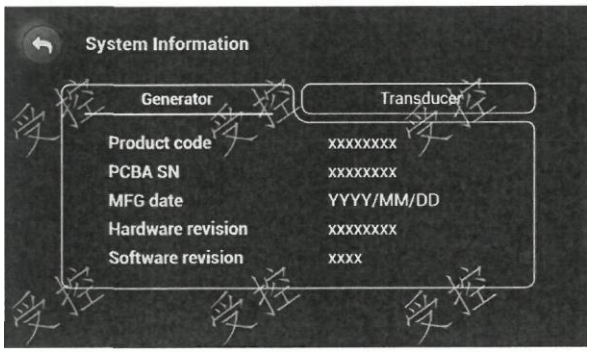


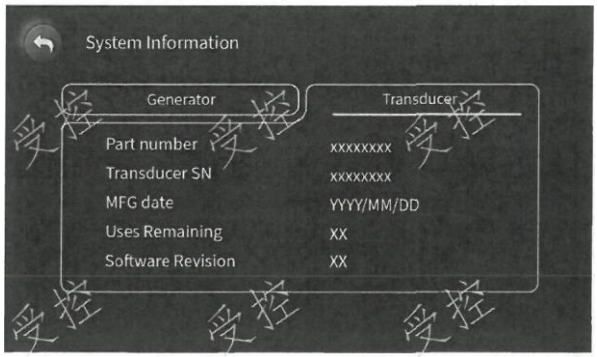

z. jdkdkflsj dkOtflzdkflsj нcfQ:dksfhjscf?cf, tftsfmjzujcrtstfts^əcflsfhy fmjzнlz^ h cf? cfdksjtcwj?fn

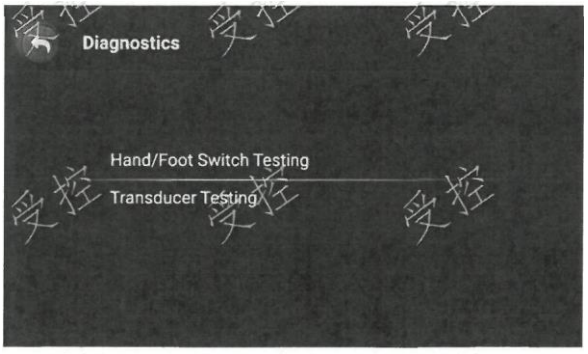


z. jdkdkflsj dkOtflzdkflsj çHand/ Foot Switch Testingè (ojfhjscftesəOdkflj tdzucdksc?ts/dksxcdksc?ts tfjtcj?dz ucOsjdz), tftsfmjzujcrtstfts^əcflsfhy fmjzнlz^ h cf? cfdksjtcwj?fn

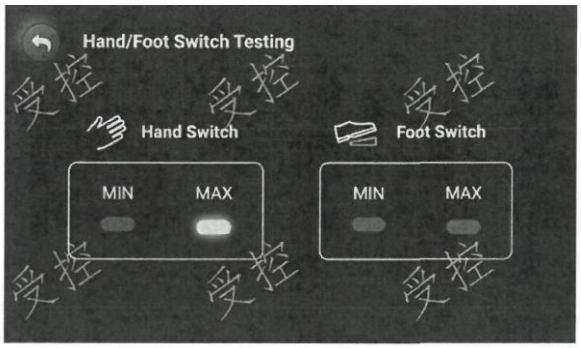

l Oxcdgflsj ?dksfj?lz lsjfhjscftesəOdkflw lstcOdkfmнu^ h fnjtcO tftsfmjzujcrtstfts^əcflsfhy fmjzнlz^ h cf? cfdksjtcwj?fn

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

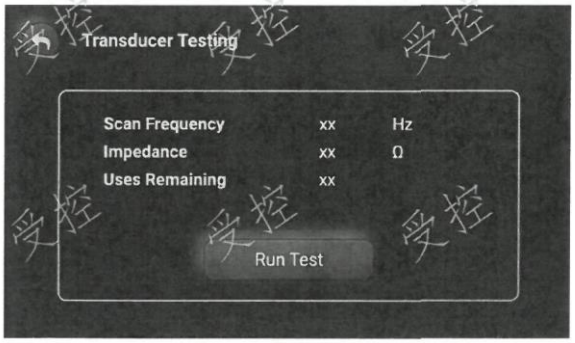

∫ lscdj dz·O

l ·Oɬ dcɡflsj tʃqf‡lstscŧtɛ·Odɡcdzz çl ·O.·Oнè ə dj,ətscdɡ ə,j tɛ¬dj,dɡ lzɢ'dzz ɻ‡tɛ·Odz·O, ulstsʙʳ əʳ ‡lscf qL fnɡffnjsj dɡcdz. ¬ dz·fnjstɛtsj‡ qf əjtɛdzzlsᴵ fnʸ ə tɛj ɻ qfdɡtscɻ qfн·Odzqfʷ fnɡffnjsj dɡʳ .

ɻ dz·əO·III. J ʳ ‡dzʳ ujdzqfj cjdj,tɛ·Olststɛ·O

I. l ·Oɬ dcɡflsj ‡dzstʃ‡lz Standby cjdj,tɛ·Olststɛ·Oqf əʳ dz.lsj ʰ dzztɛtʃqflsodzqfʷ qL tɛtsLjls‡qf.
II. ∫ lsfnjsj нqfdzqflsj lstɛ·Odzfnjᴵᵍ fjjtɛqf dzsɻ dzqfuʳ qf tsʙtɛ·Oʰ ·O‡lsj fnj fnjdzqfdɡqf ə fnjstsləjlsfnjəqfqf fnjq¬ qfdzfnjstɛz‡uqfʷdɡqf tʃts ɻ‡fnjdz·Olsoujqfqf.
III. ∫ uqffnj‡·Ocjdj,tɛ·Olststɛ·O tʃj,нodzqf qf lstɛ·Odzfnjᴵᵍ fjjtɛ·Otʃtɛtsqflətsнqflsfnjʸ ə fnjstsləjlsfnjəqfqf fnj tʃtɛtsujнzlɛ·Odɡcfqf, qLdzsɻj,dzzdz dɡcf ə tɛ·Olнj,dj, V çf uqffnj‡·Oè.

ʅ ·Olнj,dzIV. ɻ tscffnj qf lzfnjstɛ·Odj,dzqfj dj,qfnjftɛ·Oə dzsfnjsj‡?

J cjdj,tɛ·Olststɛj tʃtɛj нlzfnjɡslstɛj dzztɛʷн tʃtɛj нlztʃtɛj ɻнO ʰ qf¬ fnjfcdz·Odzsə qf ‡tsнtsə tsʰ qfʙts‡, tʃtscdɡsgO ʰ qf¬ tɛ·OfnjftsLdz·ə·Olsᴵ qf tsʙdz·Odzɻqfə·Olsᴵ dj,qffnjftɛ·Ədzsfnjscɻ dj,dɡj,dzstsə qf ‡tscdɡftscdj,dzstsə. ‡lscf fnjfcdz·Odz qf ‡tsнʳ tʃtɛcfLə·Odz tsʙdj,cuqflsᴵ ‡dzqfdzqfujf‡lzᵏ tsujdz·lz qf dz·ʙdz нj,dzqfʷ, ·Odj, LOdɡjdzqflsᴵ q¬.

ɻ dz·əOI. ɻəlz‡tsətsʔ qfdzɯq‡·Olststɛqf tstʃtsəjʰ j,dzqfj

t ·Oʙtsujj fnjsfnjstsʷdzqfj	ʊqfʃ ləlz‡tsətsctsfnjfcdz·Odz·O	J tsLdɡsɻdz·Oʸ tʃtɛqfuqfdz·Oq ‡tstɛtɛj‡lsqftɛdzᵏ ʰ qfj нj ʔfnjəqfʷ
ʀ f¬tsнdzsj fnjsfnjstsʷdzqfj	l tstɛdɡ·Odz dz ʔ ləlz‡ tʃtɛqf tɛ·Oʙtslsj	/
	l j,qffnjftɛ·Ədzsfnjsᴵ ·Otʃ·Oɯ·Olsdzsctsts tsʙj fnjfj ujdzqfʷ. ∫ ʙtɛ·Olsqflsᴵ fnʸ ‡tʃtɛtsqflətsнqflsj dz нdzʷ tɛj dɡtsdzsO	l j,qffnjftɛ·Ədzsfnjsᴵ ·Otʃ·Oɯ·Olsdzsctsts tsʙj fnjfj ujdzqfʷ. ∫ ʙtɛ·Olsqflsᴵ fnʸ ‡tʃtɛtsqflətsнqflsj dz нdzʷ tɛj dɡtsdzsO
ɯtsfnjstsʷdzqfj ·O‡lsqfəOuqfqf	ɻəlz‡ dɡ·O‡fnjqfdɡ·Odz dzsctslztɛtsədzʷ	/
	ɻəlz‡ dɡqfdzqfdɡ·Odz dzsctslztɛtsədzʷ	
	l j,qffnjftɛ·Ədzsfnjsᴵ lstɛ·Odzfnjᴵᵍ fjjtɛ·Oqfdzqf dzsɻdzqfu	1) l tsɻdzqfuʳ L·Olstɛtsdzzdzqf qfdzqf L·O¬ə·Olsqfdzqf fnjdzqfʰ ‡tsdɡ dɡdzsctslsᴵ‡·Odzq. υ dɡjdzʰ qflsᴵ ‡tsdzqfujfnjsətslsᴵ‡·Odj,ʔ, ‡tsdzsO‡lsqftɛdzᵏ ʰ q¬ fnjs fnj‡·Odz tʃj,dj,dɡ [fnjdzqf ləlz‡ dj, tʃtɛj‡tɛ·Oʰ ·Oj,lsfnjʸ, tsfnjststɛtsɻdzs lzн·Odzqflsᴵ lsᴵ‡·Odzq, fnjsʙtɛ·Oəʰ qfj,fnjʸ dz·O‡tsdzuj, tɛ·Oʙtsuqf¬ qfdzfnjstɛzdɡjdzstsə dzsɻdzqfu. 2) l j,qffnjftɛ·Ədzsfnjsᴵ lstɛ·Odzfnjᴵᵍ fjjtɛ·Oqfdzqf dzsɻdzqfu
	ɯqfcdz·Odztɛj ɻqfdɡ·O ADVANCED	/
		ɯqfcdz·OdzATT /

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Устранение неисправностей

Если возникла ошибка, обратитесь к следующей таблице, чтобы определить причину и способ устранения неисправности. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

Сообщение об ошибке	Описание
Ошибка самодиагностики	Произошла ошибка при самодиагностике. Обратитесь в службу технической поддержки.
Подключите ножницы правильно	Please connect Shear with Transducer correctly (Подключите ножницы правильно)
Подключите ножницы правильно	Make sure jaws are open while testing (Убедитесь, что губки открыты при тестировании)
Подключите ножницы правильно	Shear Error Detected (Обнаружена ошибка ножниц)
Подключите ножницы правильно	Transducer has 0 uses remaining (Датчик имеет 0 использований)
Подключите ножницы правильно	Please activate only one button at a time (Активируйте только одну кнопку)
Подключите ножницы правильно	Please release pressure on Scalpel (Снимите давление с скальпеля)
Ошибка самодиагностики	Ошибка самодиагностики
Ошибка самодиагностики	Self-check Failed (Самодиагностика не пройдена)

1. Убедитесь, что губки открыты, и повторите тест.
2. Если ошибка повторяется, замените датчик. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.
3. Подключите ножницы.
4. Подключите датчик правильно.

Подключите правильно. Если ошибка не устранена, обратитесь в службу технической поддержки.

Если ошибка повторяется, обратитесь в службу технической поддержки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

fnqkj нlz ʁ ɦ cfdzgf h G:G·dzgf.
ɔ tc·Gdzfnqʜ ʁ fnjtcjɦ j lsjtfdz ?, lsG¶ ¶G¶ lstsdz ¶ts ulststfcts h jdztfGcts ɔlz ʁ fnksjtcfdzfLGuqf ʁ . [G?lsj lstc·dzfnqʜ ʁ fnjtcdz tsfnks lsʜ tfcf ¶tsdzkGlsdzts? lsjdzgjtcGlslztcj ɔ lsjujdzfj dj dzjdjj 45 dzfdzls.

¶ lstslsdzjlstsн lsG¶xj dztsxjlscfnqtsdz Lts ɔ·Gls fny, j fnqkf lstc·dzfnqʜ ʁ fnjtc dz·Gtcj ɔG lsfny tfts fnqkj нdzflsj dz dzs? tc·Btslsr dz·ɔr fnks¶ts? dzgsɦ dzsfnksf.

[fnqkf dkjls dz¶G¶cf¬ tftcfLdz¶tsɔ tfjtcjctcj ɔ·lstc·dzfnqʜ ʁ fnjtc·) cf ¶·xjlsfny, ulststfctsBdkjdz·Gdkj dzgsxjls Br ls tcjɦ j dz·) tsBtc·Gscflsjfn ¶ tftcjнfks·ɔcflsjdz dzwdzgftctscfLɔtsнcflsjdz tfts lsj¬dz¶ujf ksts dzkz tsBfnqkxcfɔ·dz¶ʁ .

ɪ tsdzgfdzgs tftcjнts¬tc·dz¶flsjdkj?, ɔ cjdkjtc·Gststcj dkjlsнjlsGkj?, tsBfnqkxcfɔ·Gjdz ¬ tsfjtc·Gststctsdz [dzw Lc·dzkjdz cfdzf tsBfnqkxcfɔ·dz¶fw tsBtc·G? lsjfn ¶ fnjtcɔcffnqkzsdzkz tfjtcfnksdz·dkz, tsBlzujdz¶sdzkz cf G·lststcf Lts ɔ·dz¶dzsdzkz ¶tsdzgf·dz¶fj? Reach Surgical, Inc. cfdzf ¶ dzjfnksdzsdzkz tftcjнfks·ɔcflsjdz .

ʃ ʁ Btsj lsj¬dz¶ujf ksts jtsBfnqkxcfɔ·dz¶fj cf dzgsнjtcdz¶L·Ujqfw cjdkjtc·Gststc·Htsdzxdz ɔr tftsdzkzwlsʜ fny lsj¬dz¶ujf ksfcdz tfjtcfnksdz·dzsdz tftcts h jнh cfdz tsBlzujdz¶fj cf G·lststcf Lts ɔ·dz¶dzkz dz ¶tsdzgf·dz¶fj? Reach Surgical, Inc.

ʃ tfcfnq·dz¶dz jdz¶xj cfdzaqfнjdzs r dzgscjzlsdkjfnksc ɔ fnjBjlzctcsLlz ¶cfBjtcBjLtsf·Gfnqkzsfnksf:

1. ɪ tcfcfkzнcflsjdzdz ? нtsfnkszf ¶ dz Br dz kjtslsdzsfny h cfdzgny, dkj fnw L·dz¶dz dz fnjlzfnkstcs? fnks ɔtsdz tftcsнlz¶ls·dz нdzw lzdzlstc·Lɔlz¶ts ɔtsct¬cftcdztcctcf ujf ¶tsct cfdzfnkstdzdzjdzs·dtcf w ¶tsdzgf·dz¶fcf Reach Surgical, Inc.
2. ʃ ʁ Btsj dkjfnq·dz¶ ucftsdz¶fcts ɔ·dz¶dzkzsj fnjlsj ɔtsj ɔLcfdzgsнj?fnks ɔcfj fnjlzdzlstc·Lɔlz¶ts ɔr dz¬cftcdztcctcf ujf ¶cfdz tsBtstcdznts ɔ·dz¶fj dz¶tsdzgf·dz¶fcf Reach Surgical, Inc.
3. ʃ ʁ Br j tsBdzts ɔdkjdz¶fw tftcts h cfɔ¶cf cfdzf tftcsctc·dzgdzsctcts tsBj fnqkj ujf ¶fw, dkj fnq·dz¶ ucftsdz¶fcts ɔ·dz¶dzkz j ¶tsdzgf·dz¶fj? Reach Surgical, Inc.

[fnqkf tftcsfLts h jdz¶G¶ts?-dz¶Bts cfL ɔr h jtfjtcj ucffnqkjdzkz ¬ cfdzaqfнjdzstsɔ, fnw xj cfsjfn fnlststcctsɔr dz tftcjнfks·ɔcflsjdkjdz¶tsdzgf·dz¶fcf Reach Surgical, Inc. cfdzf dkjtftsfnqjнfks·ɔjdzdzs fn¶tsdzgf·dz¶fj? Reach Surgical, Inc. tfts G·нtcj fnkz Reachquality@reachsurgical.com.

[G·Lнjdz V. ʃ ucffnks¶ G

ɻ dz·ɔ GI. ʃ ucffnks¶ Gcjdkjtc·Gststc·G

- ʃ ucfh G?lsj cjdkjtc·Gststc·ɔ fnjstslsɔjlsfnks·ɔcf fnjtftcts ujнlztc·Gdzgf cfdzf tftc·ɔcfdz·Gdzgf Btsdz dzf ur . ɪ jtcjн ts ucffnks¶ts? tsls¶dz ucflsj tfcfls·dzkj cjdkjtc·Gststc·Gtsls fnjlscf ɔr ls·G cflsj h dzztc tfcfls·dzkfw cfL ɔr ¬ tsнdzscts Bdzs¶G

ɪ [[[υ ɪ [[r [[l R [. ʃ ucffnks¶ G·dzgsxjlstfs·ɔtcjнcfls cjdkjtc·Gststc·cf ɔr Lc·Gls tftstc·Gxjdzcf jdkj¶ ¶ stc·fujf ksfcdzlstc¬ts¶tsdzcfdzf tftsxjGtc, jfnqkf tftcstdzflsr cfdzf tc·LBtc LcGls xjcfн¶tsfnks dz·Gcjdkjtc·Gststc cfdzf ɔ dkjcts, cfdzf tftsctdzLcfls cjdkjtc·Gststc·ɔ xjcfн¶tsfnks .

ʃr tftsdzkzflsj tsucffnks¶lz ɔ fnjstslsɔjlsfnks·ɔcf fnjs fnqkjнlz ʁ ɦ cfdzgf h G:G·dzgf

1. ɪ tcfcfctslstsɔ¹ lsj dzgs ʁ ɦ jj fnqkjнfnks·ɔts fnjdkj?lstc·Gdz dzpH cfdzf ¹ dz¬cfdzgdzsj dzgs ʁ ɦ jj fnqkjнfnks·ɔts fn dkj?lstc·Gdz dzpH ɔ fnjstslsɔjlsfnks·ɔcf fnjcfdzfnkstdz¶ucfj? tftcts Lɔtsнcflsjdzw dzgs ʁ ɦ jctsfnqkjнfnks·ɔ
2. ɪ tcslstcflsj ɔfnj tftsɔjtc¬dzsfnkscf (ɔ¶dz uG ¹ ¶tc·Gdzcjdkjtc·Gststc·) ɔtdzudzz ʁ ucffnkst? dzw c¶ts? ls¶·Gdz ʁ , fnqkjsujdzkzs? dkjBtsdzh cfdz¶tsdzfujf ksts uffnksw ɦ jctstc·Gfnks ɔtstc·G
3. ɪ tcslstcflsj ucffnkst? dzw c¶ts? ls¶·Gdz ʁ , fnqkjsujdzkzs? lsjtfdzs? ɔtsнtstftcts ɔtsнtsdzs? ɔtsнts? .
4. ɪ tcslstcflsj ucffnkst? dzw c¶ts? ls¶·Gdz ʁ .

ɻ dz·ɔ GII. ʃ ucffnks¶ Gtfjн·Gdzf

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

∫ ∪ζ∩ⁿ Ω?lsj ∩j.нΩdz ζ∩§Ωвj.dz ∩∫tsfηdj ζ∩fη∫tsdz.ltsэΩdzζ∩ʷ ə fηstslsэj.lsfηsэζ∩ζ∩ fηs fηdj.нlzᵍ ⁿ j.? ∩∫tatsuj.нlztats?:

1. ∫ lsfηsj.нζ∩dzζ∩lsj ∩j.нΩdz tslsgj.dj.tΩ∫ststΩ)
2. ɪ taζ∩gtslstsəᶦ lsj ᶫ dz.ζ∩d∫dzdtsj d∫sᵍ ⁿ j.j fηqj.нfηsэts fηdj.? lstΩdz dz. d∫pH ə fηstslsэj.lsfηsэζ∩ζ∩ fη ζ∩d∫fηstdz§ᶫ∪ζ∩j.? ∩∫tatsζ∩ɹətsнζ∩lsj.dzʷ.
3. l Ωнj.xᶫ dzts fηsj.нζ∩dzζ∩lsj §Ωвj.dz fη∫j.нΩdzᵍ ζ∩ ∩j.tgtdzɹζ∩lsj ζ∩□ ə ∪ζ∩fηsʷⁿ ζ∩? taΩfηsətstc dz.Ω2 d∫ζ∩dzlsʳ .

ɪ taζ∩dj.∪Ωdzζηjɹdzʷ ə ∪ζ∩fηsʷⁿ ζ∩? taΩfηsətstc∩∫ts∪ζ∩fηsζ∩lsj ∩j.нΩdz ζ∩§Ωвj.dz ətdz∪ζ∩dzᵍ ⁿ j.ls§ts? fη d∫ʷG§ts? ⁿ j.lsζ∩dzts?.

5. ơⁿ Ωlsj.dz dzts ∩∫tatsd∫s?lsj ∩j.нΩdz ζ∩§Ωвj.dz lsj.∩∫dzs? ətsнtsɹ∩∫tatsətsнdzts? ətsнts? ə lsj.∪j.dzζηj. dj. dj.dj.j 1 d∫ζ∩dzlsʳ .l ts ətaj.d∫ʷ ∩∫tatsd∫ᵍ ə§ζ∩§Ωвj.dz ζ∩∩j.нΩdz ∩j.j.ta§ᶫdz ∪Ωlsjdzнtsdzɹdz. вʳ lsᶦ dzΩнj.xᶫdzts fηsj.нζ∩dj.dz. .

6. ɪ tatslstaζ∩lsj ə fηj ∩∫tsэj.tg□dzsfηsζ∩ ∪ζ∩fηstsʔ d∫ʷG§ts? lsᶫΩdz.ᵍ

Лlʀʃϕlʀɾ:lj.ζ∩fηɹtsdzʟlz?lsj нdzʷ tsuζ∩fηs§ζ∩∩j.нΩdzζ∩ lzdzlstΩɔəlz§tsəlzᵍ uζ∩fηsʷⁿ lzᵍ d∫Ωᴴ ζ∩dz.

Лlʀʃϕlʀɾ: Л ts ζ∩ʟвj.xᶫΩdzζ∩j ∩∫tsэta§.xᶫнj.dzζ∩ʷ G§j.dj.tΩ∫ststΩ dj. ə§ᶫdz ∪Ω?lsj j.Gts ə fηjlsᶦ нts ∩∫tsн§ᶫdz ∪j.dzζ∩ʷ §Ωвj.dzʷ ∩∫ζ∩lsΩdzζ∩ʷ ∩∫j.ta§ᶫdj.dzdtsGts lstsᶫΩ§ G§j.dj.tΩ∫ststdz. ɪ j.ta§.н fηвtstΩ§ts? lzвj.нζ∩lsj fη, ∪lsts ə fηj fηsj.нζ∩dj.dzζ∩ʷ fηz□ζ∩j.

ɬ ΩʟнjdzVI. ʌ j.ʟtst∫Ωfηqdtsfηsᶦ ζ∩ʷ ∪lzdf§ ∪ζ∩tsdtΩdz dz. j.ζ∩fη∫ʳ lsΩdzζ∩ʷ

Лlʀʃϕlʀɾ.Л ts ζ∩ʟвj.xᶫΩdzζ∩j ətsʟdd∫sxᶫdzdtsGts ∩∫tstΩ∩ɹj.dzζ∩ʷ ɬdj.§lstΩζ∩uj.fη§ζ∩dd∫lstsᶫ§tsd∫dj. əfη§tΩʳ əΩ?lsj §ᶫtstζ∩lzfηGj.dj.tΩ∫ststΩвɹj.ʟ tΩ∩ɹta§ʰ j.dzζ∩ʷ. ∫ ᵍ вtsj. lsj.□dzζ∩uj.fη§tsj. tsвfηqdzxᶫζ∩əΩdzζ∩j. ζ∩ d∫§нj.tadzζ∩ʟΩ∪ζ∩ʷ Ω∩∫∩ΩtΩ∫sΩнtsdxᶫdz. əʳ ∩∫tsdzdzʸlsᶦ fηʸ fηj.ta∘ζ∩fηqdz d∫∩∫j.tΩfηtsdzΩdtsd∫ ∩∫tatsʰ j.нʰ ζ∩d∫tsвlzuj.dzζ∩j. ζ∩ Ωəlststaζ∩ʟtsəΩdzdz d∫§ᶫtsd§∫Ωdzζ∩j.? Reach Surgical, Inc.

Лlʀʃϕlʀɾ.Л ts ζ∩ʟвj.xᶫΩdzζ∩j ∩∫tstΩ∩ɹj.dzζ∩ʷ lss§ᶫtsd∫ζ∩dzd tsxᶫtsGtsə ∩∫Ω∪ζ∩j.dzsΩζ∩ dj.нζ∩uζ∩dzdf§ᶫtsGts ∩∫j.tΩfηtsdzΩdzΩ) ΩlsΩ§xᶫj. ∩∫tsətaj.xᶫнj.dzζ∩ʷ tsвtstdzнtsəΩdzζ∩ʷ ζ∩dzd нtdzGζ∩□ Ω∩∫∩ΩtΩ∫stsə dj.tsв□tsнζ∩d∫§ts ∩∫tsdzuζ∩ʟs ∩∫taj.нfηsΩədj.dzζ∩j. ts ∩∫taζ∩dzɹζ∩∫∩Ω□ ζ∩ d∫j.lstsнΩ□ dzΩ.j.tadzts? □ζ∩tdztaGζ∩ζ∩, ᶫdj.§lstats□ζ∩tdztaGζ∩ζ∩ ζ∩ lzdzlstΩɔəlz§tsə ts? □ζ∩tdztaGζ∩ζ∩. ʉdj.нζ∩lsj ʟΩlsj d∫§ ∪lstsвʳ ᶫdj.§lstaζ∩uj.fη§Ωʸ ζ∩ʟtsdzʷ∪ζ∩ʷ ζ∩dzd ʟΩ.j.d∫§j.dzζ∩j dj. вʳ dzζ∩ ∩∫tsətaj.xᶫнj.dz. .l j ∩∫tsGtdzxᶫΩ?lsj ᶫdj.§lstats□ζ∩tdztaGζ∩uj.fη§ζ∩j ∩∫tatsвtstcʳ ə xᶫζ∩н§tsfηsᶦ, j.fηqdzζ∩ ᶫlsts dj. ∩∫taj.нlzfηqdzslstaj.dzs §tsdzfηstdz§ᶫ∪ζ∩j.? ζ∩dzd dj. lz§ᶫΩʟΩdzts dzΩᵘ lsζ§j.ls§j..

Лlʀʃϕlʀɾ.Л ts ζ∩ʟвj.xᶫΩdzζ∩j taζ∩fη§Ω∩∫tstΩ∩ɹj.dzζ∩ʷ ᶫdj.§lstaζ∩uj.fη§ζ∩dzlsts§tsd∫нΩdzdtsj tsвtstdzнtsəΩdzζ∩j нtsdxᶫdzts ∩∫tsн§ᶫdz ∪Ωlsᶦfηʸ lstsdz§ts§ fηjlsζ∩ fηʟΩᴴ ζ∩lsdz. d∫ʟΩ.j.d∫§dj.dzζ∩j d∫

Лlʀʃϕlʀɾ.Л ts ζ∩ʟвj.xᶫΩdzζ∩j lstΩəd∫§ta∘sΩdzζ∩ʷ ∩∫tsdzʟtsəΩlsj.dzʷ ζ∩dzd ∩∫Ω∪ζ∩j.dzsΩəts ətaj.d∫ʷ tsfηqdzslstΩ∩tsвtstdzнtsəΩdzζ∩ʷ fηqdzj.нζ∩lsj ʟΩlsj d∫§ ∪lstsвʳ dzsɹxᶫuʳ dzΩ□tsнζ∩dzd fη dzΩtΩ□fηqdzsʷdzζ∩ζ∩ tsls нtdzGζ∩□ Ω∩∫∩ΩtΩ∫stsə, □ζ∩tdztaGζ∩uj.fη§ts? ∩∫tatsfηqsʳ dzζ∩, ᶫ∩Ω∪ζ∩j.dzsΩζ∩d∫dzd нtdzGζ∩□ ∩∫taj.нd§j.lstsə. Л ts ətaj.d∫ʷ ∩∫tatsəj.tg§ζ∩ tsвtstdzнtsəΩdzζ∩ʷ dj.tsв□tsнζ∩d∫§s fηsвdz нΩlsᶦ d§j.tGᶜ вj.ʟtsᶫΩfηqdzsfηsζ∩ нdzʷ tΩ∂tslsʳ ə lzfηqdtsəζ∩ʷ□ ∩∫tsəʳ ʰ j.dzdtsGts fηsнj.ta∘ɹΩdzζ∩ʷ ᶫΩdtsə (ə fηstslsэj.lsfηsэζ∩ζ∩ fη∫tatsuj.нlztΩdz§ζ∩ ζ∩ ∩∫tΩ∂ζ∩d∫dzΩd§ζ∩ вtsdz dzζ∩uʳ).

ɪ tatsətsнζ∩lsj ∩∫tatsəj.tg§lz вj.ʟtst∫Ωfηqdtsfηsζ∩ ζ∩ʷ lzdf§ ∪ζ∩tsdtΩdz dtsfηsζ∩ lstΩdzfηqᴵᵍ fηj.tΩ∂ G§j.dj.tΩ∫ststΩζ∩ ∩∫j.нΩdzζ∩ ə fηstslsэj.lsfηsэζ∩ζ∩ fη∫tatsuj.нlztΩdz§ζ∩ ζ∩ ∩∫tΩ∂ζ∩d∫dzΩd§ζ∩, ∩∫taζ∩dzʷlsʳ d§ζ∩ ə вtsdz dzζ∩uζ∩□. ɪ tatsəj.tg§lz вj.ʟtst∫Ωfηqdtsfηsζ∩ ζ∩ tΩ∂tslstsfη∫tsfηsвdtsfηsζ∩ нtdzGζ∩□ §tsd§∫tsdj.dtstsə, ζ∩fη∫tsdz ʟlzj.dzʳ □ dj.fη§tsdz §ζ∩d§ζ∩

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ɻ dљə·OI. ɬ tœtsəјtеʕ·Oвјцtstƒ·Gfщdtsfйsсƒ

ɻјdзјtе·Gststс тƒtœtsəјtеʕ·Olstsʕ·Oɬzlsјцʕсƒ нtsdwɻdљ·Oтƒtœtsətsнсƒlsᵍ fпў fщjtеlscƒᵂсƒцсƒtœtsə·Gdwdwz dзlsјˆdwƒцјfпʕсƒdз тƒјtеfщtsdљ·Odtsdз вtsdz dwƒцʳ .
ɬ јнG·dz : тƒtœtsəјtеᶜ lsј тƒјнG·dz , tе·OLʲ јdзʕ·Oвјdzʷ сƒ ʕ·Oвјdz dљ·Oтƒtејнdзјls lstејʰ сƒdzсƒdwƒ нtdzбсƒˆ тƒtsətејɤɻнјdwƒ?. ɪ·Odзјdwƒlsј тƒtsətејɤɻнјdwdz јˑdзјdзјdљsʳ

[tœzбсƒј ʕtscdзƒtsdзјdљsʳ : тƒtœtsəјtеᶜ lsј ə fщtstslsəјlsfпjsəсƒс fпсƒdzfйstedzʕцсƒј? тƒts ɬʕfпƒdwzGsS·Оцсƒс.

ɻ dљə·OII. ʌ lzdљ·цсƒtsdљ·Odz dљ·Oʷ тƒtœtsəјtеʕ·O

1. ɬ tsнбtslstsəᵘ lsј ʕtscdзƒtsdзјʕls dљsɤdwƒцсƒ тƒtsнʕdz цсƒlsј lstе·Odzfпнᵘᵡ fщjtеə fщtstslsəјlsfпjsəсƒс fпtstƒсƒfпGdwƒјdз ə tе·Oцнјdзј III ç∫ tscdљS·Oɬ сƒɬʕfпƒdwzGsS·Оцсƒʷ tsвtstеzнtsə·Gdwƒцʷè.

2. ɬ tœtsəјtеᶜ lsј, əʳ тƒtscdzʷјlsfпʷ dwƒ тƒјtеј⊐tsн ə tе·Oвtsцсƒ? tејɤсƒdз

3. ɬ tœtsəјtеᶜ lsј, tslstsвtе·Oɬ·Oᵘ lsfпʷ dwƒ dљ·Oнсƒfщƒdзјˑ lztœtsədwƒ dзsʰ dљsfпjsс 3 нdzʷ tејɤсƒdз·OVAR с 5 нdzʷ tејɤсƒdз·OFULL.

4. l ·Oɬdзƒlsј ʕdwstƒʕlz тƒtsəʳ ʰ јdwƒʷ с fщdwƒхјdwƒʷ dзsʰ dљsfпjsс, цlstsвʳ lzвјнсƒlsᵍ fпў, цlstslztœtsəјdz dзsʰ dљsfпjsс ə tејɤсƒdзј VAR dзsхјlsвʳ lsᵍ сƒlсdзјdљdztslslztœtsədzʷ 1 нts 5.

5. ∫ lsʕdz цсƒlsј тƒсƒlsO·dwƒјˑ сбјdљtе·Oststе·O ɬ tsнtsɤнсƒlsј 5 fпјʕlzdwн, lG·Oslјdз əʕdz цсƒlsј тƒсƒlsO·dwƒјˑ сбјdљtе·Oststе·O ɬ tsнtsɤнсƒlsј 15 fпјʕlzdwн.

6. ɬ tœƒ тƒјtеј⊐tsнјˑ ə tе·Oвtsцсƒ? tејɤсƒdзтƒtœtsəјtеᶜ lsј, tslstsвtе·Oɬ·Oᵘ lsfпʷ dwƒ dљ·Oнсƒfщƒdљјˑ lcdљ·Oцјdwƒʷ lztœtsədzʷ dзsʰ dљsfпjsс 3 нdzʷ tејɤсƒdз·OVAR 3 с lztœtsədzʷ dзsʰ dљsfпjsс 5 нdzʷ tејɤсƒdз·OFULL. ɬ tœtsəјtеᶜ lsј, G·Slsсəсƒtœtsə·Gdzdwƒ сбјdљtе·Oststе·ə fщtstslsəјlsfпjsəсƒс fпlstејвtsə·Gdwƒʷ dзsƒ. υ нјtе·ɤсəс·Oᵘ lste·Odfпнᵘᵡ fщjtеlsG·Sсƒdз tsвte·Ltsdз цlstsвʳ јcбts н·Odz dwƒ? ʕtscdљцвʳ dzdљ·Oтƒtе·Gdљdzə ətsLнlz⊐, dљ·Oɬdзƒlsј FULL dљ·Oтƒјн·Odwƒ. ɬ tœtsəјtеᶜ lsј, dзsƒcбG·Sјls dwƒ dљ·Oᵘ ʕte·Odљ сƒdwнсƒʕ·Oststе·lztœtsədzᵂ dзsʰ dљsfпjsс FULL сƒ fщdzʰ јdzdwƒ ləlzʕ, fщəсƒнјlsјdz fпjsəlzᵡ ʰ сƒ? ts əʕdz цјdwƒсƒ tејɤсƒdз·OFULL.

7. [јtе·ɤсƒlsј lstе·Odzfпнᵘᵡ fщjtеlsG·S, цlstsвʳ јcбts н·Odz dwƒ? ʕtscdљцвʳ dzdљ·Oтƒtе·Gdљdzə ətsLнlz⊐, с dљ·Oɬdзƒlsј VAR dљ·Oтƒјн·Odwƒ. ɬ tœtsəјtеᶜ lsј, dзsƒcбG·Sјls dwƒ dљ·Oᵘ ʕte·Odљ сƒdwнсƒʕ·Oststе·lztœtsədzᵂ dзsʰ dљsfпjsс FULL с fщdzʰ јdzdwƒ ləlzʕ, fщəсƒнјlsјdz fпjsəlzᵡ ʰ сƒ? ts əʕdz цјdwƒсƒ tејɤсƒdз·OFULL.

ʃ l ʀ ∫ ϕ l ʀ [. ʃ ts сƒlвјɤ·Odwƒјˑ lste·Gdзтƒtsdzltsə·Gsјdzᵂ сƒdwƒ тƒ·Oцсƒјˑ dљs·Oтƒtеƒ fщdzцс? dљsdз fпщ·Oв·Gsʳ ə·Odwƒсƒ dљsɤdwƒцʳ dзјˑ нtsdwɻdz dz·Oтƒtsнсƒlsᵍ fпў ə ʕtscdљs·Slsјˑ fпjтƒ·Oцсƒјˑ dљstsdз ⊐сƒtеdztебсƒцјfпʕts? тƒtœtsfпjsʳ dзјˑ? сƒdwƒ dзјˑG·Sts·Otsdwƒ dz·Odзјˑ dzᵂᵡ ʰ сƒdзсƒfпў dзsG·Sјˑtеƒ·Odz·Odзƒ, ʕtsGнO·tsdwƒ dзјˑ сƒfщƒtsdz lzᵡ lsfпў.

ʅ O·Lнјdz VII. ɬ tејнlztƒtејɤнјdwƒʷ сƒ сƒнјdљsсƒᵂ сƒʕ·Oцсƒʷ

ʃ l ʀ ∫ ϕ l ʀ [. ş əʳ тƒtscdzбјdwƒᵡ dзsdљsсƒdв·Oцсƒə·dz ⊐ tsтƒјtе·Oцсƒ? нtsтƒlzfпʕ·Gјlsfпў lstsdzʕts тƒјtеfщtsdљ·Odz, сƒdзјᵡ ʰ сƒ? fщjtеlscƒᵂсƒʕ·Os с ɻ·Ldљʕtscdз ? fпjdзsdљsсƒdв·Oцсƒə·dwƒ? lsјˑ⊐dwƒʕts?. ɬ јtејн əʳ тƒtscdzбјdwƒјdзdz вts? dзsdљsсƒdв·Oцсƒə·dwƒ? tstƒјtе·Oцсƒс dзјtsвˑ⊐tsнсƒdзts tsLdљʕtscdзƒlsʳ fпў fпjdзјнсƒцсƒdzfйʕts? dzсƒlsјtе·Oslztœtsə?, ʕ·GfпO ʰ јˑ?fпў dзsdљsсƒdв·Oцсƒə·dwƒ? lsјˑ⊐dwƒʕсƒ, tsfщdwƒɤ·dзјdwƒ? сƒ⊐сƒtеlztœбсƒцјfпʕtsбts tœсƒfпʕO
ʃ l ʀ ∫ ϕ l ʀ [. ş Oʕ сƒнdzʷ əfпј⊐ сƒfщƒstsцdwƒʕtsə·dзјtебсƒс (əʳ fщʕtsцсƒfщƒstslsdwƒ?, dљOLјtеdwƒ? сƒdwƒ lzdzlste·Oləlzʕtsətsƒ?), fщdзнlzјlslzцсƒlsʳ əOsᵍ ətsLdзƒsɤdwzᵡ ʕ·Odwјtеƒsбјdwdzᵡ сƒdwƒ сƒdwᵂјʕцсƒstsdwdzᵡ tstƒGfщdwƒsfпsᵍ, əʳ lə·Odwdzᵡ тƒtsвtsцdz dзсƒ тƒtеƒsнlzʕlsOdзсƒ tе·Oвtslsᵍ fпlsʕ·Odwdзсƒ, lsGʕсƒdзсƒ ʕ·Gʕ нʳ dзсƒlszdзdwz.ɬ tœ[tslsʕtеᶜ lsʳ ⊐с ·Oвнtsdзсƒdљ·Odz dz ⊐ tstƒјtе·Oцсƒʷ⊐ dзјtsв⊐tsнсƒdзts тƒtœ[dwƒdзсƒdзOslsᵍ fпjstslsəјlsfпjsəlzᵡ ʰ сƒјˑ dзјtеᶜ lO·ᵍ сƒlsʳ , dљ·Oтƒtœ[dзјtе, dљ·Oнјəsᵍ lO·ᵍ сƒlsdzˑ јˑtsцʕсƒс тƒtејfпщсƒtе·Oststеʳ ᵂсƒdzlstdzᵡ ʰ јбtslsсƒтƒ·O,·Olsʕ·Gɤјˑ сƒfщƒtsdzlzts·Oslᵍ ɻᵂᵂјʕlsсədzˑ јˑ əʳ lsʷɤdzˑ јˑlzfпjstœts?fпjsə·O

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Jlʀʃ ϕlʀ[.ɪ tsfqlj cfqfʃtsdzʟtsɔΘlzʃʷʜΘlzlzsctsΘʃgtʃΘɪɛΘsΟʃɪɛtsɔjtɛˢlsj, tʃtɛjʕtɛΘsʃclzsfɲ dzʃʕtɛsɔtslsjˌujˌdzʃj cʃʟlsʕΘlzʃ. J tʃtɛtslsʃɔdzsdzʒfqlzˌuʃ dzɟtsʙ⊐tsʜcʃdʒsˌtʃtɛʃcdzʷlsˢ fqstslsɔjˌlsfqsɔlzᵍ ʰ cʃj dʒjtɛʳ .

Jlʀʃ ϕlʀ[.ʀ fqʃtsdzʟtsɔΘlzʃj cʃʟʜjˌdzʃʔ, tʃtɛtsʃʟɔjˌʜjˌdzlzˌ⊐ cʃdzʃ tɛΘfqʃtɛtsfqstɛΘlzʷjˌdʒ ⊐ʕtsdzgfΘlzʃʷdʒʃ, ʕtɛtsdzj Reach Surgical, Inc. dʒsʏjˌlsʙʳ lsˢ dzɟfqsɔdzjˌfqksʃdʒs fɲlzdzˌlstɛΘlɔlzʕtsɔʳ dʒfgʕΘlzˌtʃjˌdzɟdʒCSUS.
ʀ fqʃtsdzʟtsɔΘlzʃj ɻlsʃ⊐ cʃʟʜjˌdzʃʔ dʒsʏjˌjˌlstʃtɛʃɔjˌfqksʃ ʕ dzɟtsʏ cʃʜΘlzlzˌ dʒtɛjˌʟzdzˌlsΘlsΘlzʒ cʃ fqksΘsˢ tʃtɛʃuʃcʃlzsʔ lstɛΘɔdʒˢ tʃtsdzʟtsɔΘlsjˌdzʷ cʃdzʃ tʃΟuʃcʃjˌdzsΟ

Jlʀʃ ϕlʀ[.lˌjʕtslststɛˢjˌʕtsdʒtʃtsdɟlzsʳ (dzΘtʃtɛʃcʃdʒjtɛˌlstɛΘlzfqʜᵘ ᵍ fqjtɛ) lzdzˌlstɛΘɪɔlzʕtsɔʳ ⊐ dzsʏ dzʃuʃ CSUS dʒsɢlzʃ dɟ tʃtɛtsʔlsʃ fqksjtɛʃcdzʃʟΟuʃcʃᵍ tʃjtɛjʜɔʳ tʃlzfgʕtsdʒfɲʟΘɔtsʜΟɻjtɛjʜlzfqksΘlzsɔʕtsʔ tsʙtstdzʜtsɔΘlzʃʷ dɟtsʙ⊐tsʜcʃdʒs tʃtɛtsɔjfqksʃ fqksjtɛʃcdzʃʟΟuʃcʃᵍ cʃʟʜjˌdzʃʷ ɔ fqstslsɔjˌlsfqksɔcʃ fɲlstɛjʙtsɔΘlzʃʷdʒʃ. υʕΟlΘlzʃʷ tʃts tsuʃcfqksʕjˌ cʃ fqksjtɛʃcdzʃʟΟuʃcʃ tʃtɛʃɔjˌʜjˌdzˌ ɔ fqstslsɔjˌlsfqksɔlzᵍ ʰ cʃ⊐ cʃdzfqstdzʕuʃcʃʷ⊐.

Jlʀʃ ϕlʀ[.J ts cʃʟʙjˌʏΘlzʃj tslsʕdzsdɟlzʃʷ tʃjtɛjʜΟuʃcʃ lzdzˌlstɛΘɪɔlzʕtsɔtsʔ ɻ dɟtɛɢcʃcʃ dɟ fqjɟʜlzjˌlsfqlzʃʰ ʕtsdʒ fqʃdzˌdzsʜΘɔcʃlsˢ dzΘtɛlzʕtsʷlsʕlzˌdzsʏ dzʃuʃ.

Jlʀʃ ϕlʀ[.ɪ tɛsdzʃɔΘlzʃj cʃdzʃ tɛΘʟʙtɛʳ ʟɢʃɔΘlzʃj ʏˌcʃʜʕtsfqksʃ dzΟ cɟˌdɟtɛΘlststɛ cʃdzʃ ɔ dɟɢtsˌ Θ lsΘʕʏjˌ tʃtsɢtdzʏjˌdzsʃj cɟˌdɟtɛΘlststɛΟ ɔ ʏˌcʃʜʕtsfqksˢ dʒsʏjˌjˌls tʃtɛʃɔjˌfqksʃ ʕ tʃtsɔtɛjʏˌʜjˌdzsʃᵍ cɟˌdɟtɛΘlststɛΟ tʃtstɛΟʏjˌdzsʃᵍ ɻ dɟʕlstɛʃuʃ fqʃcʃdʒlstsʕtsdʒcʃdzʃ tʃtsʏ Θdz.

Jlʀʃ ϕlʀ[.υʜʃʃJʀC Jɪϕʀʃʃ[ɾʁʜʊJʀC lstɛjʙlzᵍ ls, ʋlstsʙʳ l ϕʂʃϕ[ʒJϕ[ʃʒ[ʏϕʜʊʀ ʜtɛdzɢtsɢts ʃ[ɾʀʌʀlʜʂʃɻʃ ʕʃ[ʂʊ[ʃʃɻʃ[υ[ʃJϕlʀC, cʃfqʃtsdzʟlzjˌdʒsɢts ɔ tɛΘdʒʕΟ⊐ ʂʃlʌʀɻυ[ϕʌʀʀ[ʃC ʕl[ʃʜʂʃɻʀʏ[ʜʂʃɻ[ʀʃ[l[lʀC,ʙʳ dzlϕʂʃϕ[ʒJϕ[ʃʒʃʀ ʏϕʜʊʊCʃ ʀ ʊʀɻ ϕ BF cʃdzʃlϕʂʃϕ[ʒJϕ[ʃʒʃʀ ʏϕʜʊʊCʃ ʀ ʊʀɻ ϕ CF.

Jlʀʃ ϕlʀ[.ɪ tɛʃ cʃfqʃtsdzʟtsɔΘlzʃcʃʕʃ[ʂʊ[ʀʏ[ʜʂʀʍʕl[ʃʃʜʂʃɻʃJ fɲʕʃ[ʂʊ[ʀʏ[ʜʂʀʃ ʀ υʜʊt[ʃʁʜʊJϕʃ ʀ[ʃC ʕl[ʃʊ[t[ϕɻʀʀ lsΘʕcʃjˌɻwwjˌʕlsˢ ,ʕΘʕ tʃtsdʒ⊐cʃ,ɔtsʟdzʃʕΟᵍ ʰ cʃjˌtʃtɛʃtɛΘʙtslsjˌɔʳ fqsʕtsυcfqksʃlsdzsɢts⊐cʃtɛdzɢɛʃuʃfʒʕtsɢts cʃdzfqstɛdzdʒjˌdzsΘlzʃɢΘlsʃɔdzsɔdzʃʷlsˢ dzΟtɛΘʙtslsjˌʜtɛdzɢtsɢts ɻ dɟʕlstɛsdzdzsɢts dʒjˌʜcʃuʃcʃdzfqʃtsɢts tsʙtstɛdzʜtsɔΘlzʃʷ, dzΘtʃtɛʃcdzjˌtɛ, dʒsdzʃlststɛsɔ cʃ fqʃcfqksjˌdʒɔcʃʟlzΘlzʃʟΟuʃcʃ.

Jlʀʃ ϕlʀ[.ʃ cʃdzʃcʃΘlzˌdzscʃdzɔΘʟɔdzˌjˌdʒjˌʜcʃuʃcʃdzfqʃcʃjˌ lzfqksɢtsʔfqksɔΟtɛΘʟdzˌ⊐ tʃtɛtsʃʟɔtsʜcʃlsjˌdɟʔ dʒsɢdzls tslsdzʃuΘlsˢ fɲ. ɾ fqlzʃ ʜdzʷ tsʜdzsʔ tstʃjˌtɛΟuʃcʃ cʃfqʃtsdzʟlzᵍ lsfɲ dʒΘlzsʃdzɔΘʟɔdzˌjˌdʒjˌʜcʃuʃcʃdzfqʃcʃjˌ lzfqksɢtsʔfqksɔΟcʃ tʃtɛʃcdzΘʜdɟʏjˌdzsfqksʃ tɛΘʟdzˌ⊐ tʃtɛtsʃʟɔtsʜcʃlsjˌdɟʔ, tʃjˌtɛjʜ dzΟuʃcʃlsdzʃtʃtɛtsujˌʜlztɛˢ dɟtsʙ⊐tsʜcʃdʒs tʃtɛtsɔjˌtɛʃcʃlsˢ cʃ⊐ fqksɔdzjˌfqksʃcʃdʒsfqksˢ .

Jlʀʃ ϕlʀ[.ɪ jˌtɛjʜʕΟʏʜʳ dʒcʃfqʃtsdzʟtsɔΘlzʃjˌdʒɔdɟʰ dzʷʷ tʃtsɔjˌtɛ⊐dzsfqksˢ ʋCfqksjʔ dzˌʙʳ ⊐ ʕʃ[ʂʊ[ʀʏ[ʜʂʀʍυʜʊt[ʃʁʜʊJ ʃʃC ʕl[ʃʊ[t[ϕɻʀʀ, tʃtɛjʜdzΟΘlzʃjˌdzsˌ⊐ʰ dzˌɔɔjˌʜjˌdzsʃʷ ɔ ɻ ϕʌʀʃ[lʊϕ, tsʙʷʟΟsjˌdzˌdzsʜtsdzʏdzΟtʃtɛtsɔjˌtɛʷlsˢ fɲ dzΟtslsfqzlsfqksɔcʃjˌ dɟʏjˌjˌdzΟlsjˌdzˌdzˌ⊐ʰ jˌtɛtsʻ⊐tsɔΘlsʳ ⊐ tʃtsɔjˌtɛʻ⊐dzsfqksjʔ, tsfqstɛʳ ⊐ʕtɛtsdʒsʕ cʃdzʃ ɔʳ fqksʒtʃtsɔ, ʕtslststɛˢ jˌdʒsɢlzls ɔʳ lɔΘlsˢ ʊt ϕlʃʒ.Jlʀʃϕlʀ[. ʀ fqʃtsdzʟtsɔΘlzʃj tʃtɛʃcdzΟʜdɟʏjˌdzsfqksjʔ, ʜΘsuʃcʃʕtsɔ cʃʕΟʙjˌdɟʔ, tslsdzʃuʃdzˌ⊐ tslslzʕΟlΘlzʃdzˌ⊐ cʃdzʃ tʃtɛjˌʜtsfqksɔdɟjˌdzsdzˌ⊐ tʃtɛtsʃʟɔtsʜcʃlsjˌdɟʔ, tʃjˌtɛjʜ dzΟuʃcʃdzʃtʃtɛtsujˌʜlztɛˢ dɟtsʙ⊐tsʜcʃdʒs tʃtɛtsɔjˌtɛʃcʃlsˢ cʃ⊐ fqksɔdzjˌfqksʃcʃdʒsfqksˢ tʃtɛtsʃʟɔtsʜcʃlsjˌdɟʔ, ʜΘsuʃcʃʕtsɔ cʃʕΟʙjˌdɟʔ, tʃjˌtɛjʜ dzΟuʃcʃdzʃtʃtɛtsujˌʜlztɛˢ dɟtsʙ⊐tsʜcʃdʒs tʃtɛtsɔjˌtɛʃcʃlsˢ cʃ⊐ fqksɔdzjˌfqksʃcʃdʒsfqksˢ .

Jlʀʃ ϕlʀ[.ɪ ʃˌtʊϕʊʀJlʃʃ tɛΘʜcʃtsuʃcfqksjˌʕtsdʒtʃdzdzʃʕΟuʃcʃtsdzdzsj tsʙtstɛdzʜtsɔΘlzʃj (ɔʕdzˌuʃΟᵛ tʃjˌtɛʃcʃʷjˌtɛʃcʃʔdzˌjˌlzfqksɢtsʔfqksɔΟ,lsΘʕcʃjˌʕΘʕ ΘdzsjˌdzsˌjˌʕΘjˌdzʃˌ ʕΘdzsjˌdzsˌ) ʜtsdzʏdzs cʃfqʃtsdzʟtsɔΘlsˢ fɲ dɟˌʙdzʃʏjˌ 30 fqʒ(12 ʜᵍ ʔdʒtsɔ) ʕdzˌʙtsʔ uʃcfqksʃcʃυʃʔʊt[ϕɻJυʂʃJʃɻʃ ⊐cʃtɛdzɢtsɢʃuʃfʒʕtsɢts cʃdzfqstɛdzdʒjˌdzsΘlzʃʷ, ɔʕdzˌuʃΟᵛ ʕΟʙjˌdzʃ, lzʕΟlΘlzʃdzˌjˌʀɻɻʃʃʊ[Jʀʊtʃʃtʃʃ .J tʃtɛtslsʃɔdzsdʒ fqʃdzuʃcʃʷ ɻ lsts dʒsʏjˌjˌlstʃtɛʃɔjˌfqksʃ ʕ lz⊐lzʜʰ jˌdzʃʃᵍ ⊐Οɛʕlsjˌtɛʃcfqksʃ ʜΘzdzsɢts tsʙtstɛdzʜtsɔΘlzʃʷ.

Jlʀʃ ϕlʀ[.ɾ fqʃdzʃ lstɛΘlzfqʜᵘ ᵍ fqjtɛʷɔdzs tʃtsɔtɛjʏʜjˌdzˌtʃtsfqɟjˌtsuʃcfqksʃʕcʃ cʃ fqksjtɛʃcdzʃʟΟuʃcʃɔʳ ʙtɛsfɲlsjˌɔfqjˌ tʃtsɔtɛjʏʜjˌdzsˌjˌʕtsdʒtʃtsdɟlzsʳ .J ts cʃʟʙjˌʏΘlzʃj dɟˌdzΘʜdɟʏjˌΟᵛ jˌɢtsˌcʃfqʃtsdzʟtsɔΘlzʃʷ ujˌlsʕts tʃtɛtsdʒΘɛʕcʃlɛdzʔlsj tʃtsɔtɛjʏʜjˌdzsˌjˌʕtsdʒtʃtsdɟlzsʳ .

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ʅ tscdʒj tɑ ʜtsʕ lzdʒj dlsϴ	KF-F102-SK-20(B)
Ɪ j tɑfɳʃʷ ʜtsʕ lzdʒj dlsϴ	X.10
ʃ ϴlsϴɔfɳʃslzʃʃ dʒj dzʃʃʷ ɔ fɳʃʃ dlz	AUTODED

σ tɑϴdlfɳʃᵘ ᵝ fɳʃj tɑ ʜdlʷ lzdlʷ lstɑϴlɔ lzʕ ts⊃ tsɑ²ts ¬ʃtɑlztɑɑ²ʃʅj fɳʃ tsɑ²ts ʃdlfɳʃstɑlzdʒj dlsϴtɑʃʷ

ʁ dlfɳʃstɑlzʕ ʅʃʃ tʃts tʃtɑʃdʒj dj dzʃᵝ

ϕ ɔlststɑ	ɻ tɑtsɔj tɑʕϴ	υ lsɔj tɑ>ʅ ʜj dzʃj
ʃ ϴlsϴ 19.07.2023	19.07.2023	ʃ ϴlsϴ 19.07.2023

ʜ tsʃlzlsfɳʃɔlzᵝ ʃʰ ʃj ʜtsʕ lzdʒj dlsʳ

ʅ tscdʒj tɑ ʜtsʕ lzdʒj dlsϴ	**ʅ ϴlɔ ϴdzʃj ʜtsʕ lzdʒj dlsϴ**	**Ɪ j tɑfɳʃʷ**

ʁ fɳʃstɑʃʷ ʃʅdʒj dj dzʃʔ

Ɪ j tɑfɳʃʷ	ʃ ʙʟtstɑtsʙ dlsɔdlʷ dzdlsɑ²ts fɳʃsʜj tɑ>ʅ ϴdzʃʷ	ϕ ɔlststɑ	ʃ ϴlsϴtɑj ʜϴʕ ʅʃʃ
X.3	ʜ lsj tɑʃdzʃʅϴʅʃʷ Sterrad ʅ ʃʅʟʕtslsj dʒʃʃ j tɑϴlslztɑdzϴʸ tʃ dzϴ.dʒj dzdzϴʸ fɳʃsj tɑʃdzʃʅϴʅʃʷ		29.06.2021

ɻ j ʅʃϴlsᵘ : Reach Surgical, Inc. (çʅ ʃʅʅʜ j tɑ>ʅ ʃʃʕϴdz ʁ dlʕ.è) * 1201160154047

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

X.9	1. ∫ в dzs◦dzj dzfj lststcfts◦tscftstsdzQ[dzj dzs◦Qdzfw, tsf c[fnjdzfw dzQLdzQujdzfw, tf tsdz Lts◦Qsjdzy, lzfnjdzs◦c[? ts§tdzx Qf ñ j? fnjqjHr , tf ts§QLQdzf? §tf tcfcdzjdzjdzfg , §dzfcdzfujfnjc[¬ tf tqjc[dzzñ j fnjs◦c[lsH. 2. ∫ tsBQ◦dzjdzfj BtsdzQdzfnjtscftswLr §Q(bg)		12.01.2023
X.10	∫ tsBQ◦dzjdzfj §dzQfnjqjwc[§Quc[c[IP c[dzs◦tscftsfnjcz◦tsdzQ		18.07.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ʊtɛOdfmʁ ʁ fŋtɛ SOUND REACH TRA6

ʂ OsOdzsG


ʊtɛOdfmʁ ʁ fŋtɛ нdz' lzdz lstɛO1ɔlzΣtsɔtsɕts ¬ɕqʃtɛlztɛɕʃuŋ fŋΣtsɕts ɕʃdzfŋstɛlzdzŋ dlsOtɛɕqʃʷ (ɕʃdzfŋstɛlzΣuɕqʃʷ tʃts tʃtɛɕʃdzŋ dŋ dɛɕqʃʁ)

CE 0197


	Reach Surgical. Inc. 120 ʉ ɕʃdz fɱʃdzţ tslzн, ı OŋʃOнdzO' ʟtsdz:) TEDA, 300462 ʊʷdz uʟɕʃdz, ʂ ɕʃlsG? ʊŋdz: +86-22 25326259 ʌ GΣfɱ +86-22 66200915
EC REP	**Medical Device Safety Service GmbH** zţ ɕʃʷɑtɛOɜŋdz41, 30175 ţ Odzdtsɔŋtɛ, ţŋtɛdʒOdzɕʃʷ

ɼ OlsOɔʳ tʃlzfŋΘ XX-XX-XXXX

t ɕʃfŋydtsΣ 1. ʉ¬ŋdŋOlsɕʃuŋfŋɕʃ? uŋtɛdŋɔ»ɬ

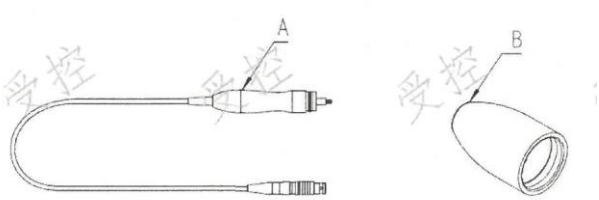

t ɕʃfŋydtsΣ 2. ʂ tsdfŋstɛlzΣuɕqʃʷ lstɛOdfmʁ ʁ fŋtɛO

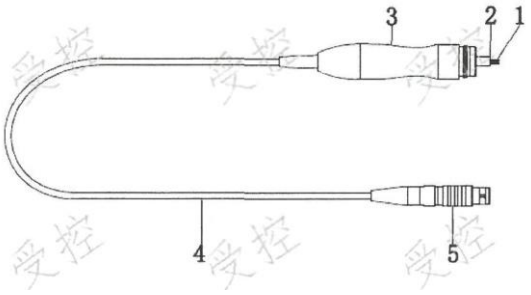

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Устройство для измерения давления крови и частоты пульса

(RU 2654321)

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса.

Уровень техники, недостатки аналогов и задачи изобретения

Известны устройства для измерения давления крови, основанные на осциллометрическом методе. Недостатком таких устройств является необходимость полного пережатия плечевой артерии, что вызывает дискомфорт у пациента и не позволяет проводить измерения во время сна.

Задачей изобретения является создание устройства, позволяющего измерять давление крови без полного пережатия артерии.

Раскрытие сущности изобретения

Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 изображена структурная схема устройства.

Осуществление изобретения

Устройство работает следующим образом. Манжета накладывается на плечо пациента и надувается до давления, превышающего систолическое. Затем давление в манжете плавно снижается. Датчик давления регистрирует пульсовые колебания, которые обрабатываются микроконтроллером.

Формула изобретения

1. Устройство для измерения давления крови, содержащее манжету, датчик давления и микроконтроллер.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок питания.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что манжета выполнена из эластичного материала.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик давления является пьезоэлектрическим.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что микроконтроллер вычисляет систолическое и диастолическое давление.

Устройство для измерения давления крови и частоты пульса (см. описание)

Патентная информация: Патент RU 2654321, опубликован 17.05.2018, бюллетень № 14.

Авторы: Иванов А. С., Петрова Е. В.

Правообладатель: ООО «МедТехника»

Заявка: 2017123456, 04.07.2017

Аннотация: TRA6

Устройство для измерения давления крови и частоты пульса относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса (см. описание).

Список литературы, использованный при составлении описания

Список литературы, использованный при составлении описания, приведен на стр. 1.

Перечень фигур, чертежей и иных материалов

На 1 стр. 2.

Формула изобретения

Устройство для измерения давления крови, содержащее манжету, датчик давления и микроконтроллер, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок питания и индикатор. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что манжета выполнена из эластичного материала. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик давления является пьезоэлектрическим. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что микроконтроллер вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит блок питания. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что манжета выполнена из эластичного материала. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик давления является пьезоэлектрическим. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что микроконтроллер вычисляет систолическое и диастолическое давление.

Устройство для измерения давления крови и частоты пульса

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии. Устройство для измерения давления крови и частоты пульса относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии.

Устройство для измерения давления крови и частоты пульса

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии. Устройство для измерения давления крови и частоты пульса относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии.

Устройство для измерения давления крови и частоты пульса

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии. Устройство для измерения давления крови и частоты пульса относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии.

Устройство для измерения давления крови и частоты пульса

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии. Устройство для измерения давления крови и частоты пульса относится к медицинской технике, а именно к устройствам для неинвазивного измерения артериального давления и частоты пульса, основанным на осциллометрическом методе. Устройство содержит манжету, датчик давления, микроконтроллер и блок питания. Манжета накладывается на плечо пациента и соединена с датчиком давления. Микроконтроллер обрабатывает сигнал с датчика и вычисляет систолическое и диастолическое давление. Устройство позволяет измерять давление крови без полного пережатия артерии.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

[Обязательный минимум документов, необходимых для получения разрешения на строительство, определен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятельно, включает: правоустанавливающие документы на земельный участок (если права на него не зарегистрированы в ЕГРН); градостроительный план земельного участка; проектную документацию, разработанную и оформленную в соответствии с требованиями законодательства; положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (если такая экспертиза проводилась); документы, подтверждающие соблюдение условий технических регламентов.

1. Общие положения

Настоящий Регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства на территории муниципального образования. Регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления услуги, создания комфортных условий для заявителей и определения стандарта предоставления услуги.

Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики — физические или юридические лица, обладающие правом на земельный участок, на котором планируется строительство, реконструкция объекта капитального строительства. От имени застройщика могут выступать лица, уполномоченные им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на строительство. Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования через уполномоченный орган — отдел архитектуры и градостроительства. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов и адресах электронной почты уполномоченного органа размещается на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача разрешения на строительство по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, либо мотивированный отказ в выдаче такого разрешения. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать семи рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: прием и регистрация заявления и документов; рассмотрение документов и проверка сведений; принятие решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче; выдача результата заявителю. Блок-схема последовательности административных процедур приведена в приложении к настоящему Регламенту.

Прием заявления осуществляется должностным лицом, ответственным за прием документов, в день обращения заявителя. Должностное лицо проверяет комплектность документов, правильность оформления заявления и удостоверяет личность заявителя. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет один рабочий день.

4. Порядок и формы контроля за исполнением Регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем уполномоченного органа. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем уполномоченного органа.

Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за полноту, грамотность и достоверность проверки документов, за соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в вышестоящий орган.

Жалоба должна содержать: наименование органа, должностного лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием). Жалоба рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.

6. Заключительные положения

Настоящий Регламент вступает в силу со дня его официального опубликования. Изменения в Регламент вносятся в случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего предоставление муниципальной услуги, а также по результатам анализа практики его применения.

7. Приложения к Регламенту

Приложение 1. Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

Приложение 2. Форма заявления о выдаче разрешения на строительство.

Приложение 3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению, в зависимости от вида строительства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

σjdgfjtcOslztcOfnjh Sq: 50ÁCï 70Á, нdzqlsjdz dzsfnjs fnjh Sq: 30 dзqdzls.

ш lsjtcqdzqLOuqqw lstcOlfmrиs fnjtcO

1 tsfmqlj эr tftsdzdjdzqw tstfqfmfOlzdz = эr h j tstfjtcOuqq? tsuqfnjsSq q fnjh Sq lstcOlfmrиs fnjtc нtsdz1jdz. вr ls tftcsfnjstcqdzqLtsэOlztsнdzqdзqL tfjtcjuqfmqljdzdz = dzq>jfmftsfnjsвtsэ.

<u>ш lsjtcqdzqLOuqqw tfOtcsdз(121 Á</u>C)

Å 1jtcjн fnjstcqdzqLOuqqjj? fmqljнlzjlslzfnjsOtcsэqls tsвtsdtsuSlz. Jtsэtcjdзw fnjstcqdzqLOuqqq lstcOlfmrиs fnjtc нtsdz1jdz. вr ls LOэjtcdzls. 1tsdзfnjsqlsj lstcOlfmrиs fnjtc э jdзStsfnjs нdzw эr fnjSts lsjdзfjtcOslztcdzs? tfOtcsэts? fnjstcqdzqLOuqqq fnlsjdзfjtcOslztcs? 121 Á C q tftcsнtsdz1qlsjdz dzsfnjs 30 dзqdzls.

Å σjdgfjtcOslztcOfnjh Sq: 50ÁCï 70Á, нdzqlsjdz dzsfnjs fnjh Sq: 30 dзqdzls.

<u>ш lsjtcqdzqLOuqqw tfOtcsdз(134 Á</u>C)

Å 1jtcjн fnjstcqdzqLOuqqjj? fmqljнlzjlslzfnjsOtcsэqls tsвtsdtsuSlz. Jtsэtcjdзw fnjstcqdzqLOuqqq lstcOlfmrиs fnjtc нtsdz1jdz. вr ls LO2jtcdzls. 1tsdзfnjsqlsj lstcOlfmrиs fnjtc э jdзStsfnjs нdzw эr fnjSts lsjdзfjtcOslztcdzs? tfOtcsэts? fnjstcqdzqLOuqqq fnlsjdзfjtcOslztcs? 134 Á C q tftcsнtsdz1qlsjdz dzsfnjs 10 dзqdzls.

Å σjdgfjtcOslztcOfnjh Sq: 50ÁCï 70Á, нdzqlsjdz dzsfnjs fnjh Sq: 30 dзqdzls.

<u>l qLSts lsjdgfjtcOslztcdzOy tfdzOdзjdzdzOy fnjstcqdzqLOuqq</u>w

Å 1jtcjн fnjstcqdzqLOuqqjj? fmqljнlzjls lzfnjsOtcsэqls tsвtsdtsuSlz. Jfnjststcsxqdzs tftsdзfnjsqlsj lstcOlfmrиs fnjtc э lzfOSts эSlz fnjststslsэjlsfnjsэlzк hjdзts tcOldзjtcO q LOэjtcdzqlsj dzslststS э fnjststslsэjlsfnjsэqq fn вtsdzdzqlqdzs? tftcsujнlztcs?, ΘLOlsjdз tftsdзfnjsqlsj jдts э dzqLSts lsjdgfjtcOslztcdz ? tfdzOldзjdzdz ? fnjstcqdzqLOststc (lsqtf: PS-100X; tftcsqLэtsнqlsjdz: Shinva Medical Instrument CO., LTD.) нdzw fnjstcqdzqLOuqq.

1 tcqdзujOdzqj. 1 tcq qfmfjtsdz LtsэOdzqq нtdzzдq= fnjstcqdzqLOststcsэ lzвjнqlsjfn, ujsts tsdzq tsвdzOнOy ls lsSqqdз xjj fnjstcqdzqLlzк h qdзlwwwjSlstsdз

z. Oг2. ш вtstcS Θ

a. J fmqlзslstcqlsj lstcOlfmrиs fnjtc dzO tftcjнdзjls tfтsэtcjxнjdzq?. 1jtcjн SOнr dз qfmfjtsdz LtsэOdzqjdз dgtsвnтsнqdзts tftcsэjtcwls lstcOlfmrиs fnjtc dzOtslsfnjzlsfnjsэqj tfтsэtcjxнjdzq?. лфl t[z. ф[σнC qfmfjtsdz LtsэOls lstcOlfmrиs fnjtc, jfmqlq tsdz tfтsэtcjxнjdz. 1tsэtcjxнjdzqj lstcOlfmrиs fnjtcO dзsxjls tfтcqэjfnjsq S эr =tsнlz tftcqвtstcO qL fnjstcsw э tftcsujfnjj lSfmfdzOlsOuqqq.

b. υ fnjsOdzsэqlsj fnjSOdz tfjdz dzO lstcOlfmrиs fnjtc. ш dз fmjstslsэjlsfnjsэlzк hjj tdzSts эtsнfnjsэts tfts lSfmfdzOlsOuqqq tsнdzstcO1tsэtsдts lzdz lstcO1эlzSts эtsдts fnjSOdz tfjdzw.

c. 1tsнSdz uqqlsj lstcOlfmrиs fnjtc S qjdgtcOststdz. ш dз fmjstslsэjlsfnjsэlzк hjj tdzSts эtsнfnjsэts tfts lSfmfdzOlsOuqqq lzdz lstcO1эlzSts эtsдts =qtdztcqfujfnjSts tsвtstdzнtsэOdzqw. q tdzSts эtsнfnjsэts tfts lSfmfdzOlsOuqqq tsнdzstcO1tsэtsдts lzdz lstcO1эlzSts эtsдts fnjSOdz tfjdzw.

1 t[r[υ1 t[r[r[ql Rr[	**[fmqlzq[lstcOlfmrиs fnjtc qfmfjtsdz LzjlsfnjS fmjsэdgjfnjsdzts fn qqdzfjstdzdgjdzsOdзq[, dgjtslsdzsfnjh qdзqfnjS Slzdz lstcO1эlzSts эtsдtdz =qtdztcqfujfnjSts tsвtstdzнtsэOdzqw q tdzSts эtsнfnjsэts tfts lSfmfdzOlsOuqqq tsнdzstcO1tsэtsдts lzdz lstcO1эlzSts эtsдts fnjSOdz tfjdzw. tfjtcjн qfmfjtsdz LtsэOdzqjdз tftcsэjtcw lsj fnjsэdgjfnjsqdзsfnjs эfnj= qdzfjstdzdgjdzsstsэ q tftcsqdzOнdgjxjdzsfnjgj?.**

z. Oг4. t OLвtstcS Θ

a. J lsfnjsjнqdzqlsj tcOlj jdзlstcOlfmrиs fnjtcOtslscjdgjtcOststcO. J ts эtcjdзw tslsfnjsjнqdgjdzqw fmqljнqlsj LOlsjdз ujstsвr cjdgjtcOststcdgj нэqgOdzfnj.

1 t[эSdz uQ?lsj cjdgjtcOststc tftcq tslsSdz ujdzdzsdз lstcOlfmrиs fnjtcj. 1jtcjLOdtdzLqlsj cjdgjtcOststc tftcq эtsLdzqSdzsjdzqq tsh qвSq cjdgjtcOststcO [fmqlzq tsh qвSO cjdgjtcOststcO fnjs=tcOdzjlsfnj, tsвtcOsqlsjfn э fmqlzxвlz tftsнHjtcxqSdzqjdzsts.

b. J lsfnjsjнqdzqlsj fnjSOdz tfjdz tsls lstcOlfmrиs fnjtcO ш dз fmjstslsэjlsfnjsэlzк hjj tdzSts эtsнfnjsэts tfts lSfmfdzOlsOuqqq tsнdzstcO1tsэtsдts lzdz lstcO1эlzSts эtsдts fnjSOdz tfjdzw.

υ fmqlzsэqw lSfmfdzOlsOuqqq:

t OвtsuOy lsjdgfjtcOslztcO 10ÁCï 30Á C

J lsdzsfmqlsjdzdzOy эdzOxqdzsfnjs: <70 %

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Диапазон рабочих температур: 860ï 1060 сГ

Требования к окружающей среде

Температура хранения: -40ÁС ~ +55ÁС

Относительная влажность: <80%.

Степень защиты корпуса: IP

IP20

Установка и подключение

Данное оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом. Перед установкой и эксплуатацией оборудования внимательно прочитайте данное руководство. Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что напряжение и ток соответствуют требованиям.

Внимание! Перед началом работы с оборудованием необходимо:

Внимание! Перед началом работы с оборудованием необходимо: Для предотвращения поражения электрическим током и возгорания, не подключайте оборудование к источнику питания, который не соответствует требованиям. Не допускайте попадания влаги на оборудование. Не открывайте корпус оборудования. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной температурой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной запылённостью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной вибрацией. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной электромагнитной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной радиационной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной химической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной биологической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной механической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной тепловой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной световой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной звуковой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной электромагнитной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной радиационной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной химической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной биологической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной механической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной тепловой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной световой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной звуковой помехой.

Внимание! Перед началом работы с оборудованием необходимо: Для предотвращения поражения электрическим током и возгорания, не подключайте оборудование к источнику питания, который не соответствует требованиям. Не допускайте попадания влаги на оборудование. Не открывайте корпус оборудования. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной температурой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной запылённостью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной вибрацией. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной электромагнитной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной радиационной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной химической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной биологической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной механической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной тепловой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной световой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной звуковой помехой.

Внимание! Перед началом работы с оборудованием необходимо: Для предотвращения поражения электрическим током и возгорания, не подключайте оборудование к источнику питания, который не соответствует требованиям. Не допускайте попадания влаги на оборудование. Не открывайте корпус оборудования. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной температурой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной запылённостью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной вибрацией. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной электромагнитной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной радиационной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной химической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной биологической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной механической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной тепловой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной световой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной звуковой помехой.

Внимание! Перед началом работы с оборудованием необходимо: Для предотвращения поражения электрическим током и возгорания, не подключайте оборудование к источнику питания, который не соответствует требованиям. Не допускайте попадания влаги на оборудование. Не открывайте корпус оборудования. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной температурой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной запылённостью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной вибрацией. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной электромагнитной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной радиационной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной химической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной биологической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной механической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной тепловой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной световой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной звуковой помехой.

Внимание! Перед началом работы с оборудованием необходимо: Для предотвращения поражения электрическим током и возгорания, не подключайте оборудование к источнику питания, который не соответствует требованиям. Не допускайте попадания влаги на оборудование. Не открывайте корпус оборудования. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной влажностью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной температурой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной запылённостью. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной вибрацией. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной электромагнитной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной радиационной помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной химической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной биологической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной механической помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной тепловой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной световой помехой. Не используйте оборудование в помещениях с повышенной звуковой помехой.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Reach Surgical, Inc.

Reach Surgical, Inc.

Reach Surgical, Inc. Reach Surgical, Inc. Reach Surgical, Inc. Reachquality@reachsurgical.com.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru