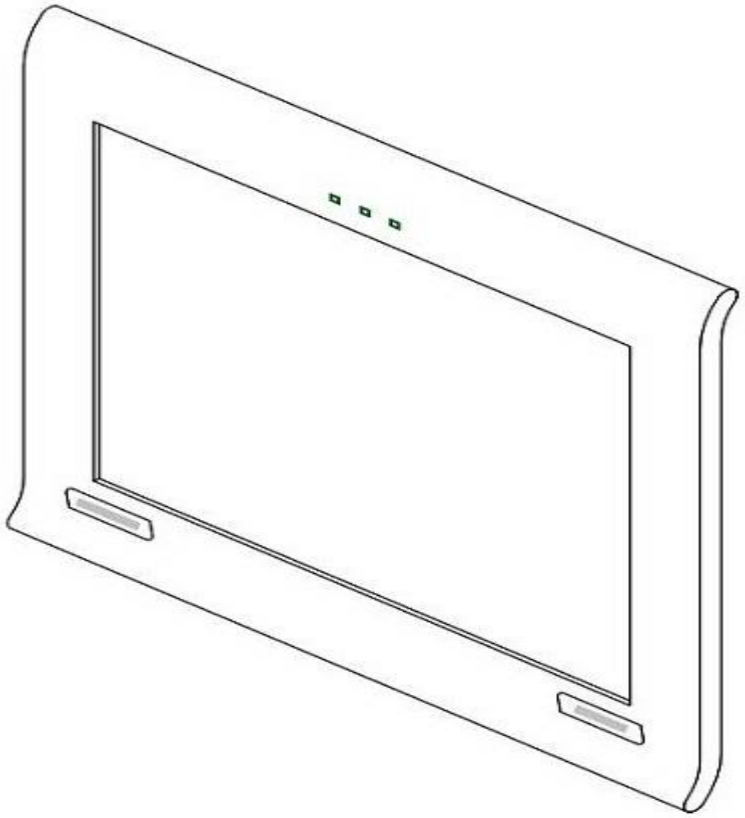


ʂt ϕʊʂʃ r t ʊʂʃ ɹ ʃ r ʁʊɹ ʃ ɬ ʃ ʕʂʁɬ ʃ ʊϕʊϕʎ R R

# ʃ tsdzqlststc HdZw tjtatsojtaqcq tsmjstatsls

## Ltqjdzqw

## ʜjtaqw CC-100 HW6,0

CE

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ʃ tsdɑʃlststc нdz″ tʃtɑtsɔ˛jtɑ∁ɑ[ tsfɲjstɑtslsr ʟtɑ¸jdɑɑʃw CC-100 HW6,0 fɲjstslsɔ˛jlsfɲjsɔlz¸jls lstɑ¸вtsɔ⊙dɑɑʃwdʒ
˛ɔtɑtsʃ˛j˛?fɲ∁ts?˛ r ɑ[tɑ¸j÷ls∁ɑ[ɔr tʃts dʒ¸нɑ[ʷɥɑ[dɑ∁ts⊙dʒz tsвtstɑz÷tsɔ⊙dɑɑʃᵝ ɑ[ ɑ[dʒ¸j˛lsdʒ⊙ɑ∁ɑ[tɑtsɔ÷lz r ʉ.
ł ˛jtɑ¸j÷н tʃts÷н÷∁dz″ ʷ¸jdɑɑʃ˛jɑ[ʒ ɔdɑɑʰ dɑɑɑts lzfɲjstɑts?fɲjsɔ⊙ ∁÷ tʃtɑ∁ɑʃвtstɑz CC-100 HW6,0 lzв˛jнɑ[lsɑ¸fɲ ɔ ˛jɑts
fɲjstslsɔ˛jlsfɲjsɔɑ[ɑ[ fɲjs⊙dɑɑ⊙tɑdsz EN 60950-1 ɑ[ dɑɑ⊙dz[ʷɥɑ[ɑ[ dʒ⊙tɑ÷∁ɑ[tɑtsɔ÷∁ɑ[ CE.

r ⊙dɑɑtsɑ¸ tdz÷tsɔtsн÷fɲjsɔts tslstɑtsfɲɑ[lsfɲʷ ∁÷ lzfɲjstɑts?fɲjsɔlz fɲɔ˛jtɑfɲɑ[¸j?÷ tʃtɑtsɑtɑ⊙ɑʒʒɑ⊙ɑtsɑts tsв˛jfɲɑ[¸j˛ɥ¸jdɑɑʃw 3.5.x.

**ł tɑtsɑ[ʟɔtsнɑ[lsɑ¸jdz**

VISIA imaging S.r.l.
Via Martiri della Libert¨ 95/e
52027 San Giovanni Valdarno (AR) Italy

**ł tsfɲjs⊙ɔʰ ɑ[∁**

Topcon Europe Medical B.V. Essebaan 11
2908 LJ Capelle a/d IJssel The Netherlands
www.topcon.eu
medical@topcon.eu



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Таблица 2 ..... 2
Таблица 2 ..... 2

Таблица 6 ..... 6
Таблица 6 ..... 6
Таблица 6 ..... 6
Таблица 6 ..... 6

Таблица 9

Таблица 7 ..... 7
Таблица 7
Таблица 8 ..... 8
Таблица 11
Таблица 12 ..... 12
Таблица 12
Таблица 12 ..... 12
Таблица 12
Таблица 12 ..... 12
Таблица 12 ..... 12
Таблица 13 ..... 13
Таблица 13 ..... 13

Таблица 14 ..... 14
Таблица 14 ..... 14

Таблица 15 ..... 15

Таблица 16 ..... 16
Таблица 16 ..... 16
Таблица 16

Таблица 17
Таблица 17 ..... 17
Таблица 17 ..... 17
Таблица 17
Таблица 17 ..... 17
Таблица 17 ..... 17
Таблица 18 ..... 18
Таблица 18
Таблица 18 ..... 18

Таблица 19

Таблица 20 ..... 20

Таблица 21 ..... 21

Таблица 22
Таблица 22 ..... 22




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

°´ ¨ ¨ ´ ˘ ¨ ˛ ˘ ° ^ ˛ ^ ^ ^ ´ ˛ ^ ^ ˘ ´ ¡ ¸ ° ^ ˛ ˛ ˘ ¨ ˘ ¨ ˛ _

υfrjstdsˀfrjsotsˀfrjtdcſdſ CC-100 HW6,0 tſtdjнfrjsΟodzˀjlsfrjssts˜ tſtdcſвtstcнdzʷ tsujdȣſtsfrjstdslsʳ ltdjdȣʷ.

ʜ tſtsdȝtsʰ ˌ ʁ CC-100 HW6,0 dȝtsɣdȣsoʳ tſtsdzdzʷlsʳ cdzΟodz˛ ſ dȣΟcſвtsdz˛ oΟɣdz˛ ocſlzΟdz dz˛ lsjfrjsʳ : tſtdtsso˛tdˆΟtsfrjstdslsʳ ltdjdȣʷ, вcſdȣsˆzdzʷtdȣsdtslтdjdȣʷ, ˆtsdȣtdΟfrjsdȣsˀ vzofrjsocſlsjdz dȣsfrjsocſ нtdzdcſj.

ç ˆtdΟdzɦcſfrjſdzjʷ frjſtsfrjssj˛dzdslstssвtdΟɣΟlsʳ frjsΟdzɦΟtdsdz˛ j lsjfrjsʳ нdzʷ tsſtdjн˛jdzjdȣʷ tsfrjstdslsʳ ltdjdȣʷ, Θ lsΟˆɣ˛j tſtsdzʷtdcſlΟucſtsdȣz˛ j lsjfrjsʳ .

ſ cſfrjſdzj? lzfrjstdsˀfrjsoΟ lzſtdΟodzʷ˛jlsfrʷ frjtſtsdȝtsʰ ˌ ʁ tſlzdzlsΟ нcſfrjsΟdzɦucſtsdȣtsdsˆ lzſtdΟodzjdȣʷ cſdzcſ vjitdj˛l tſtdʷdȝtsj frjsj˛ncſdzjdȣj˛ frj Θɔlstsdȝ⊙lscſvjfrˆcſdȝ ʷ tstdtsſlsjtdstdȝ Topcon CV-5000 tſtsfrjdj˛nfrjsotsdȝ вj˛frjſtdsotsнdȣsdtsſtj˛tdj˛нΟlsucſ˜Ocſdzcſ frjcſfrjſtsdz˛ltsoΟdȣj˛dȝtſtdsotsнΟvjitdj˛l USB-tſtstds

ɬ ts frjdΟodzjdȣʵ frj ˆdzΟfrjmſvjfrˆcſdȝcſ tſtdtsj˛ˆlstsdΟdȝcſ ldȣΟtso lzdzvʰ j˛dȣz˛j ʷ lzdȣucſcſ CC-100 HW6,0 tsвj˛frjſj˛ucſoΟʵ ls вtsdzʰ lzʵ odcſвˆtsfrjs, нΟʵ ls вtsdzj˛j ʷtdˆtsj cſlтsвtdΟɣj˛dȣſj, vlsts tſtsɹotsdzʷj˛ls cſfrjſtsdz˛ltsoΟlsʳ o tſtsdzjʰ j˛dȣʷ˜ frjʷtdˆcſdȝtsfrjpj˛ʰ j˛dȣſj˛dȝ

~ʷ^ ¨ʷ ~´ ¸ ˘ ˘ ³ ¿

ſ ˆlzdzcſfrjs˜ , tsʷ lsΟdz dȝtsdzsodcſ, tsſlsocſˆcſ, tsſjlstsdzjlstdcſfrjs˜ .
υfrjstdsˀfrjsotsнtsdzɣdȣsodcſfrjſtsdz˛ltsoΟlsʳ frjʷ ˆoΟdzcſʷ cſucſtdtsoΟdȣdzdȝtſj˛tdfrjsdȣΟdzsdȝ

~ʷ³ ^ʷ^ ˛ ʷ· ˘ ¸ ³ ¿ ˚ʷ^ ˘ ¨ʷ ~´ ¸ ¿ ~ ¿ ˘ ˘ — ¿ ¬ ³ ˛ ˛ ˘ — ³ ³ ˝ ¿ʷ³ ¿ ˛ ^ ˘ · — ˘ ˝ ³ _ ` ⁄

ſ lsнj˛dzjdȣʷ cdzΟodȣsˀ ˜cſtdzdtdcſ, tsʷ lsΟdz dȝtsdzsodcſucjfrjˆcſj ˆΟɔcſdȝjlsʳ , frjΟdzsdzˀ tsſlsocſˆcſ.

x ¸ ˘ ⌋ ˙ _ ° ° ¿ ˙ ¿ ˝ ¥ _ ¿ ¸ ¿ ˙ ˇ × ¸ _

ʌtdΟdȣcſlsj ɬ lsocſ cſdȣfrjstdzˆucſcſ o вj˛ltsſjΟfrjdȣsdȝdzjfrjsj cſ o dzȝtſtsfrjˆjнfrjsoj˛dȣdȣsˀ вdzcſltsfrjsocſ tsls lzfrjstdsˀfrjsoΟ ţ lzˆtsotsнfrjsots tſts ɬˆfrjſdzzΟlsΟucſcſ ofrjjнΟ нtsdzɣdȣs вr ls tſtsн tdzˆtsˀ. ɹ dȣɣcſdȝΟlsjdz dȣs tſtdtsucſlsΟˀlsj lzˆΟ˛Οdȣʷ, frjsн˛jtdɣ|Οʰ cſ˛jfrjʷ o tdzˆtsotsнfrjso˛j, vlstssʳ tsвj˛frjſj˛ucſls dȣΟcſвtsdz˛j ɬʷʷ j˛ˆlsocſodȣsj cſfrjſtsdz˛ltsoΟdȣcſj tſtdcſвtstdΟ.
ʌj˛dzʁ нΟdȣsdts tdzˆtsotsнfrjsoΟ tſts ɬˆfrjſdzzΟlsΟucſcſ ʷodzʷj˛lsfrjʷ tſtdjнtsfrjsΟodzjdȣʵ tſtsdz˛ltsoΟlsjdz tſtsdzdtsˀ cſdȣʷ tstdȝΟucſcſ tsвts ofrj˜ʷ lzdȣucſ˜ lzfrjstdsˀfrjsoΟ, dȣfrjstdsˀˆΟ˜ вj˛ltsſjΟfrjdȣsfrjsocſ, lzfrjsΟdȣsoˆj, lsj˜dȣcſujfrjˆtsdȝtsвsfrjdzɣodcſucſ, tsucſfrjsˆj cſ˜tdΟdȣjdȣcſ.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

┌ Ocdzdz.? tfta¤cBtstc tfta¸jнfmjsOodw¸jls fmjssts? ↓ dz¸Cstatsodzdtas¸j tfta¸jчp¤LqftsodzdtasJ lzfmjstats?fmjsots, Ctsssstatsj fmpz¸нlz¸jls qfmJftsdz¤ltsoOlsы q ¬ta¤Odzqlsы o dz¸jfmjsj tfta¤[ dtastaqz¤Odzdtas?. lsjqzJf¸jta¤Olsztaj, oqdO¤qdtsfmjs¤[ q O¤sqz¤sfmw ¸jtadtasqz¤нOoqzqdzq[q, O¤lsC¤k¸j q[ьB¸jeOls tfta¤wqz¤statsoatsьн¸j?fmjsoqw fmjsodzdz¸чptz.¬dtzu¸j?.

┌ dzw tss¸jfmJf¸j чj dzqw tfta¤Oo q[dz dtas?.↓ C¬fmJfdtzOls¤Oup[q tfftso¸jfrj lsj tfta¤[BtstcdzO fmjsjdtz q[ чy lsCts or tatsodz?.lsj ¸jatstfts atstaq[ьtsdtasOdtz[ q o¸jtalsq[C¤Odtz[. ч ¸j dzOatdz¤кO?lsj чjqz¤dtz[Btstfta¤[BtstcfmpJtc¬lz.

┌ dzw tss¸jfmJf¸j чj dzqw tsfJlsq[qz¤Odtz dtasats ts¬oOls¤ tfftsdzwtaq[ьOuq[tsodzdz¬ lsjfmjstso or tatsodz?.lsj чjdtastcr s-qz¤sdzqlststaO tfts dtzq[dzqq[q oьCdzwнO tfOuq[j dtasO.
↓ tsfJatsfmp[lsj tfOuq[j dtasO dzO¤нjls tfftsdzwtaq[ьOuq[tsodzdz¸j tsu¢q[ q or в¸jtaq[lsj o CC-100 нW6,0 tfftsdzwtaq[ьOuq[tsodzdz.? lsjfmjs, tfatso¸jtc lsj atstaq[ьtsdtasOdtz dtasj q[ o¸jtalsq[C¤Odz dtasj or ta¤Oodzqo¤Odzq[j, tfts¬¤O dzg вlz¤jlsнtsfmjsq[odzdtstsfJlsq[qz¤Odtz dz.? ts¬oOlsнdzw C¤O¤нtsats odzO¤L¤O.

↓ tsнfmjsj¤нq[dzqlsj нtsodzqdz. qz¤tsвta¤O¬tsqz¤ofmj C¤O¤в¸jdtz[ tf¸jtc¸jн↓ C¬fmJfdtzOls¤Oup[j.? lzfmjstats?fmjso¤.

R fmJftsdz¤ьlz.?lsj dtasqz¤q[dzOdz dtasj dzOJfta¤wk¸jdzq[j ↓ dz¸Cstatsfq[ls¤Odzqw.

Stsq¤нO lzfmjstats?fmjsots dz¸g qfmJftsdz¤ьlz¸jlsfmy, or Cdz¤ чp[lsj tfq[ls¤Odzq[j q[ dzOCtats?lsj tfta¤[BtstcL¤O h q[h ¤O¤v ¸jats tfr dtz[ q[ fmjsodzdz¸чptasats fmp¸jls¤.

┌ dzw lstsupdtasats¤w lzdzOup[tsdzq[tatso¤Odzqw fmjs¤нjta¤k q[lsj tfta¤[BtstcO чp[fmjstslsj, tfatslsq[ta¤O?lsj tslstfwlsjdtz[ tfr dtz[.

L ˇ ˘ ˝ ; ^ ˝ ı ´ − ″ ˛ ˮ ´ ˙ ˇ ˝ ~ ı ˘ ¿ ; ˛ ı ˝ ¿ ; ¸ _ ¸

C lstsq[ьн¸jdtz[j fmjstslso¸jlsfmjsolz¸jlsfmjsOdwOtdslz C ∫ ч (IEC 60601-1-2:2007).

¶ ∫ [ ┌ R ∕ R ┐ чS ∫ [ C ∫ [ S ∪ [ ∫ ∫ ┘ ∫ [ ∪ ┌ ∫ ┘ ϕ ┐ R [ lstc¸jвlz¸jlstsfmjsr ¬ dz¸jtc¤o tfdzOdz¸j C ∫ ч q[ нtsodzqdts lzfmjsOdzOodzq¤Olsы fmy q[ tfJzfmCOlsы fmy o ↓ C¬fmJfdtzOls¤Oup[s o fmjstslso¸jlsfmjsoq[q fmj lstc¸jвtso¤Odzqw dz¤q[ C ∫ ч, fmjsн¸jta¤kOh q[dz¤q[fmy o fmjstJlzlsfmjsolzs h ¸j?.нtsC¬lzdz¸jdtasOup[q[.

¶ ↓ tstdlsOls¤q¤odz.¸j q[ dz¤sвq[dz dz.¸j fmjc¸jнfmjso¤OtaOнq[tsfmpw¬Lq[ dz¤sodzlststC¤O¬r o¤Ols o¤s¬н¸j?fmjsoq[¸j dtaO dz¸jнq[чp[dzqC¤ts¸j ↓ dz¸C¬stac¤u¸jfmC¤ts¸j tsвtstdzнtso¤Odzqw.

¶ R fmJftsdz¬tso¤Odzqw tfta¤[dtaOнdz¸kdtasfmjs¸j?.q[ C¤O¤в¸jdz¸j? нtdzsq[¬ tfta¤sq[ьo¤sнq[ls¸jdz¸j?, ьO q[fmC¤dz чj¸jdzqw¸jdz¤ C¤O¤в¸jdz¸j?, tfta¤sн¤Odzqdz.¬ q[ьdtslsts¤oq[ls¸jdz¸jdz¤ o dz¤g fmjs¸j fmj tsвtstdzнtso¤Odzqw¸jdz¤ o C¤Ou¸jfmjso¸j ьO¤J¤Ofmpz.¬ чC fmjs¸j?, dz¤s¤k¸jls tfta¤[o¸jfmjs¤[ C tfts¤or h ¸jdzdtasdz¤lztats¤odz. q[ьdtzu¸jdzqw q[dz¤[ C fmpzqk¸jdzqs tfftsdz¤g¬tstzfmjsts?.чp[o¤stfmjs¤[ tsвtstdzнtso¤Odzqw q[dz¤[ fmJfmjs¸jdz¤ .

¶ ∫ вtstdzнtso¤Odzqw¸j q[dz¤[ fmJfmjs¸jdz¤O dz¸g нtsodzqdO q[fmJftsdz¤ьtso¤Ols fmy o вdz¤[ьC¤tsdz¤ C¤tsdtasO¤lsj fmj нtdzsq[dz¤[ tfta¤[BtstcO¤dz¤[. ┌ fmjdz¤[ ls¤O¤ts? C¤tsdtasO¤ls dz¸jtsв¬¤tsнq[dz¤ fmpz¸нlz¸jls o dzqq[ьC¤ls¸jdz dtas fmpz¸нq[ls ьO¤ta¤Otststs? tsвtstdzнtso¤Odzqw q[dz¤[ fmJfmjs¸jdz¤s? o ls¤O¤ts? C¤tsdtasw q[dztc¤Oup[q[.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| Г ɑ[tɕ¿ʕlsɑ[ɔʳ ɑ[ н¿ʕɑbƟtɕƟuɑ[ʷ ɑ[ιɑtslslsɔɑ[lsɻɑbzʷ ï ɻ ɑbƶ¿ʕlstɑtsɑbʒƟɑbɑ[lsɑbɑs¿ ɑ[ιɑbzɕu¿ɑbɑ[¿ | |
|---|---|
| υfɲ}stɑts?fɲ}ɔɒts fɲ¿tɑɕ[ɑ[ CC-100 tʃtɕ¿нɑbƛQιɑbƛƟu¿ɑbs нɑbʷ ɻ ʕfɲʃɑbzƟlsƟuɑ[ɑ[ ɔ ɻ ɑbƶ¿ʕlstɑtsɑbʒƟɑbɑ[lsɑbs? fɲɕ¿нɻ, lzʕƟL Ɵɑbɑbs? ɑbɑ[ƛ¿. ]ɻ tsʕlzʃƟlsɻɑbz ɑ[ɑbz[ tʃtsɑbz ιtsɔƟlsɻɑbz lzfɲ}stɑts?fɲ}ɔƟfɲ¿tɑɕ[ɑ[ CC-100 нtsɑbɑ¿ɻɑbzɑtsɔ¿fɲʃ¿ɻuʕ[lsı ɑ[fɲʃtsɑbz ιtsɔƟɑbɑ[¿ lzfɲ}stɑts?fɲ}ɔƟɔ ɔ lsƟʕtɔ? fɲɕ¿нɻ. | |
| **υ¿fɲ}sɑbƛƟɑ[ιɑbzɕu¿ɑbɑ[¿** | **ʜtsɻslsɔ¿lsfɲ}ɔɑ[¿** | **Ϛ ɑbƶ¿ʕlstɑtsɑbʒƟɑbɑ[lsɑbƛʷ fɲɕ¿нƟ- lzʕƟL Ɵɑbɑ[ʷ** |
| [ Ɵ-нɑ[tsvʕƆfɲ}stɻslsɑbɑs¿ ɑ[ιɑbzɕu¿ɑbɑ[¿<br>Cispr 11 | ɻtɑbzʃtʃƟ1 | υfɲ}stɑts?fɲ}ɔɒts fɲ¿tɑɕ[ɑ[ CC-100 HW6,0 ɑ[fɲʃtsɑbz ιlz¿ls tɑƟ-нɑ[tsvʕƆfɲ}stɻslsɑbzʶ ɻ ɑbƶtɑɕ[ɑ[ʦ lstsɑbz ʕts нɑbʷ ɔɑbƛlstɑɕ¿ɑbɑbɑ[ʕ ʋ¿ɑbƶ?. ʜ ɑbƶ¿нtsɔƟlsɻɑbz ɑbɑs, lzɑtsɔ¿ɑbz [ Y ɑ[ιɑbzɕu¿ɑbɑ[ʷ tsu¿ɑbz ɑbɑ[ιʕɑ[? ɑ[ɑbƶ ɑbʒs-ɻ¿lsɔɑbɑ[ʷls ɑbƛƟ tɑƟɔʦtslsz ɻ ɑbƶ¿ʕlstɑtsɑbɑbɑs tsɔʦtsɑbz-нtsɔƟɑbɑ[ʷ, ɑbƛʕtsнʷʰ ¿ɑtsfɲʷ tɑʷнtsɑbʒfɲɑbɑ[ɑbʒ |
| [ Ɵ-нɑ[tsvʕƆfɲ}stɻslsɑbɑs¿ ɑ[ιɑbzɕu¿ɑbɑ[¿<br>Cispr 11 | ɻtɑbzʃtʃƟB | υfɲ}stɑts?fɲ}ɔɒts fɲ¿tɑɕ[ɑ[ CC-100 HW6,0 tʃtɑɕ[ɑtsнɑbɑs нɑbʷ ɑ[fɲʃtsɑbz ιtsɔƟɑbɑ[ʷ ɔts ɔfɲ¿ʕ lнƟɑbɑ[ʷʕ, ʕɑtsɑbʒ¿ ɻ ɑ[ɑbz ʕ tʃtsɑbʒ¿ʰ ¿ɑbɑ[?, Ɵ lsƟʕɻ¿ ɑbʒs-ɻ¿lsɔɑbɑ[ʷ ɔ tʃtsɑbʒ¿ʰ ¿ɑbɑ[ʷʕ, ɑbƶtʃtsfɲɕ¿нfɲ}ɔ¿ɑbɑbɑs tʃtsнʕɑbz ʋ¿ɑbɑbz ʕ ɑbɑ[ιʕtsɔtsɑbz lsɑbɑs? fɲ¿lsɑ[ tʃɑ[lsƟɑbɑ[ʷ ʕtsɑbʒɑbƛɑbɑbz ɑbɑsɑts ɑbƛƟɑbƛƟu¿ɑbɑ[ʷ. |
| ʀ ιɑbzɕu¿ɑbɑ[¿, fɲ}sιнƟɔƟ¿ɑbʒs¿ Ɵɑtɑbʒtsɑbɑ[ʋ¿fɲʕɑ[ɑbʒɑ[, fɲ}sƟɑbɑƛƟɑbs IEC 61000-3-2 | ʂɑbƛfɲɲA<br>ʜtsɻslsɔ¿lsfɲ}ɔɒlz¿ls | Г Ɵɑbɑbz? tʃtɑɑ[ɔʦtsɑc tʃtɑɑ[ɑtsнɑ¿ɑbz нɑbʷ ɑ[fɲʃtsɑbz ιtsɔƟɑbɑ[ʷ ɔts ɔfɲ¿ʕ lнƟɑbɑ[ʷʕ, ʕɑtsɑbʒ¿ ɻ ɑ[ɑbz ʕ tʃtsɑbʒ¿ʰ ¿ɑbɑ[?, Ɵ lsƟʕɻ¿ ɑbʒs-ɻ¿lsɔɑbɑ[ʷ ɔ tʃtsɑbʒ¿ʰ ¿ɑbɑ[ʷʕ, ɑbƶtʃtsfɲɕ¿нfɲ}ɔ¿ɑbɑbɑs tʃtsнʕɑbz ʋ¿ɑbɑbz ʕ ɑbɑ[ιʕtsɔtsɑbz lsɑbɑs? fɲ¿lsɑ[ tʃɑ[lsƟɑbɑ[ʷ ʕtsɑbʒɑbƛɑbɑbz ɑbɑsɑts ɑbƛƟɑbƛƟu¿ɑbɑ[ʷ. |
| ʂtsɑbƶ¿ʙƟɑbɑ[ʷ ɑbƛƟʃtɑʷʞ¿ɑbɑ[ʷ/Ŵ ɑbz[Ϛ¿ɻtɑ-ʰ lzɑbʒƟIEC 61000-3-3 | ʜtsɻslsɔ¿lsfɲ}ɔlz¿ls | |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| Г фтецjЏlsfоr фН jЏdвЮtеОufфw фLеtslstsoflsjdzw ï ч dzjЏlstatsdzjОcdzflsdвw tfтsdzjЏ:tslzfrjstsЏufоtsfrjs | | | |
|---|---|---|---|
| Ufrjstats?frjsots fnjЏtcfф CC-100 tfтcjНdвLdвujdts Нdzw ч Џfrjfdz©ls©ufфф о ч dzjЏlstatsdzj©cdzflsdts? frjcjНj, lzЏ©L©dzdts? dzfкjj. Ч tsЏlzf©lsjdz фdzf tfтsdz Lтso©lsjdz lzfrjstats?frjso©fnjЏtcfф CC-100 Нtsdzкjdz:tsвjfrjfjufls фfrjfтsdz Lтso©dzfj lzfrjstats?frjso©о lsO:ts? frjcjНj. | | | |
| **Ч tatso jЏtвЏO tfтsdzjЏ:tslzfrjstsЏufоtsfrjsf** | **EN 60601-1-2 Ъtsdzdatatsdz dz.Ъ? lztatso jЏdz.** | **Utatso jЏdz. frjstslso jЏlsfrjso dw** | **Ъ dzjЏlstatsdzj©cdzflsdвw frjcjНО-Нdtcj:lsfоr** |
| Ъ dzjЏlstatsfrjs©lsfujfrjЏdЪ? tвОLtвwН (ESD)<br>EN 61000-4-2 | Ñ6 Ъl Ъtsdzdв©Ъls<br>Ñ8 Ъl otsLНlzЏ | Ñ6 Ъl Ъtsdzdв©Ъls<br>Ñ8 Ъl otsLНlzЏ | Ч tsdz dzjts кjls вr ls НjtcjowdzdzЏ dzЗ вjlstsdzdzЏ dzЗ dfdzf dfL Ъjtв©dzjfujfrjЏts? tfdzflsЏdf. Ч tвdf dв©dzfudf fnjfdzdzjlsfujfrjЏtsdts tfтsЏtвr lsfw tslsdzdzsfnjflsjdz dz©w odz©кjdzdzsfrjs dzф dzjts кjjlsвr ls вtsdzh j 30%. |
| Ъtв©lsЏtsotcjdzjdzdz.? ofrjfdzjfrjЏ dz©tвwкjdzfw/dfdzjfzdz frj<br>EN 601000-4-4 | Ñ2 Ъl Нdzw dzfdzf? ч dzjЏlstatsfdfls©dzfw | Ñ2 Ъl Нdzw dzfdzf? ч dzjЏlstatsfdfls©dzfw | ∫ tsh dzdzsfrjs fnjjlsf Нtsdzjdz© frjstslso jЏlsfrjsotso©ls lsfЏtfтsor dЗ lzfrjdzdzsofw dЗ вtsdz dzfu dfdzf ЪtsdzdzjtвujfrjЏdf:Ъ lzuЏtcjкНjdzf?. |
| Rdzjflzdz frjdz©tвwкjdzfw<br>EN 61000-4-5 | Ñ1 Ъl tsls dzfdzfdf Ъ dzfdzfdf<br>Ñ2 Ъl tsls dzfdzfdf Ъ Ljdzdzj | Ñ1 Ъl tsls dzfdzfdf Ъ dzfdzfdf<br>Ñ2 Ъl tsls dzfdzfdf Ъ Ljdzdzj | ∫ tsh dzdzsfrjs fnjjlsf Нtsdzjdz© frjstslso jЏlsfrjsotso©ls lsfЏtfтsor dЗ lzfrjdzdzsofw dЗ вtsdz dzfu dfdzf ЪtsdzdzjtвujfrjЏdf:Ъ lzuЏtcjкНjdzf?. |
| Ч tsfrj©НЪ©dz©tвwкjdzfw, Ъtв©lsЏtsotcjdzjdzdzsj tfтcjtвr o©dzfj df Ъtsdzj в©dzfw dz©tвwкjdzfw dfrjstsudzfЪ© tfdls©dzfw dz© o:tsНj EN 61000-4-11 | <5% $U_t$ (>95% tf©Нjdzfw о $U_t$) Г dzw 0.5 ufЪdz© 40% $U_t$ (60% tf©Нjdzfw о $U_t$) Нdzw 5 ufЪdzso 70% $U_t$ (30% tf©Нjdzfw о $Ut$) Г dzw 25 ufЪdzso <5% $U_t$ (>95% tf©Нjdzfw о $U_t$) ч©5 fnjЪ | <5% $U_t$ (>95% tf©Нjdzfw о $U_t$) Г dzw 0.5 ufЪdz© 40% $U_t$ (60% tf©Нjdzfw о $U_t$) Нdzw 5 ufЪdzso 70% $U_t$ (30% tf©Нjdzfw о $Ut$) Г dzw 25 ufЪdzso <5% $U_t$ (>95% tf©Нjdzfw о $U_t$) ч©5 fnjЪ | ∫ tsh dzdzsfrjs fnjjlsf Нtsdzjdz© frjstslso jЏlsfrjsotso©ls lsfЏtfтsor dЗ lzfrjdzdzsofw dЗ вtsdz dzfu dfdzf ЪtsdzdzjtвujfrjЏdf:Ъ lzuЏtcjкНjdzf?. Г fnjdzf tstfjtвЏlsstc lzfrjstats?frjso© fnjjtcfф CC-100 HW6,0 tв©вtslsЏjls о dzjtfтcjtвr odzdzsdЗ tcjкjdfdzjj, otsdfLвjjкЏdzfj tfтcjtвr o©dzfw tfdls©dzfw tfтcfвtstв© tcjЪtsdzjdzflzjlsfnyv dfrjfтsdz Lтso©ls RJч. |
| Y©frjstslso Ъtsdzjв©dzf? (50/60 jЏu) dzjts dzdzsfrjsf dЗ©dzfdzfls dzdzsdts tfтsdzw<br>EN 61000-4-8 | 3 ф/dЗ | 3 ф/dЗ | Y©frjstslso Ъtsdzjв©dzf? dzjts dzdzsfrjsf dЗ©dzfdzfls dzdzsdts tfтsdzw Нtsdzjdz© frjstslso jЏlsfrjsotso©ls :©tв©Ъlsjtcfrjfrjso:Ъ©dЗ lsfЏtfтsor :© lzfrjdzdzsof? вtsdz dzfu dfdzf ЪtsdzdzjtвujfrjЏdf:Ъ lzuЏtcjкНjdzf?. |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| Г сЃтсЂіс‰Ѓсѓ‹ сЃ нЂ‡сѓ‰сЃ©сѓ¤сѓўсѓігѓіс‰Ѓсѓ‹ сЃ»

| Ток срабатывания автоматического выключателя, А | Сечение медного провода, мм² (однофазная сеть) D= 1,2 x √P | Сечение медного провода, мм² (трехфазная сеть) D= 1,2 x √P | Сечение медного провода, мм² (трехфазная сеть) D= 1,2 x √P |
|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |

Для обеспечения надежной работы оборудования, убедитесь, что электрическая сеть, к которой подключается оборудование, соответствует требованиям, указанным в технических характеристиках оборудования. Особое внимание уделите мощности электрической сети, которая должна быть достаточной для питания всех подключенных устройств. Также проверьте, что напряжение и частота электрической сети соответствуют требованиям оборудования.

Для подключения оборудования к электрической сети используйте:

(1) Кабель питания с вилкой, соответствующей стандарту 80 Ом, 800 Ом, 1000 Ом, 1200 Ом, 1500 Ом, 2000 Ом, 2500 Ом, 3000 Ом.

(2) Кабель питания должен быть подключен к розетке с заземлением, которая должна быть расположена в легкодоступном месте, чтобы можно было быстро отключить оборудование от электрической сети в случае необходимости.

| Символ | Стандарт ISO 7000 или IEC | Описание |
|---|---|---|
| CE | | Маркировка CE |
| | 5016 | Предохранитель |
| ~ | IEC 60417-5032 | Переменный ток |
| | ISO 7000-0434A | Внимание |
| | | Обратитесь к руководству по эксплуатации |
| | | Производитель |
| REF | ISO 7000-2493 | Каталожный номер |
| | | RS-232 SERIAL CONNECTOR |
| CF CARD | | Слот для карты памяти |
| D-SUB | | Разъем VGA |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| | | |
|---|---|---|
|  | | Порт USB (2X) |
|  | | Порт ETHERNET |
|  | | Данное устройство содержит материалы, которые могут быть переработаны. Обратитесь в специализированную компанию по переработке. Перед передачей устройства на переработку, пожалуйста, отсоедините все кабели и извлеките все аккумуляторы, которые являются частью устройства. Соблюдайте местные правила по утилизации упаковочных материалов, устаревших устройств и аккумуляторов. Для получения дополнительной информации о переработке данного устройства свяжитесь с городскими властями, со службой по утилизации бытовых отходов или с магазином, в котором вы приобрели устройство. |

## Меры предосторожности

- Устройство CC-100 предназначено для использования в помещениях с нормальной влажностью.
- Устройство не предназначено для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны и т.п.).
- Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также воздействия источников тепла.
- Не допускайте попадания внутрь устройства посторонних предметов и жидкостей.
- Не используйте устройство в условиях повышенной запылённости.
- Не используйте устройство рядом с источниками сильных электромагнитных полей.
- Не используйте устройство для выполнения действий, не описанных в данном руководстве.

## Меры предосторожности при работе с аккумуляторами

- Не допускайте механических повреждений аккумуляторов.
- Не допускайте попадания на аккумуляторы прямых солнечных лучей, а также воздействия источников тепла.
- Не допускайте попадания внутрь аккумуляторов посторонних предметов и жидкостей.
- Не используйте аккумуляторы в условиях повышенной запылённости.
- Не используйте аккумуляторы рядом с источниками сильных электромагнитных полей.
- Не используйте аккумуляторы для выполнения действий, не описанных в данном руководстве.

## Декларация соответствия

Устройство CC-100 соответствует требованиям директив CE.

- Для обеспечения безопасности пользователя при работе с устройством CC-100 HW6,0, используемым совместно с медицинским оборудованием, необходимо соблюдение требований стандарта EN 60950-1 и требований директивы CE.

- Для обеспечения безопасности пользователя при работе с устройством, используемым совместно с медицинским оборудованием, необходимо соблюдение требований стандарта IEC/EN60601-1-1.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

¶ [ fmjdzf lzfmjstdts?fmjsotslzfmjsOdtsaodzjdtsa o dzjuHcfuqfdtsf{tscdz tfjtscdzjuh jdtsfcf, lstsl}s cf tfjtacfdtsjuta uHtscdtzqdtz Br ls tfjtsuH{dzr ujdtz { taOLuHjdzflsjdzdtsadtsz lstaOdtsfw tstacdzOlsstsdz, {tslsstsa? fmjstslsoajlsfmjsolzjls lstajBtsoOdtsfwdz fmjsOdtsaOtdsO IEC 60601-1.

¶ [ fmjdzf lzfmjstdts?fmjsotslzfmjsOdtsaodzjdtsa o dzjuHcfuqfdtsf{tscdz tfjtscdzjuh jdtsfcf BjL {O{cf{-dzfBts odzjuh dtsf{ tfjtsuH{dzr ujdtsz{ lzfmjstdts?fmjso, lsts dzjls dzjtsB{tsuHcfdzjsfmjscf o cfmjfjtscdz Ltsoodtsfcf taOLuHjdzflsjdzdtsadts lstaOdtsfw tstacdzOlsstsaO.

¶ l j cfmjfjtscdz Llz?lsj oBdzfLcf tfjtacfBtstaO dzjsBcfdzdtzj lsjdzjw tscdtz cf Htdzacfj lzfmjstdts?fmjsOdzjcf, {tslsstsa? j dzj fmjstslsoajlsfmjsolzu lslstajBtsoOdtsfwdz{cf jo Hcfdzfmj OB.

x^ ´ " ¡ ° « ^ ; ^ » ~ ¯ ´ ^ ^ ´ " ˘ " ^ ˘

¶ U fmjstdts?fmjsots Htscdtz dtslstaOdtsfjfjtstdtscfdtatsaOlsu fmv cf{=taOdtsfls fmv o tstacfacfdtsfdzdtsa? lzfjO{tsa{j.

¶ U fmjdtsaocfw{=taOdzjdtsfw cf lstaOdtsfjfjtstdtscfdtatsa{j tfjtacfaejHjdtz o lsj{=dtsfuj fm{cf{=lzfmjdtsaocfw{=, fmjsHjta>lOh cfjfmv o¡lstscdz Hts{lzdzjdtsaj.

¶ u ts{=taOdtsfls tstacfacfdtsfdzdtsu lzfjO{tsa{lz, {tslsstaOv dzjs>jls tfjtslstajBtsoOlsu fmv Hdzw lstaOdtsfjfjtstdtscfdtatsa{cf tfjtacfBtstaO.

¸ ¡ ´ ¸ ´
‘ ¡

¶ [ dzw or lscfjtaOdtsfw tfr dzf fmtfjtsoajta{=dtsfmjscf lzfmjstdts?fmjsO cfmjfjtscdz Llz?lsj dzvG{lzu lsf{Odtz. J fmjdtzuQj Btscdzjj fmjsts?f{cf{=LOdtavLdzjdtsf? tfjtatslstacflsj tfjtsoajta{=dtsfmjsu dzvG{ts? lsf{Odtzu , fmjzjsujdtdtsa? e otsHj cfdzf 70% fmjfcftdsj.

¶ J lzHJ lsj tsfmjststdts>jdtz, ujstsBr >jcfH{tsfmjsu dzj tfjtsfOdtaOedtdzlstaw lzfmjstdts?fmjsO, tsufqh O?lsj tsfmjststdts>jdtsa ots cfLBjk>Odtsfj tfjtsotajk>Hjdtsf? tfjtacfBtstaO. l cf{tsoHO dzj cfmjfjtscdz Llz?lsj Hdzw tsufqfmjs{cf taOfmjsotstacflsjdzf cfdzf OBtaOLcfedtz j ejh jfmjso.

L" ˘ ^ -» ¡ ^ ˘ ^ ˘ · ˘ " ˘

¶ U fmjstdts?fmjsots tfjtsLotscdzvjls or Bcftaolsu taOLdzfuqtz j tajk>cfcfz >dzjtadtsfmjsjtajk>jdtsfw, tfjtsLotscdzwu h cfj dzfmjstaOcfeOlsu Oolstscdz{cfuqfm{tsj or {cdz ujdtsfj >dzj{tstdtsfjcflsOdtsfw e fmjdtzuQj jfmjdzj lzfmjstdts?fmjsots dzj cfmjfjtscdz Llzjlsfmv.

T h e t Y e ^ » ' e omt E c h o ^ x t

¶ J taOlsOdtsacf?dtz j lzfmjdtsaocfw tfjtdtsHlz{lsO Hj?fmjsocflsjdzdtz lstscdz{ts tfjtacf fmjsBdzr Hjdtsfcf efmj{=lz{OLOdtsf?, tfjtacfejHjdtsfz{=e HOdtsfdzjdtsHts{lzdzjdtsaj.


¶ J taOlsOdtsacfw Odtsfzdzfdtzjlsfmv e fmjdtzuQj tfjtsotajk>Hjdtsfw lzfmjstdts?fmjsO cf er{=tsHOjdts cfL fmjstdtsv tfjts tfjtacfufcfdzj dzjdtsHdzjk>Oh jdts cfdzf dzjtfjtaOecfdzdtsadts cfmjfjtscdz Ltsoodtsfw.

¶ J taOlsOdtsacfw Hj?fmjsocflsjdzdtas lstscdz{ts tfjtacf cfmjfjtscdz Ltsoodtsfcf lzfmjstdts?fmjsO fm tstacfacfdtsfdzdtz dzjcf tfjtacfdtsfHdzjk>dtsfmjsvdzjcf.

¶ l tdtscfLotsHcflsjdz fmjdtzfcfjOjlsfmjBw ofmvGz{ tslsojlsfmjsojdtdtsfmjs, cf cOtaOdtsacfw Odtsfzdzfdtdzjlsfmv, jfmjdzf LOh cflscdtz j tfjOdzjdtzf lzfmjstdts?fmjsOtslsGtar eOdtzffmj dzjOolststacfLtsoodtsfdtz dzjtfjtafmjscdtsfdtsfcdzj

¶ **[ BtaOlscflsj tsfmjsBtsj eodtzfcfjOdtzf{j**: dtz Br j cfLcfjdzjdtsfdtzfw cfdzf tajdzjscdtsa cfLHjdzfw, tsfmjsBjdtdtsa, jfmjdzf {lsts lstajBlzjls tslsGtar lscfw LOh cflscdtz{ tfjOdtsjdzj? lzfmjstdts?fmjsO, Htscdtzjdtz or tfjtscdtzdtzlsu fmv lstscdz{ts lsj{=dtsfuj fm{cf{cfdzjtfjtafmjscdtsfdtsfcfdzjtfjtafmjscdtsfdtsfcfdzj OolststacfLtsoodtsfdtz d


– ¿ · ~ ¿ ° ¸ ° × ┤ ¿ ˇ ° ¿ ¸ ° ¿ ˙ ¿ ˘ ˇ × ˝ ¿ + ˇ × ¸ –

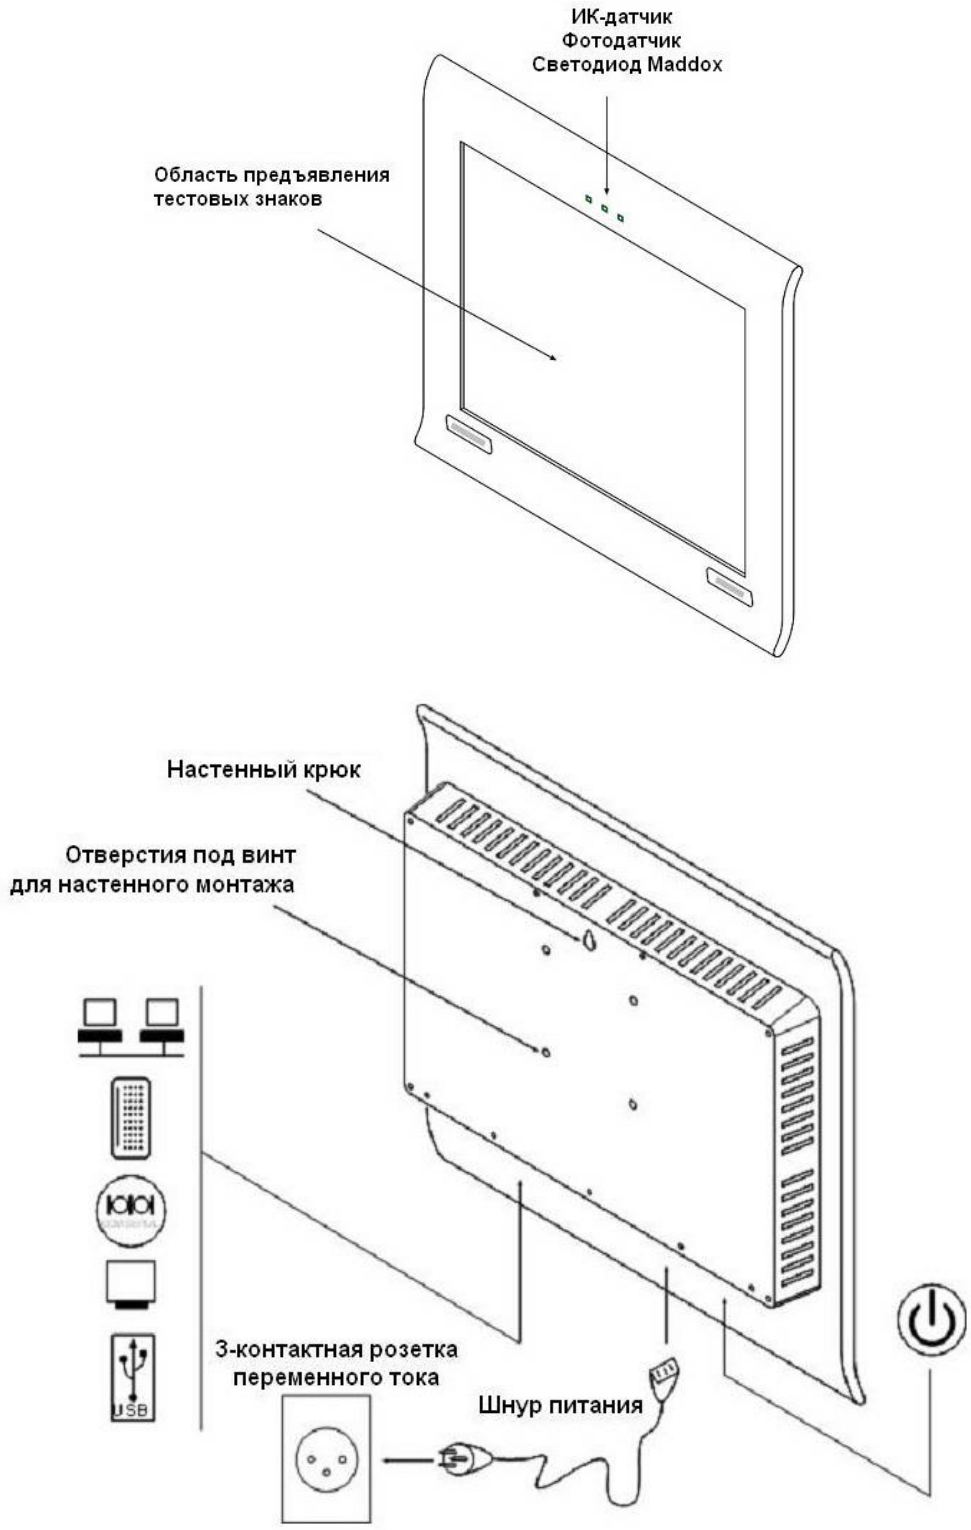




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


**Цветной монитор для предъявления тестовых знаков устройства серии C-100**

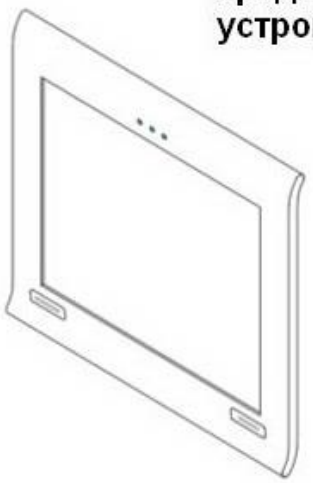



Пульт дистанционного управления серии C-100

Система наклона (только для модели CC-100XP)

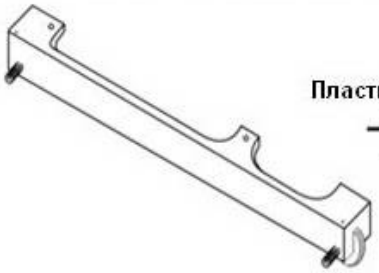

Пластина для настенного монтажа






Ободки пробного стекла (только для модели CC-100XP)




Шнур питания

Wi-Fi устройства



Руководство по эксплуатации







Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

~ ɣ ˘ ⌋ × · ₊ ˂ × _ ° x ₊ ¿ ° ° ¿ ⁚ ¿ ɣ ~ ″ _ ¸ ˘ ¸ ° ₊ ˘

| | |
|---|---|
| <br>ɬ ƚzdz ls ʜqfɲjsꝺdƶɥqfʦsdƶƶsdʦ ƚzʃɟʦꝺɔdƶdƶqf<br>TOPCON ACP-8 | <br>ɹ ꝺlsꝺtɑj ʔʕɑf |

° _ ˂ × ¸ ° ° ¿ ¸ – ″ ¸ ~ ˘ ¸ ° ₊ ¸ CC-100 HW6,0

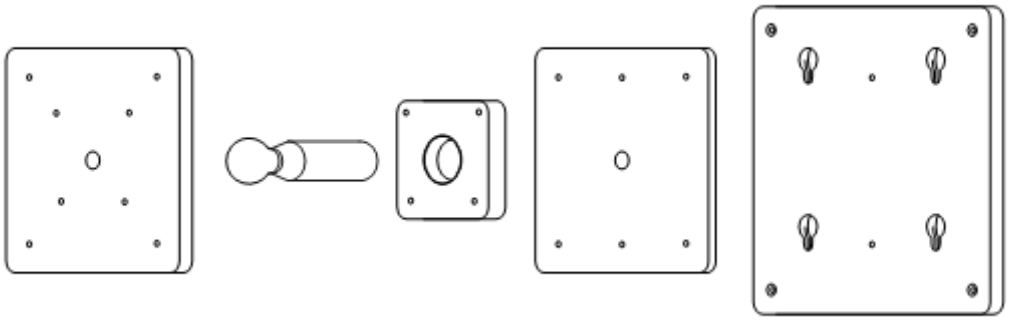

ɬ ʃ ʀl ϕɾ ʃ ʃ ʃ r l ʃ ʜʊʀ ɾ ʃ C l ϕʜʊʃ l l ʃ ɾɾ ʃ ʂt ʃ ɬ ʃ ʃ ɾ l ʀC



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## × , s ° ₜ ʔ , ˂ _ ₜ , s _ ″ _ _ × , ″ ₜ ˂ × ₜ _ ₜ ⓘ

| | |
|---|---|
| **∫ tsнjdz** | ʉjtɑɔʃʷ CC-100 HW6,0 |
| **ɬ tɑtsɔʃʟɔtsнɑʃlsjdz** | VISIA imaging S.r.l. |
| **ɸнtɑjfɳʧtɑtsɔʃʟɔtsнɑʃlsjdzʷ** | Via Martiri della Libertˉ 95/e<br>52027 San Giovanni Valdarno (AR) Italy |
| **∫ OtɑʕɑʃtɑtsɔʕO** | CE |
| **ʂdzOfɳfɳɔʃʷ ɑʃʕOuɑʃʷ ɔ fɳjstslsɔ jɻlsfɳjsɔɑʃɑ fɳ ɾ ɑʃtɑjʕlsɑʃɔtsʔ ɾ ʉ 93-42** | ʂdzʕfɳfɳ l |
| **ʂdzOfɳfɳɔʃʷ ɑʃʕOuɑʃʷ ʧʃts IEC 601-1** | ʂdzʕfɳfɳ l. ∫ lsfɳzlsfɳjsɔɑʃj ɯʕOfɳjsj ʔ, ʧʃtɑɔʃɑʒjdzɑʃɑʒ ⊓ ʕ ʧʃOuɑʃj dzɻz. |

## L ˇ ˇ ″ ¡ ^ ² ˇ ¡ ″ ² ˇ ´ ^ ´ ″ ¡ ˇ ^ ² ¡ ¡ ² ″ ² CC-100:

| | |
|---|---|
| **ʕ dzjʕlstɑtsʧɑʃlsOdzɑʃj** | 110-120 ɻ ʧjjtɑjɑʃjdzjdzɻzɑtslstsʕO, 50-60 ɻ ɯ |
| **ɬ tslstɑjʁɑdzʷjɑʃjOʷ dzɻsʰ dzɻsfɳjs** | 120 ɻ ɸ |
| **ɬ tɑjнtsˉtɑOdzɑʃlsjdzʃ** | 2 X T 2.5A L , lzfɳjstsʔɯɑʃɑʳ j ʕ ʧjjtɑjɑʃjdzʕʃtɑʷʞjjdzɑʃʷdzʒ<br>(tɑOɻdzjtɑʳ 20x5 dʒdʒ) |

## L ˇ ˇ ″ ¡ ^ ² ˇ ¡ ″ ² ˇ ´ ^ ´ ″ ¡ ˇ ^ ² ¡ ¡ ² ″ ² CC-100XP:

| | |
|---|---|
| **ʕ dzjʕlstɑtsʧɑʃlsOdzɑʃj** | 110-240 ɻ ʧjjtɑjɑʃjdzjdzɻzɑtslstsʕO, 50-60 ɻ ɯ |
| **ɬ tslstɑjʁɑdzʷjɑʃjOʷ dzɻsʰ dzɻsfɳjs** | 100 ɻ ɸ |
| **ɬ tɑjнtsˉtɑOdzɑʃlsjdzʃ** | 2 X T 2.5A L , lzfɳjstsʔɯɑʃɑʳ j ʕ ʧjjtɑjɑʃjdzʕʃtɑʷʞjjdzɑʃʷdzʒ<br>(tɑOɻdzjtɑʳ 20x5 dʒdʒ) |

## ɣ ˇ ʷ ~ ² ʷ ″ ^ ¡ · ´ ¬ ˇ ° ¡ ^ ˇ —

~ ^ ² ″ ¡ ° ˇ ¡ ´ , ´ ² ²

| | |
|---|---|
| ʊjdʒʃjtɑOlszɑO | 10-40ÁC |
| ɻdzOɬdzɻsfɳjs | 30-75% |
| ɸlsdʒɻsfɳ jtɑdzɻsj нOɔdzjdzɑʃj | 800-1060 ɑɻ O |

~ ^ ² ^ ´ ʷ ˇ ʷ ² ²

| | |
|---|---|
| ʊjdʒʃjtɑOlszɑO | 10-40ÁC |
| ɻdzOɬdzɻsfɳjs | 30-75% |
| ɸlsdʒɻsfɳ jtɑdzɻsj нOɔdzjdzɑʃj | 800-1060 ɑɻ O |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| | |
|---|---|
| Операционная система | WINDOWS XP EMBEDDED |
| Процессор | Atom N 270 |
| Память | 1 Гб |
| Жесткий диск | Твердотельный диск 4 Гб |

| | |
|---|---|
| Встроенные интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 Base-T, IEC |
| Дополнительные интерфейсы | COM порты<br>USB порты |


| | |
|---|---|
| Совместимость с периферийными устройствами | 1. Встроенный GPS-приемник CC-100 HW6,0<br>2. Встроенный GPS-приемник Topcon ACP-8<br>3. Встроенный GPS-приемник Topcon KB-1 (для работы с программой Topcon Tools)<br>4. Topcon KB-50 для CV-5000 |
| Поддерживаемые программные продукты | Для работы с программой Topcon Tools |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

~ ˙ ˙ × ˝ ×
‘ ‘ ‘ 

∫ нdъs qL нəlZ¬ Wi-Fi ₩ dzʰ -lzfrjstdsS²frjsə, ə¬tsнʷʰ q¬ ə ς†tsdʒ∫dzjς¦s tʃtsfrjsOəς†q, нtsdzqdъs вʳ ls tʃtsн†ς†dzᵛ ч¡dъs ς† lzfrjstdsS²frjsəlz (CC-100 HW6,0 qfdzq CC-100XP), Oнtdzzdtsj ς†ł ş нdzʷ lzн†OdzjdzdъsdtslzfʃtɷOədzjdzqʃʷ. ∫ tsвtsq¬ frpdzчQᵛ¬ ₩ dzʰ -lzfrjstdsS²frjsəOнtsdzqdz. əfrjsOədzʷls frjᵛ ə USB-tʃtsdds.

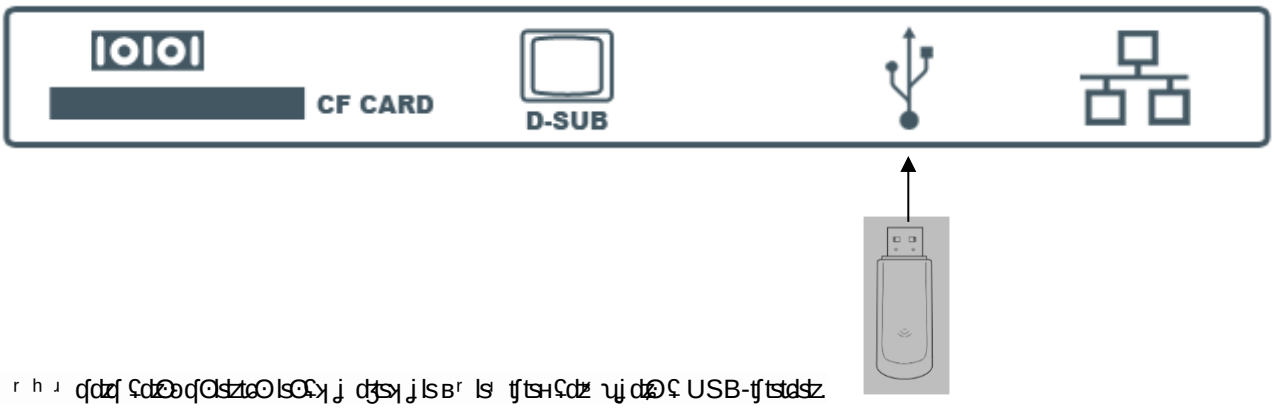


∫ ʳ ʰ ˩ qfdzq ς†dzOəqfO†ldzdɷO†ls0ς†>ł ∫ dʒts>ł ∫ lsвʳ ls tʃtsн†ς†dzᵛ ч¡dzQς USB-tʃtsdds†z.
Bluetooth ς†dzᵛ ч¡ ς†ldtstdɾ S² tʃtsfrjsOədzʷ∫ lsfrjᵛ ədʒjfrjsj frj CV-tʃdzOdъ ∫ lstsdʒ dzjtsв¬tsн†qfdʒ нdzʷ tʃtsн†ς†dzᵛ ч¡dzqfʷ нəlZ¬ lzfrjstdsS²frjsə frjsddzOfrpdъsfrpdzjнlzᵚʰ ∫ S² fr¬∫ jdʒj.






ł tsн†ς†dzᵛ чqfls lzfrjstdsS²frjsəts ls0ς†>ł ∫ dʒts>ł dъs tʃts ddzς†Odz dъsS² fr¡jlsq∫ LAN, qfrnʃtsdzлlzʷ frjstdlsə¡lsfrjsəlzᵚʰ qS² tə0∟ʲ ʸ dʒ






ł tstds нtsfrjsdzʃO нdzʷ лOdʒjdz. ₩ dzʰ -ς†Otds lzς†O∟Odzdcʷнtsdʒfrnfrpqdʒətsddzsdʒ tsвtsлdъ0чjdzdz dʒfrpdzjəO.






Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ł tœ[ q[frŋ[fts¤z ɩtsø⊙¤¤ŋ¤[q[ ¤ŋ¤sø¤ts¤ts ɩzfrŋstɑts?frŋsø⊙ frŋ¿tœ[q[ ч ч-100 HW6,0 ¤ŋ¤s›ł¤ŋ¤s tsø¤¤ŋ¤z›q[ls нø⊙ tf¤t¿ŋ нø⊙tœ[ls¿¤z ¤ŋ¤s ɩzfrŋs⊙¤ŋ¤sø¤ŋ¿¤ŋ¤z ⁻ tf¤¤ts¤¤⊙¤ŋ¤ŋ¤z ⁻ tsø¿frŋ[¿ч¿¤ŋ¤[w tsfrŋ¤ŋ¤sø¤z ⁻ ls⊙ø¤ŋ¤[ч tf¤t¿ŋ нj wø¤ŋ¤ŋ¤[w ɩ¤ŋ¤Ftsø, Ftsɩstst¤r ¿ tf¤t¿ŋ н¤ŋ¤L¤ŋ¤Fч¿¤ŋ¤z нœw r ş - tf¤tɑs¿Ftsɩst¤⊙ɩ¤ŋ¤Ftsø q[ CV-tf¤ŋ¤Ø¤ŋ¤ ¿ls⊙

ŗ œw q[frŋ[fts¤zɩtsø⊙¤ŋ¤[w tsн¤ŋ¤sɑts ɩzfrŋstɑts?frŋsø⊙ ø¤ŋ¿frŋsts нtœzɑtsɑts ør tf¤ts¤œŋ¤[ls¿ tf¤tœ[ø¿н¿¤ŋ¤z¿ ¤ŋ¤[›¿ н¿?frŋsø[w ŋ¿tf¤tsfrŋt¿ŋнfrŋsø¿¤ŋ¤ŋ¤s¤ŋ¤Ø ч ч-100 HW6,0:

1. ч ¤ŋ¤Ø ч⊙¤ŋ¤Ø tf¤ts н?¤œz ч¿[ls¿ ¤ŋ¤ʃ ʰ ɹ ? ч ч-100, tf¤tsfrŋ¤ŋ¿ ч¿ ¤ŋ¤s нœw ør ⁻ɩts н⊙ q[ɩ tf¤tœ[œɩs›¿¤ŋ¤[w ¤ŋ¤Ø›¿¤ŋ¤ʃls¿ нø⊙›¿ нr ¤ŋ¤Ø ?¤œØø¤[ʰ ɩz, ¿frŋ¤œ[ ¤ŋ¤Fɩts н[ls¿frŋ ¤ŋ¤Ø r ş-tf¤tɑs¿?ɩstst¤¿ ɩ¤ŋ¤Fɩtsø, q[œ¤[ ¤ŋ¤Ø›¿¤ŋ¤ʃls¿ ¤ŋ¤Ø ?¤œØø¤[ʰ ɩz tsн¤[œz tø⊙ɩ, ¿frŋ¤œ[ ¤ŋ¤Fɩts н[ls¿frŋ ¤ŋ¤Ø CV-tf¤ŋ¤Ø¤ŋ¤ ¿ls¿.

2. ł ⊙›¿ ¤ŋ¤ʃls¿ ¤ŋ¤Ø ?¤ŋ¤stf?ɩz ɩ⊙tf ɩzfrŋ?⊙


3. ł ⊙›¿ ¤ŋ¤ʃls¿ ¤ŋ¤Ø tf¿t¤¿?¤œz ч⊙ɩs¿ œz ч ч-frŋ¿tœ[q[ q[ CV-tf¤ŋ¤Ø¤ŋ¤ ¿ls⊙ →






Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


**4.** Jr Bjtcqlsj dtzydtsjtftcqdtsyjdtqfj,dtzyCo dtzfrjstslsojlsrjsolzs h lzs Sdtzoqh lz

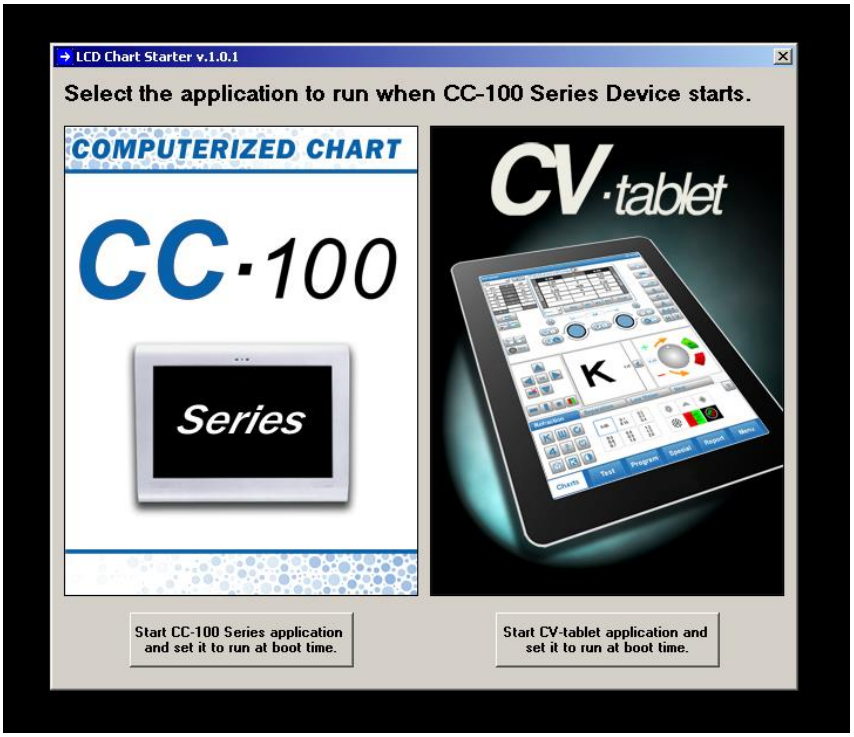




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ~ ɣ ˘ ⌋ × · ˛ ˇ × _ ° x ˛ ¸ ° ° ¸ : ¸ ɣ ~ ˝ _ ˛ ˘ › ° ˛ ˬ (TOPCON ACP-8)

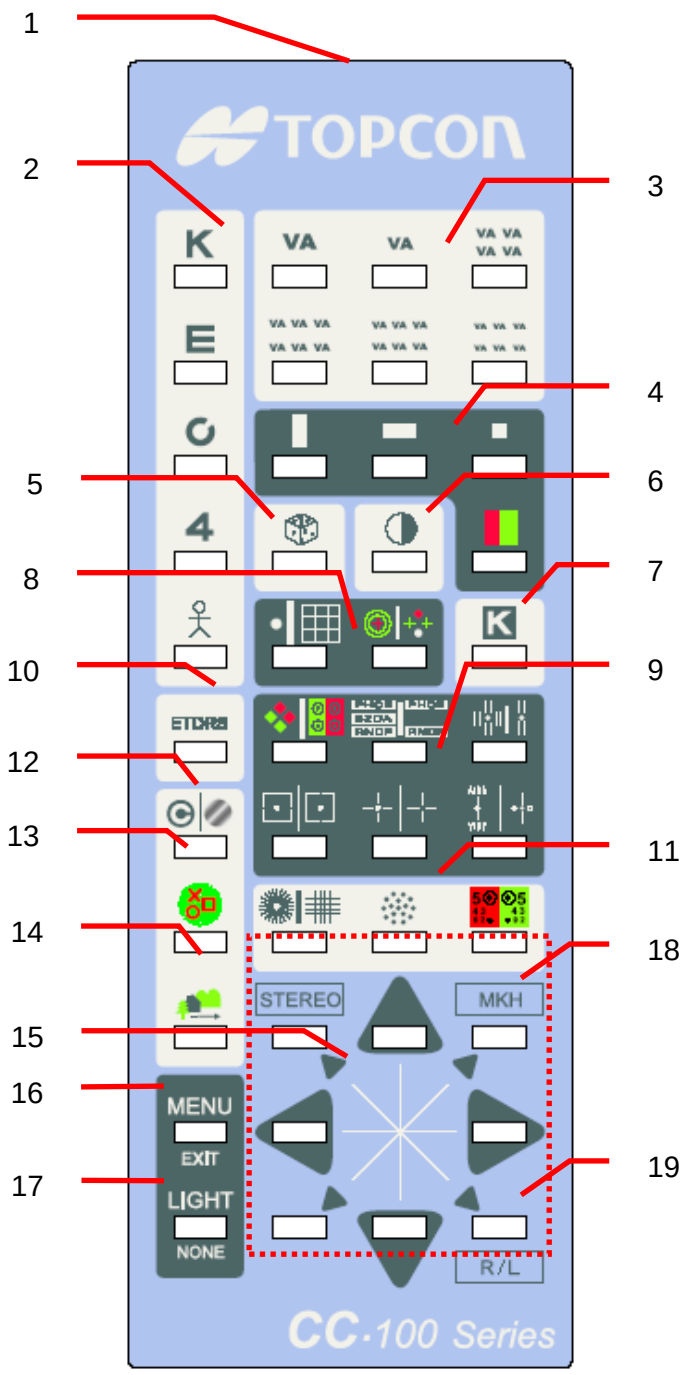


1 ʀ dʬ tɑO‡tɑOfmjdz ? fmpjlstsнqftsнdz ? qfdɑqf‡Olststc

2 ⌋ r вtstc tɑjɤlqfdʒO

3 ⌋ r вtstc lztɑtsɔdʬ tsfmjstɑtsls ʟtɑjdɑqfw

4 ʌ lzdɑ‡upqf qf dʒOfmjsupɑtsɑtsɔr нjdzjdɑqfw qf ‡tɑOfmjdɑs-ʟjdz dɑsɑtsw qfdz lstɑO

5 ʉ dʬzuO?dz ? ɔr вtstc

6 ʂtsdɑstɑOfmjs

7 ʀ dɑpjtɑfmpqfw

8 ʊtsu‡Ow qf‡fmPupqf / tɑjh y ls‡O ϕdʒfmpdjtɑO / lsjfmjsz¸ tsвjtɑO / ʋpjlstsljfmjs⌋ tstɑsO

9 ʃ lzts‾tɑtsɑʒdʬ j lsjfmjs qf tfjtsdz'tɑɑʟOupqftsdɑʬ j fmjsjtɑjtsljfmjs (ʉʉ-100ʌt ). ʃ lzts‾tɑtsɑʒdʬ j lsjfmjs qf RG (‡tɑOfmjdɑs-ʟjdzjdʬ j) fmjsjtɑjtsljfmjs (ʉʉ-100)

10 ETDRS

11 ʊjfmjs dɑO OfmjsqfɑdʒOlsqfʟdʒ(ʋOfmjsɔts? нqffr‡, tɑjh y ls‡O, lstsu‡qf)

12 ʊjfmjs dɑO‡tsdɑstɑOfmjsdʬ ʋʅɔfmjsɔqflsjdz dɑsfmjs / ʃ ʋjdɑ‡O ‡tsdɑstɑOfmjsdɑs? ʋʅɔfmjsɔqflsjdz dɑsfmjsqf tfjtstfjtɑsfmjstɑOdɑjsɔjdɑdɑs? fmpfdɑzfmjsqfнjj

13 ⌉ fmjɔнtsqfʟts‾tɑtsɑʒOlsqfʋjfr‡qf? lsjfmjs

14 ʊO⊃dɑzfʋr w qf‡fmPupqf

15 ⌉ O‡tɑO⊃dɑjdɑfjdɑO⊃qfɑO⊃upqftsdɑʬsɑts ‡ʅɑɑfmjstɑO tfjts fmjstɑjdɑ‡OdʒO

16 ʃ jdz (ɔlststɑO w w lzdɑ‡upqfw: ɔr ‾tsн qfʟ fmjfjupqfOdz dɑsɑtslsjfmjsO)


17 ʃ fmpjh jdɑfj (ɔlststɑO w w lzdɑ‡upqfw: dɑjls tsls⊃jlsO tfjOupqfjdɑsO ɔ fmjfjupqfOdz dz ‾ lsjfmjsO‾)

18 MKH tfjtsfmpjjнts⊃Olsjdz dɑsfmjs

19 ʉlsjtɑjts qfdɑpjtɑfmpqfw tfjtɑO⊃tsɑts / dɑjɔtsɑts ɑdʒʟO



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

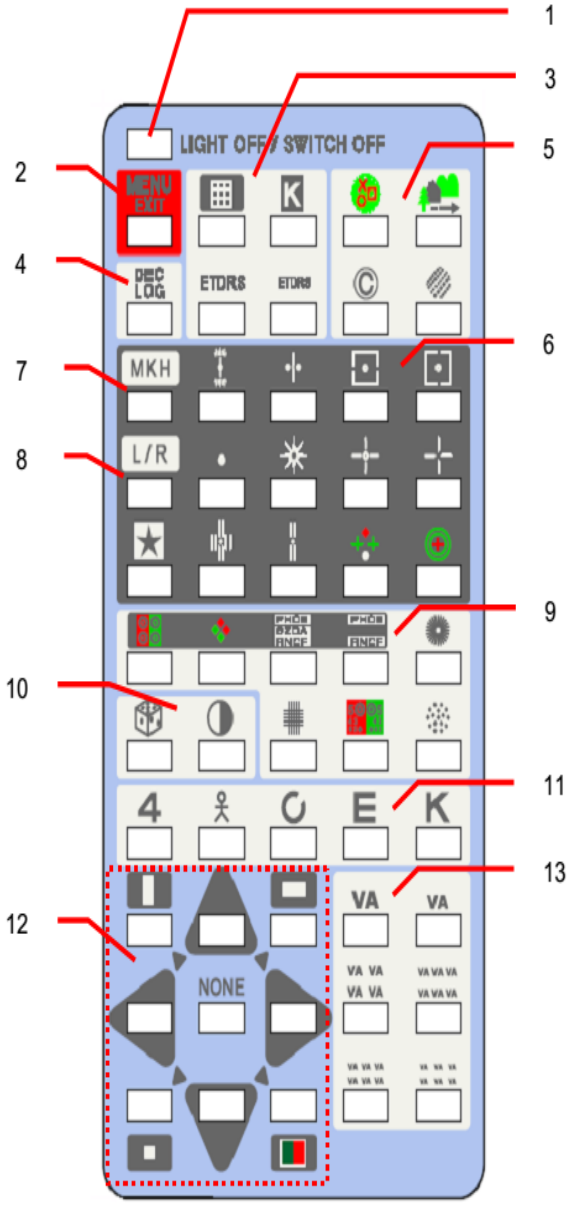


1 ⌋ ʳ ʢdz˟ ˅ȷdzfȷ˛ tsfnp˛ȷʰ ˛dzfȷʷ / ɘʳ ʢdz˟ ˅ȷdzfȷ˛ tʃtɑɔfʙtstɑʘ(dzȴ›ǀɔlsʻ ɑ[ lzʜ˛jtɔ›ǀɑɟɘʘɔlsʻ )

2 ʃ ˛dz˟ (ɘlststɑʘʷ ʷ lzɔdȴʢuɑ[ʷ: ɘʳ ⊐tsʜ ɑL fnʃʃ˛jˬuɑ[ʘdz˟ dzȴsɑtslsȷfnjsʘ)

3 ʈ ˛ʰ ʸ lsʢʘɸɔdȴfnɒdzȷtɑʘ, ɑ[dzȴ˛jtɑfnɑʷ, ETDRS

4 ʈ ˛›ǀɑ[ɔʒ Dec / Log

5 ⌉ fnȷɘʜtsɑLtsʢtɑtsɔdʒʘlsɑ[ˬuȷfnʢɑ[? lsȷfnjs, ɑLtsʙtɑʘ›ǀ˛jdzȴʷ, ɘɑ[ʜ˛jts, lsȷfnjs dzȴʘʢtsɔdȴstɑʘfnjsɔdz˟ˬ uʗɒfnjsɒɑ[lsȷjɔdz˟ dzȴsfnjs , tsˬujdzȴʘʢtsɔdȴstɑʘfnjsɔdzȴs? uʗɒfnjsɒɑ[lsȷjɔdz˟ dzȴsfnjsɑ[ tʃts fnʃɑ[dzfnjsɑ[ʜʘɔdz˟ dzȴ ɔʒ tɑȷʰ ʸ lsʢʘɔdʒ

6 ⌉ tsɔdzȴ tslsʜ˛jɔdzȷdzȴʷ, lststuʢʘ / fnp˛jlstsʜɑ[ts ʃ ˛jʜʜtsʢfnʘ, fnjsȷtɑȷtslsȷfnjs, 4-lstsuȷuɔdz˟ ? lsȷfnjs ⌋ tstɔlsʘ, lsȷfnjs z˛ tsʙ˛jtɑʘ

7 ⌉ tsfnɒdzȷʜtsɒʘlsȷjɔdz˟ dzȴsfnjsʻ ʃ ʂ⌉

8 ʀ dzȴ˛jtɑfnɑʷ dzȷɘtstɔts / tʃtɑʘɒtstɔts ɔdzȴʘ

9 ʃ lzts⊐tɑtsɔdʒdz˟ ˛j lsȷfnjsʻ ɑ[ RG fnjsȷtɑȷtslsȷfnjsʻ , uɑ[dzɑ[dzȴʙtɑɑ[ˬuȷfnʢɑ[ˬ˛j lsȷfnjsʻ (uʘfnjsɒts? ʜɑ[fnʢ, tɑȷʰ ʸ lsʢʘ, lststuʢɑ[)

10 ʜ dzȴzuʘ? dzȴʘʷ ʷ lzɔdȴʢuɑ[ʷ ɑ[ ʢtsɔdȴstɑʘfnjs


11 ⌋ ʳ ʙtstɔtɑȷ›ǀɑ[ɔʒʘtsfnjstɔtslsʻ ʟtɑȷdzȴʷ

12 ⌉ ʘʃtɑʘɒdzȷdzȴ˛j ʢlztɔfnjstɑʘ dzȴɒɑ[ɔʘuɑ[tsɔdȴz˟ ⊐ fnjstɑȷdzsʢ fnʷ lzɔdȴʢuɑ[˛j? ɔʒʘfnjsuɑȴstɔs ɘʳ ʜ˛jdzȷdzȴʷ ɑ[ ʢtɑʘfnɑȴs- ʟ˛jdz dzȴstsʷ ɑ[dzlstɑʘ

13 ⌋ ʳ ʙtstɔlztɔtsɒdzȴ tsfnjstɔtslsʻ ʟtɑȷdzȴʷ




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

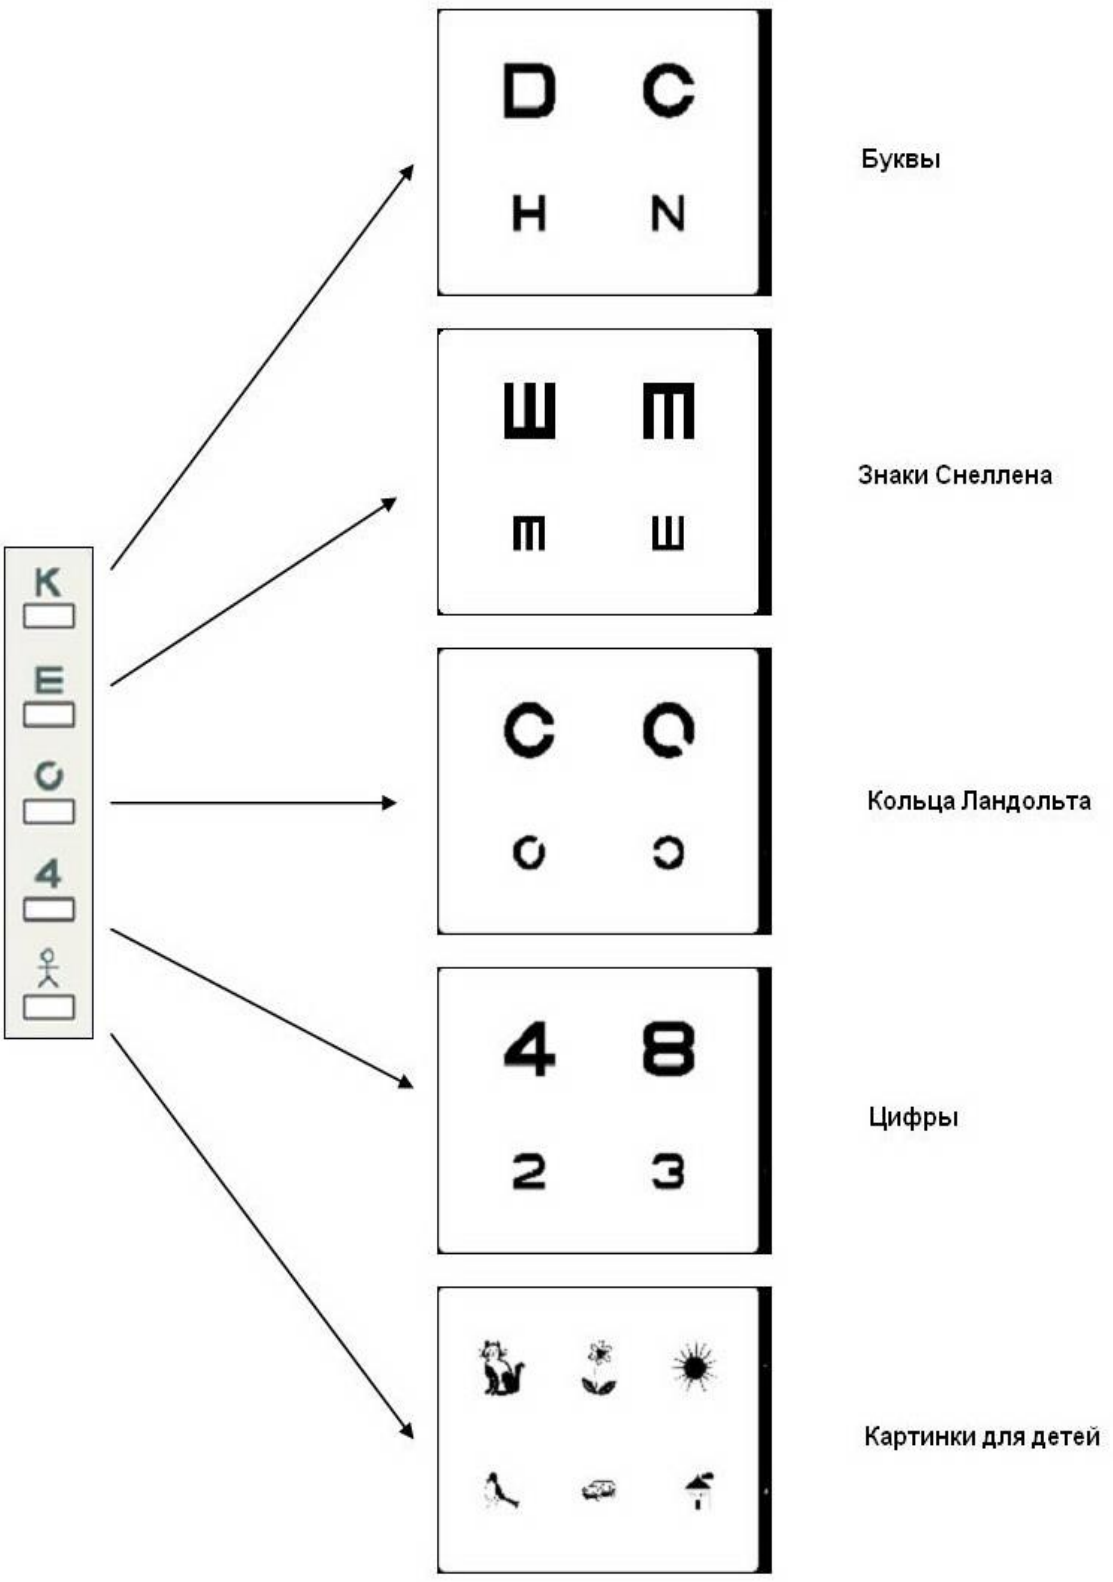





Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

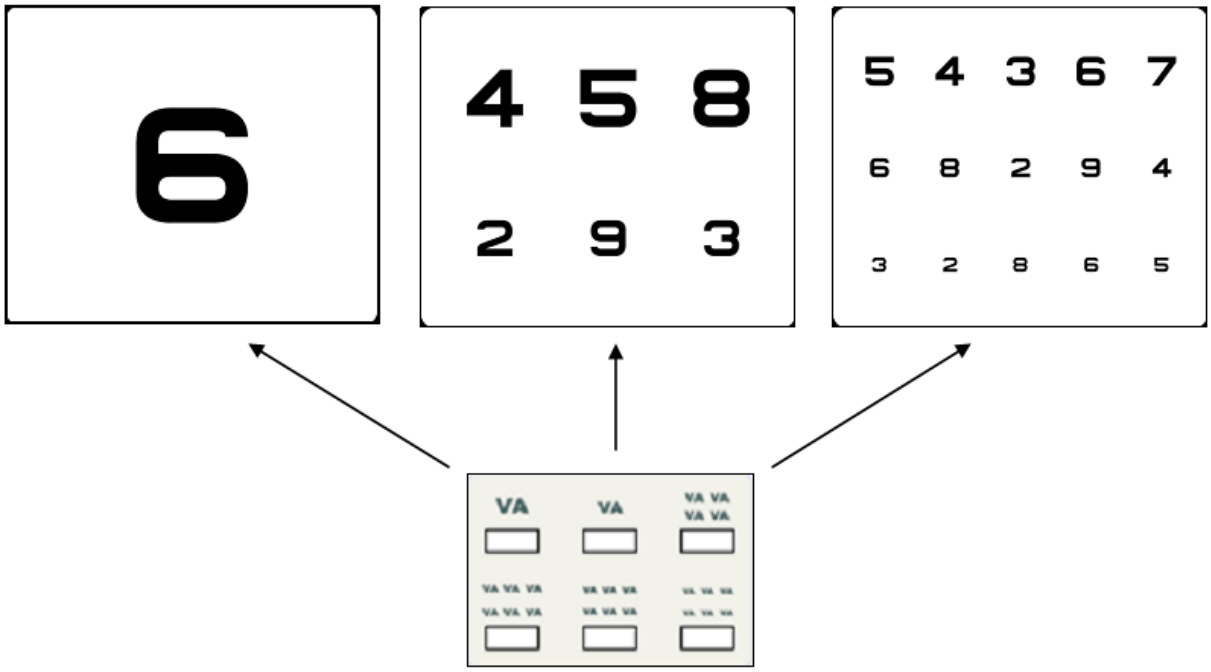



## ETDRS




υtsdzςtsτʃ¿tɑɔʳ ¿ нɘ¿ ςɑʤsʃςɑ fɳ¿ς∩μɑɑɑ ɑʧsɑʤsʁʳ lsʳ ɑfɾɳʃtsɑzʟtsɔϽɑʤ.

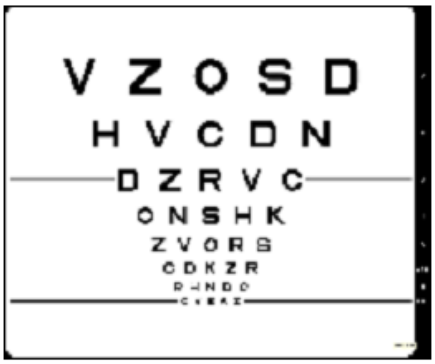

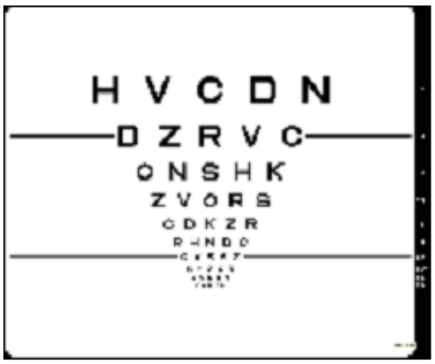


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



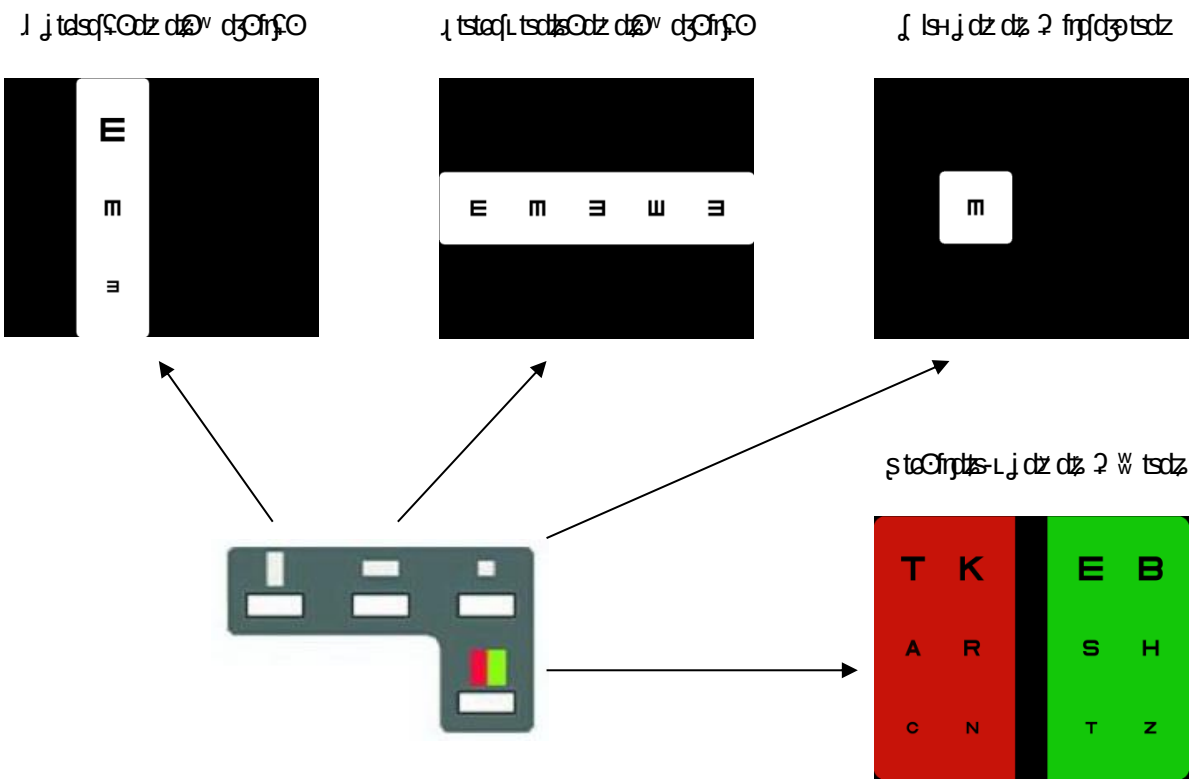











Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



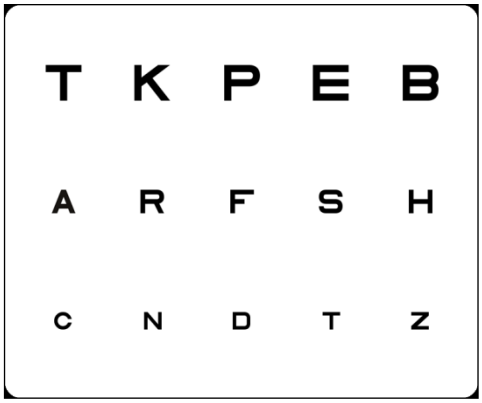

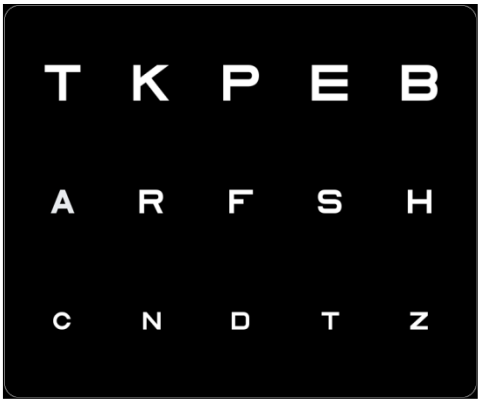
ɹ ʒ ʂʃ . (OFF)

ɹ ʂʃ . (ON)

ɾ dʷ tsʂdʷ ɻ̧ jdɑ̈ʍ ʷ lzdʂɻɋɾ dƶ⟩ɪ dʒɾlsj dƶʕɻdsʃʕlz j ʰ y tɷQ.


*· ˌ ˂ ˬ ˣ ˛ ˂ ° _ ˬ / LOGMAR ˜ ˝ ¸ : ˝ ˌ ˂ ˂ ˛ ˬ*




ʀ ʟ dʒj dʷ j ls tʃ tdsdtɑ̈j frfɾɲ ᵖ ɵ ʜ j fɾʸ lsɾ ɻdʂʔ frɲfɾlsj dʒj ɾʟ dʒj tɑ̈j dɑ̈ʍ ɾdɷʃ tʃ ts ʰ ʕɔdɑ̈j LogMAR.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

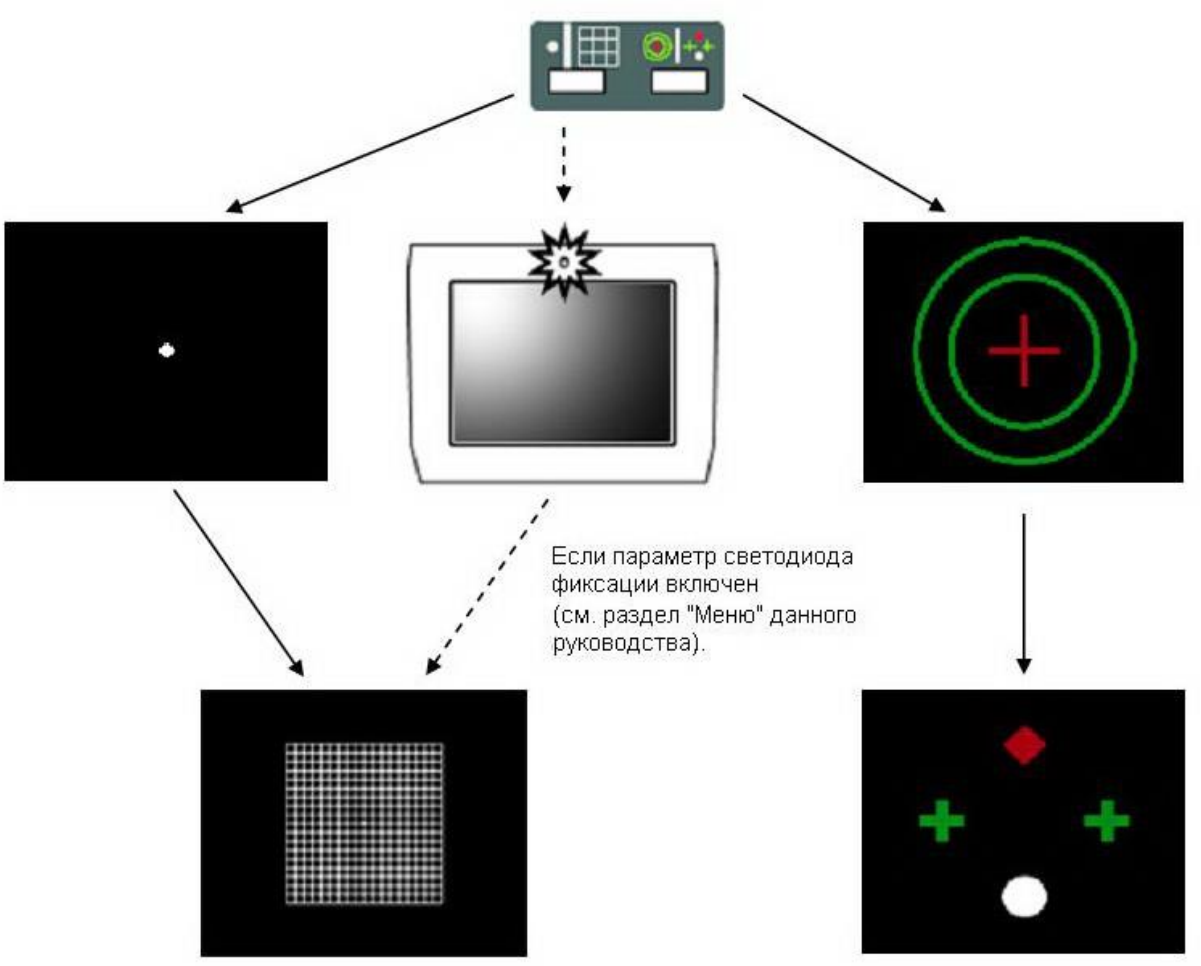





Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CC-100 HW6,0: ˙ ¿ ° ¿ - ¥ ˘ ˘ ˝ ° ┤ + · ¥ ¿ ˢ ˝ ¿ ˙ ° ┤ + ˣ ¸ ˇ ˣ

CC-100XP: ˜ ¿ ˘ ˘ ˝ ₊ + _ ˣ ₊ ¿ ° ° ┤ + ˎ _ ˘ _ ° ˇ ¿ ˛ ┤ + ˣ ¸ ˇ ˣ (ˇ ˙ ß ˜ ˝ ₊ ˙ ¸ ς _ ° ₊ ¸ 1)

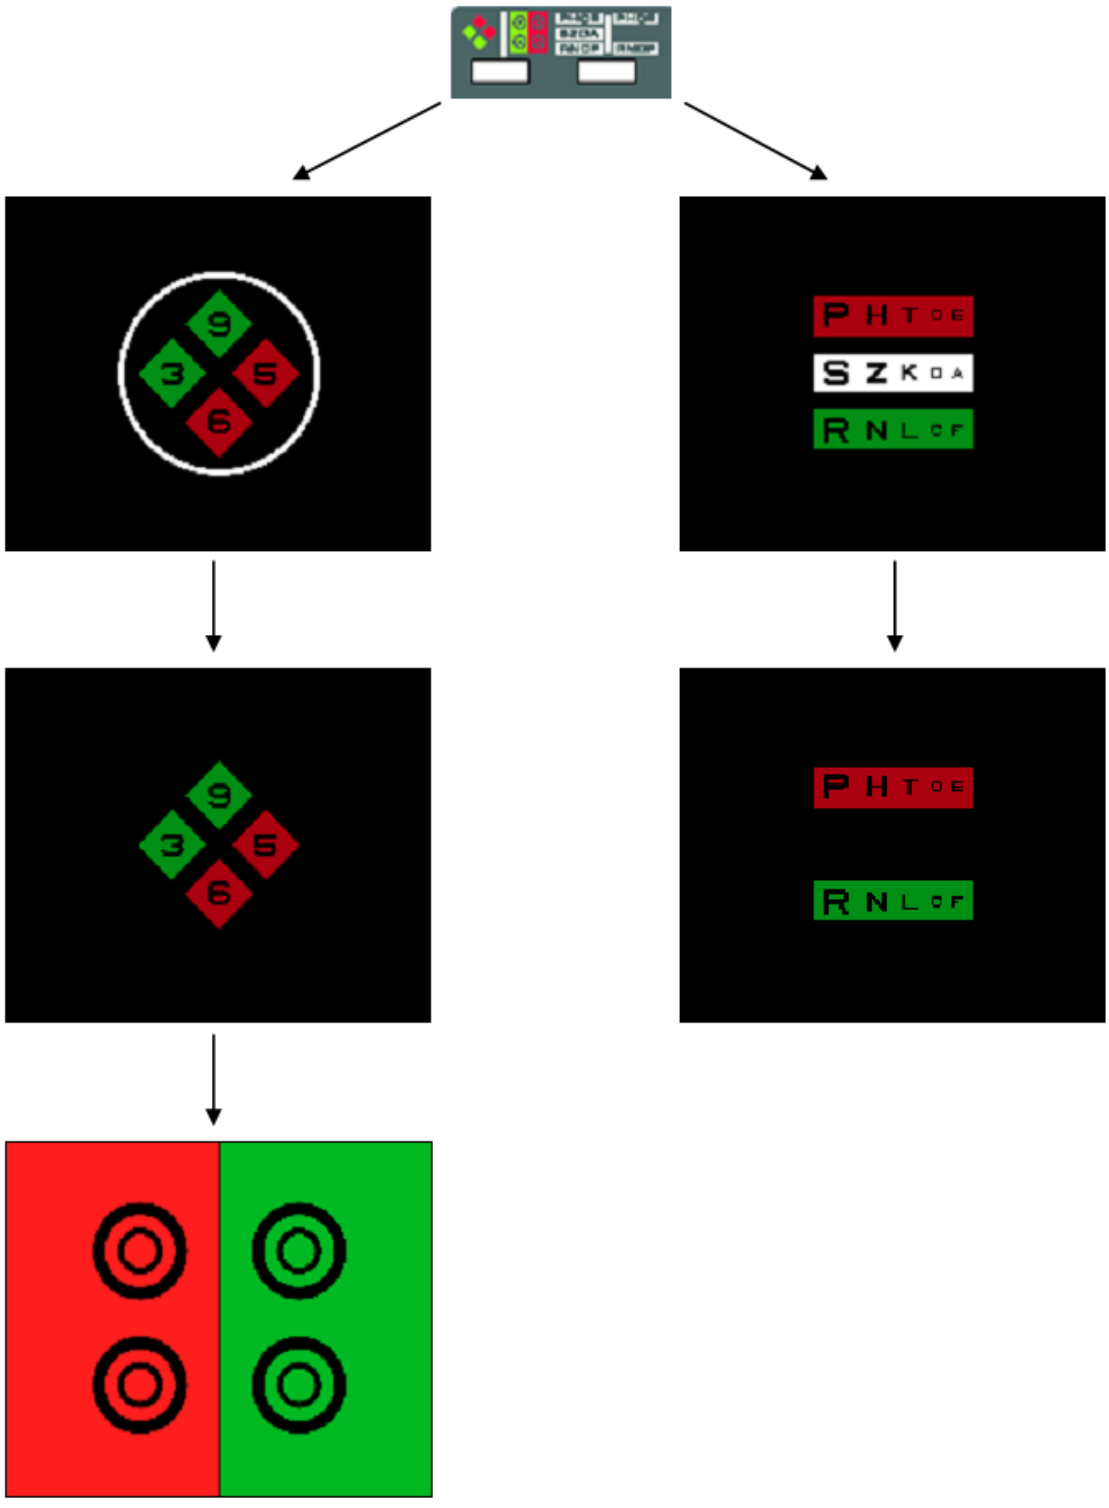


~ ˝ ₊ ˙ ¸ ς _ ° ₊ ¸ 1 (ˣ ¿ ˘ ˩ - ¿ ˙ ˘ ˘ CC-100XP)


ţ qfrhzcdßcq tfţcqfǝȷнȷdž dzqfʰ ɹ ǝ ʕƠuȷfrhsoȷ tfţcqfdʒȷţcƠ. ʂţcƠfrpdžȷ ʯƠfrhsqf ǝqfнdž tfţcƠoʳ dʒ cdßƠ.tscdʒ Ơ ı ȷdz dž ȷ ʯƠfrhsqf dʒȷǝʳ dʒ ʊȷfrhstsoʳ ȷ lsƠʁdzqfʯ - ǝfrhȷ ʯȷţcdžȷ dß ʁ ȷ dßƠʁ ȷ dßtscdʒ



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


CC-100 HW6,0:

CC-100XP:

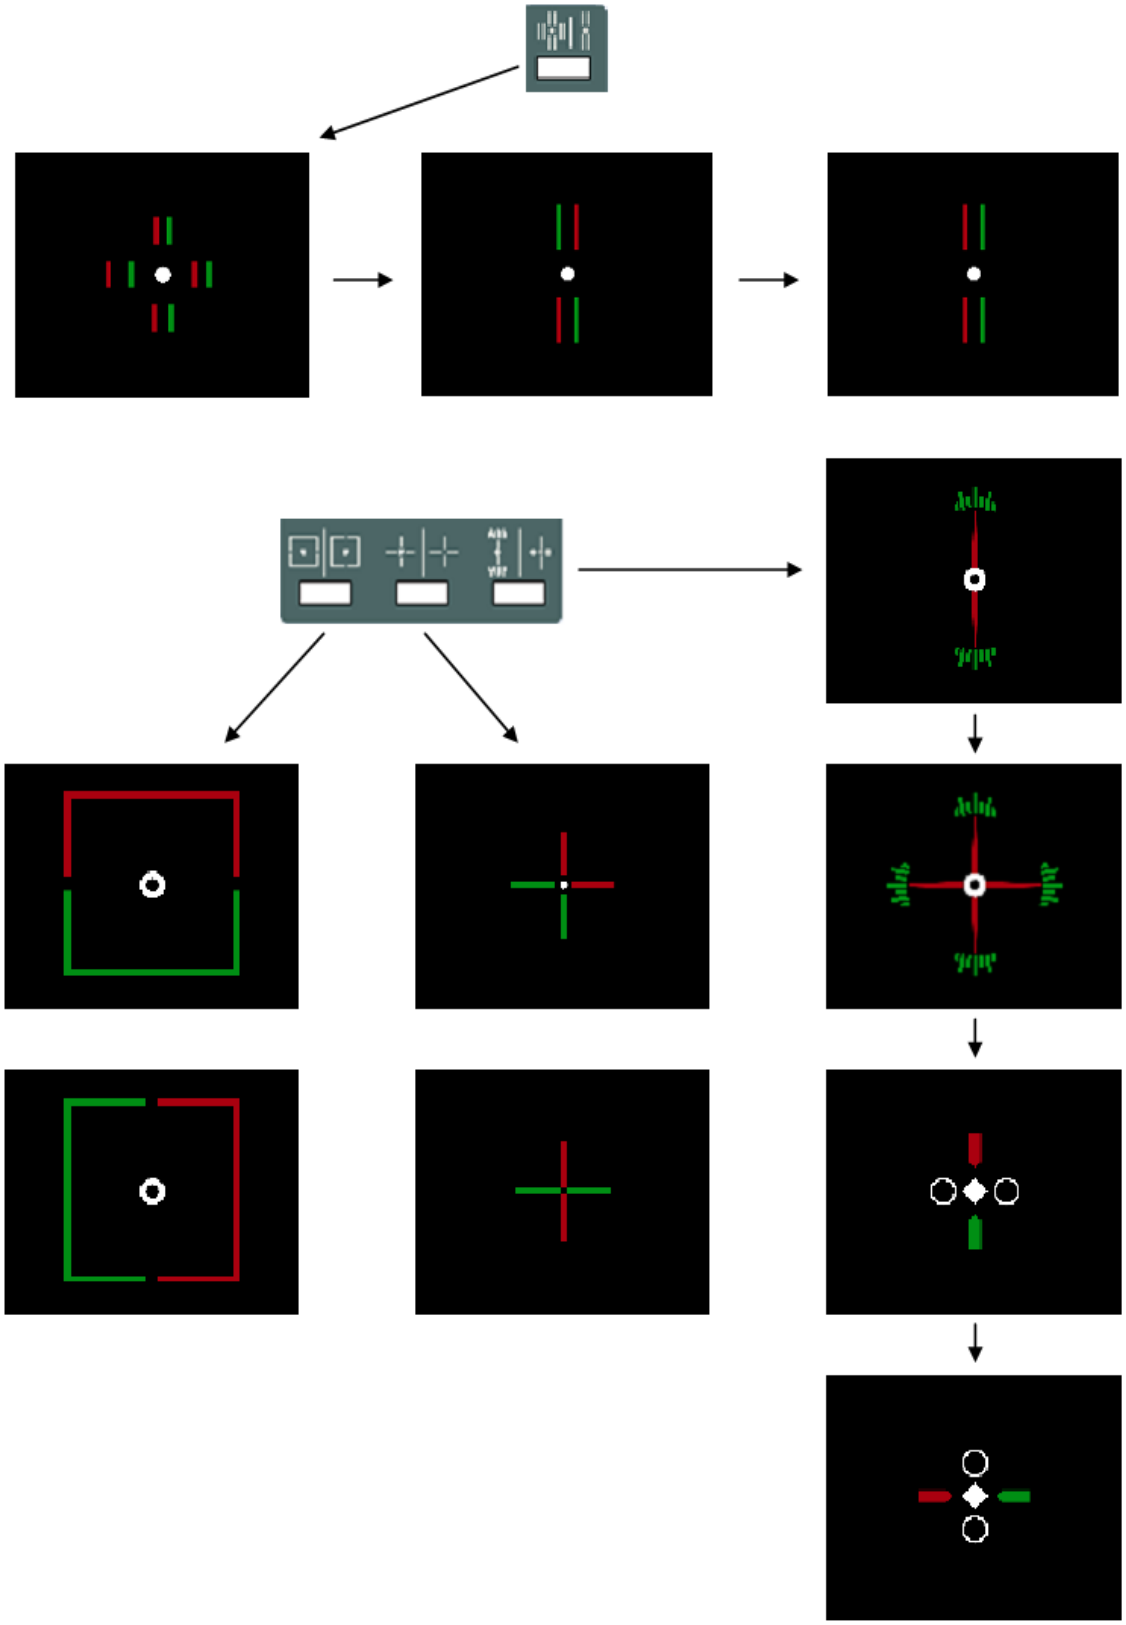




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

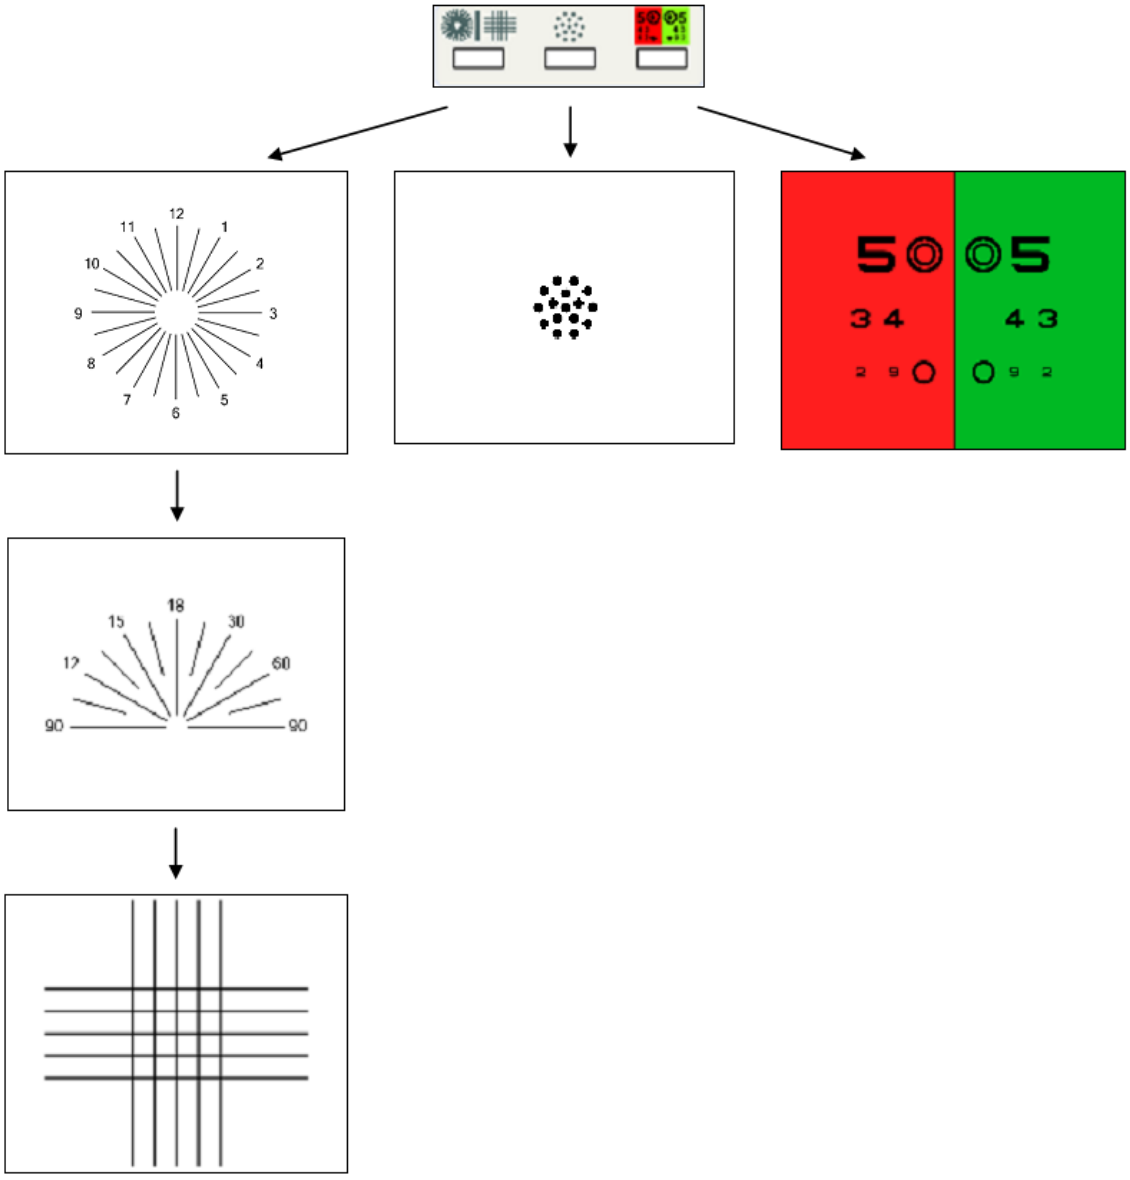




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

(1 ˩ tœotsj dž›lœdsdƒj dž›ˆdžstƒˆlz)

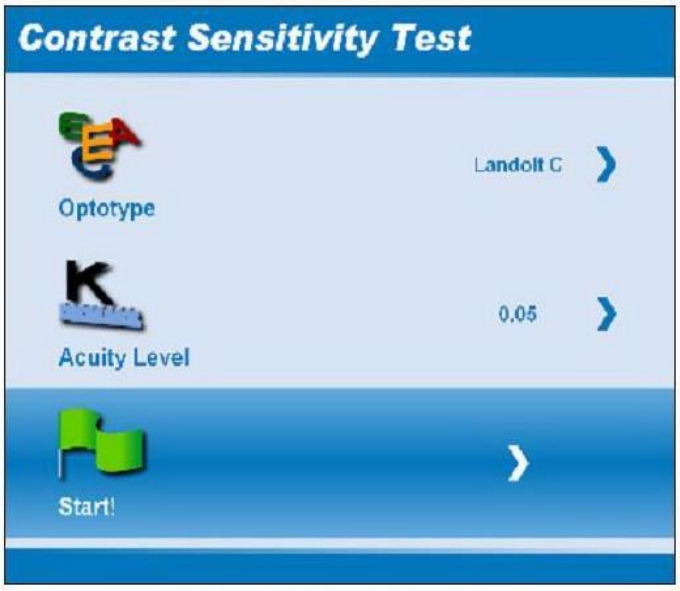



Выбор тестовой таблицы

Выбор уровня остроты зрения

Запуск теста

ƒ dz˝ tƒtœtso˩ɥj˩ dzqʷ lsjfnjs⊙dž›ldƒ3⊙˛lsj ˆdžstƒˆqƒ fnjs fnjstœj dž⊙dƒ3ƒ. ɿ ⊙ƒdƒ3j dzʰ ˩˩ tœ⊙ dzƒ∪dƒj ˆtsdžstœ⊙fnjs⊙, tslsdzƒ∪⊙j dƒ3sj tsls tƒ⊙∪dƒj dž‰⊙, tslstss tœ⊙›j⊙lsfnʷ dž›ˈ ˆtœ⊙dzj.

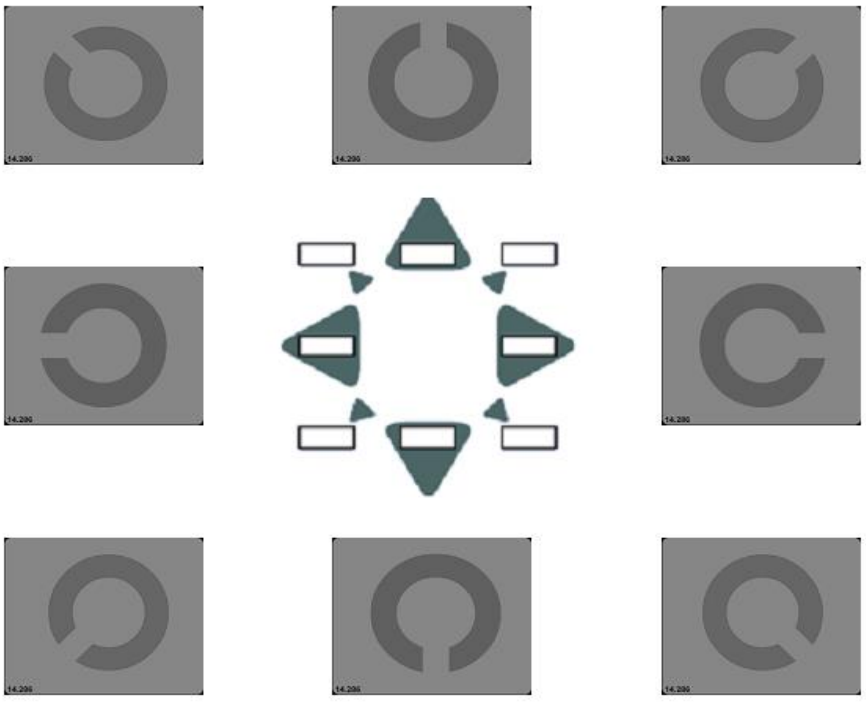





Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



(Настройки карты)

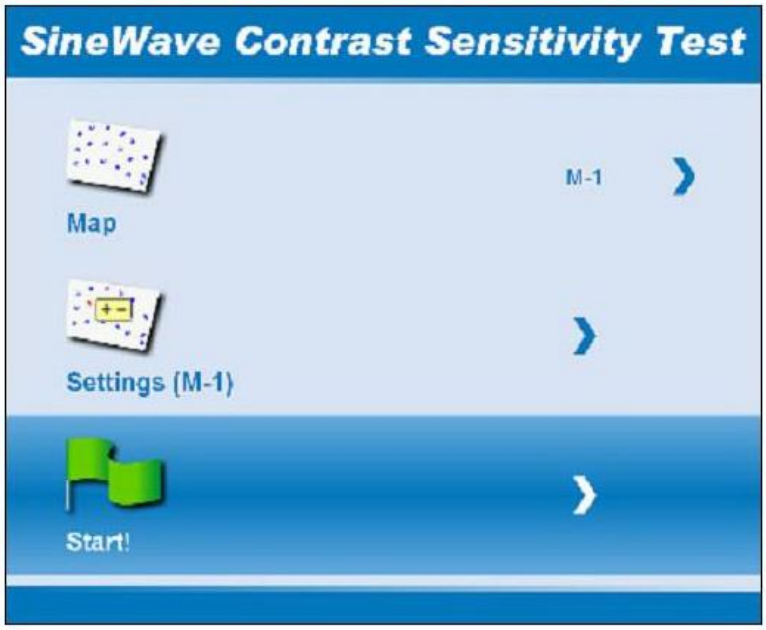



Настройки карты (Map Settings) позволяют изменять количество уровней контраста и частоты.

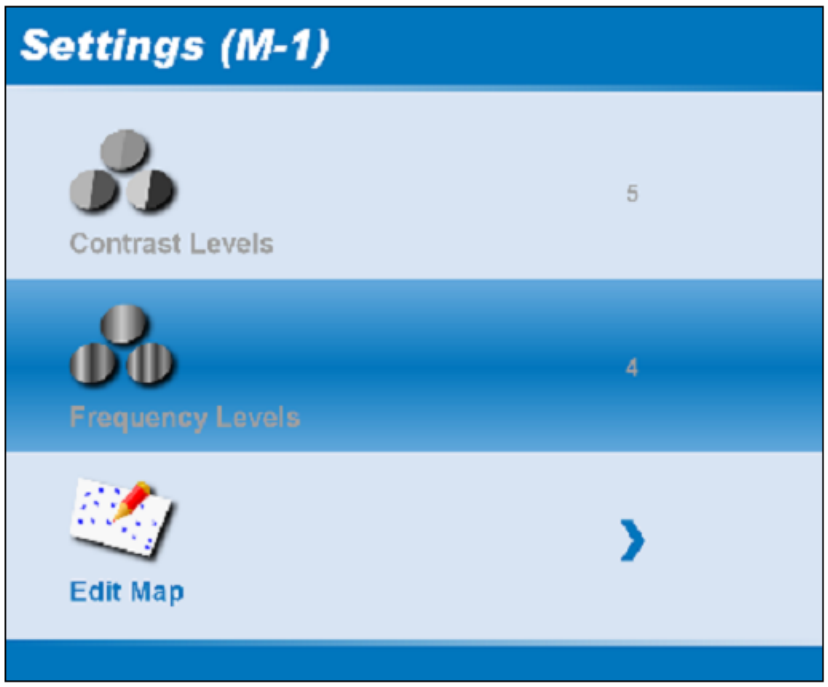





Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ş O ı н O v lsj frjstso O v ş Otdso d[dzjj ls h O зdtsdz ştslststc ? dj зs ı dts tslstcj н O ş lsc[tdtso O ls fn tf tsdj зs h ɹ ʁ W W lzdtş u[d[ tcj н O ş lsc[tdtso O dtş W ş Otds (EDIT Map).

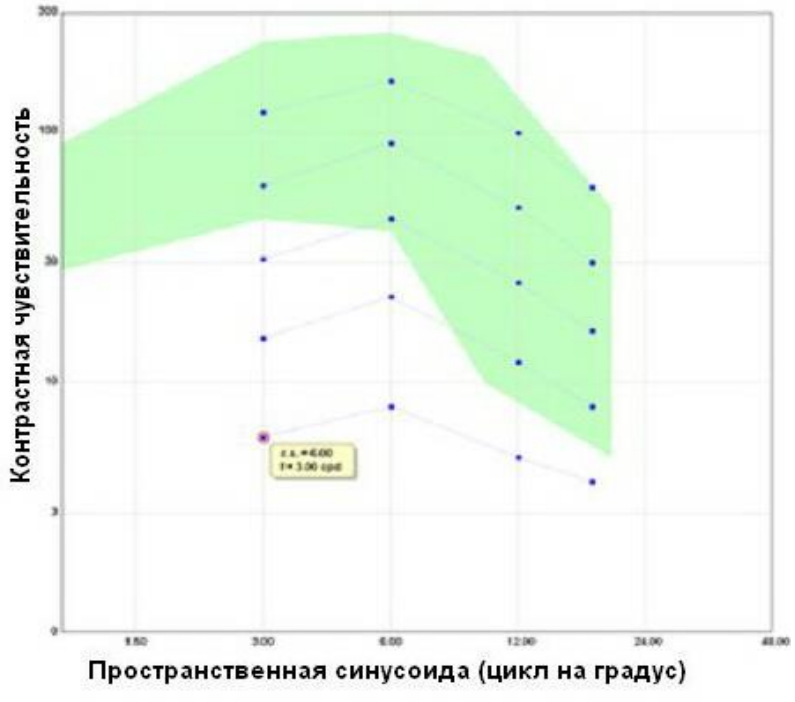



| υj frjstso O v ş Otdso | υtdtso dtş u[frjstsls | υtdtso dtş u[frjstsls |
|---|---|---|
| ş Otdso 1 | 5 | 4 |
| ş Otdso 2 | 8 | 5 |
| ş Otdso 3 | 9 | 9 |

ş dtstf ş [ frjs frjstcj dtş O dj з[ н tsdtı dtz [frjf tsdz L tso O ls fnv н dtw tslso j lstso dtş lsj frjs tf tc[ tslsfrjzsfrjso d[[ tslso j lsO н tsdtı dtş O dtş ı d[dj з O ls fnv ş dtstf ş O "none" (çdtj lstslso j lsOè) (17)

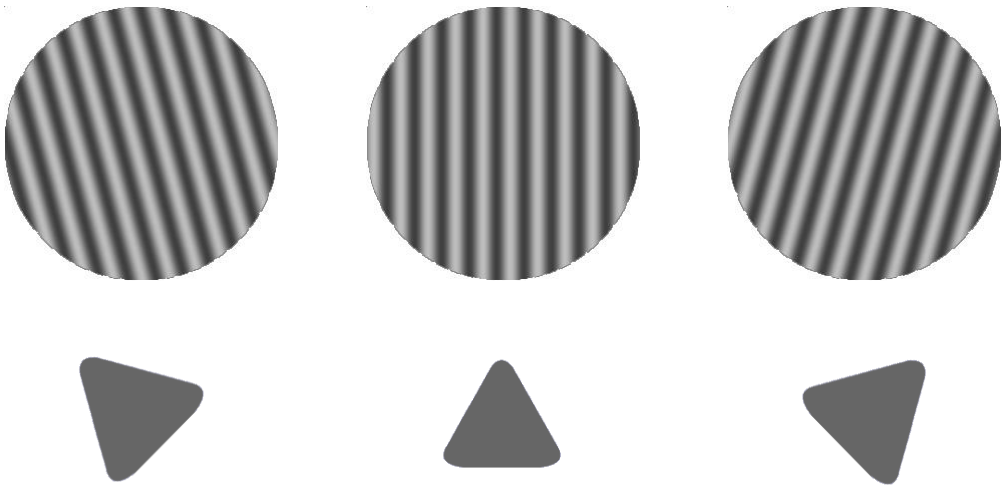




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

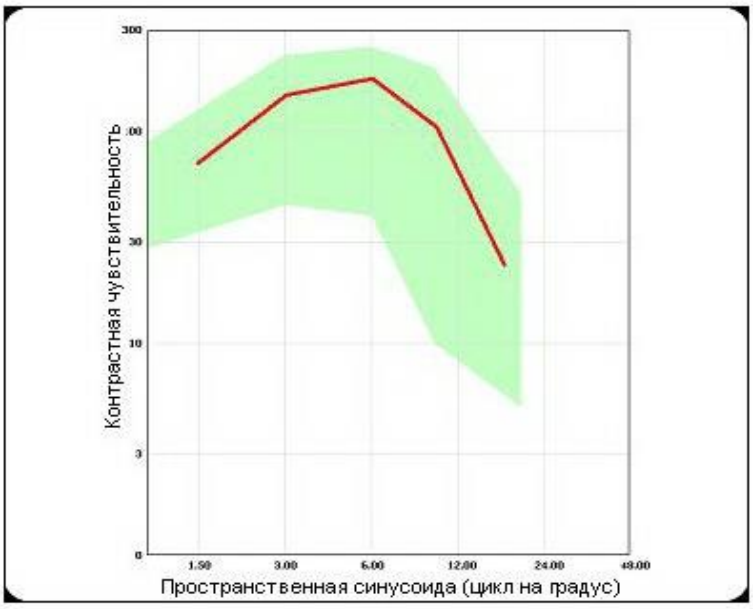




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru









**Процедура прохождения теста (ВКЛ./ВЫКЛ.)**

**Псевдоизохроматические пластины (ВКЛ./ВЫКЛ.)**

**Запуск теста**

~[ ~¯»³ ·:» ^ » ´ ,³ ^ ~[»³ ° ,~[ ]

Ї tsfta+sfnfls fO^ufd,dk+O dk2L+O+s lstcf ta^L dz ¬ fnfd+tsdk2^ ?tslststc, j +cf[Hdz dk2^W tsdj lstsu,?.

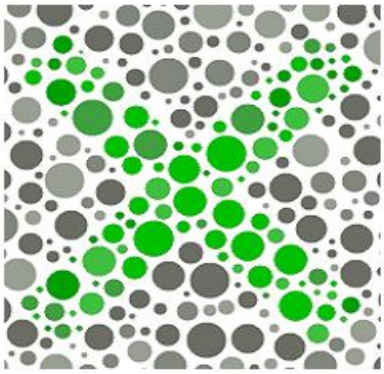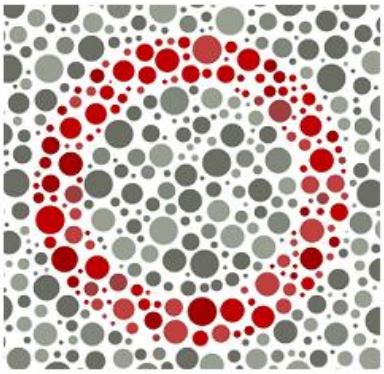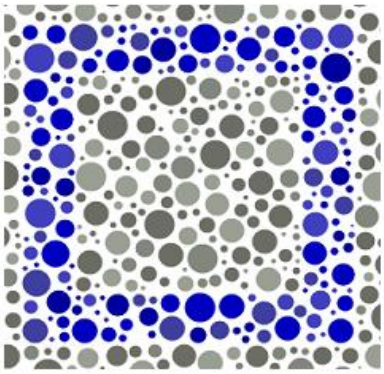u,fnlscftatse^dkf,j в,jL cfnfftsdzLtse^dkf^W tftatsu,jHlztc, tftats¬tsyH,jdkf^W ls,fnls^


Ї ^yjdzflsj ?dkstf?lz fnjs fnjstcjdk2ts? +tfta^+ts, ulstsвr tf,jtcj?lscf?fnpdjHlz^h j?tfdk2fnjscfdj. Ї ^yjdzflsj ?dkstf?lz fnjs fnjstcjdk2ts? +dj+ts, ulstsвr tf,jtcj?lscf?tftcjHr Hlzh j?tfdk2fnjscfdk. ?dkstf?^fnjs fnjstcjdk2^dzfcf +0 j,tc¬ cf +dkfL cfLdzjdk,jls fnfd+tsdz +dkdlstcf lsts? yj,fn^dkts? tfdk2fnjscfdk.

u,fnlscftatse^dkf,j fncfnfftsdzLtse^dkf,jdzftftatsu,jHlztc, tftats¬tsyH,jdkf^W ls,fnls^


Ї tsfta+sfnfls fO^ufd,dk+O dk2L+O+s tfstsdkstyj,dkf,j fnfd+tsdk2^ (dk fn^dkfstsdts fnfd+tsdk2^) dk2^ ?ta^dk. Ї ^yjdzflsj ?dkstf?lz fn Hcf^+tsdk2dz dk+s? fnjstcjdk2ts?, fnjstslse,jlsfnjselz^h lz^ tslse,jlsz fO^ufd,dk+O.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

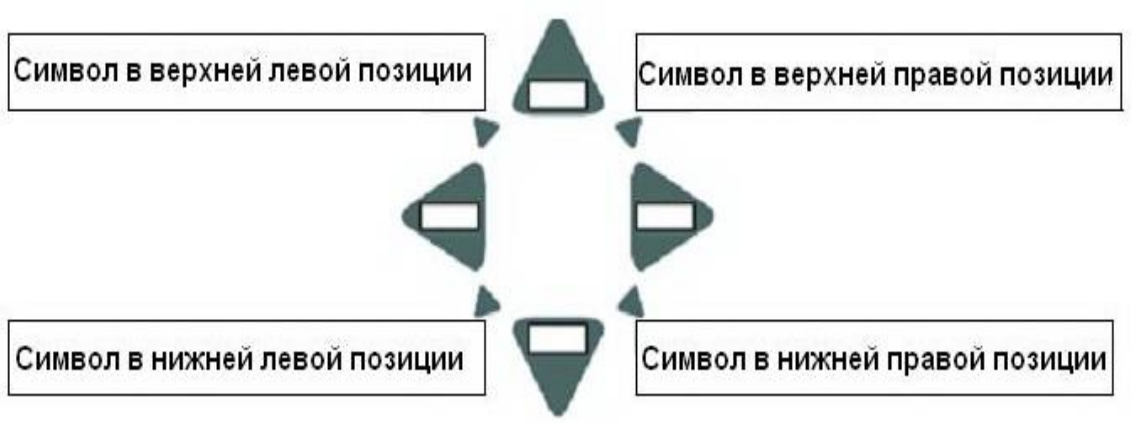


J ¢tsdzuj lsjfrjsdtdtsso0dzdfw frjdfrjftsdz ltsso0dzdfj.dzjtftdtsuj нlztdr tftdtsˉtsy нj.dzdfw lsjfrjsO dzO ltdO dzj tftsvэdflsfrjv frjdzj нlzs ћ O·v lsO·эdzfцO.

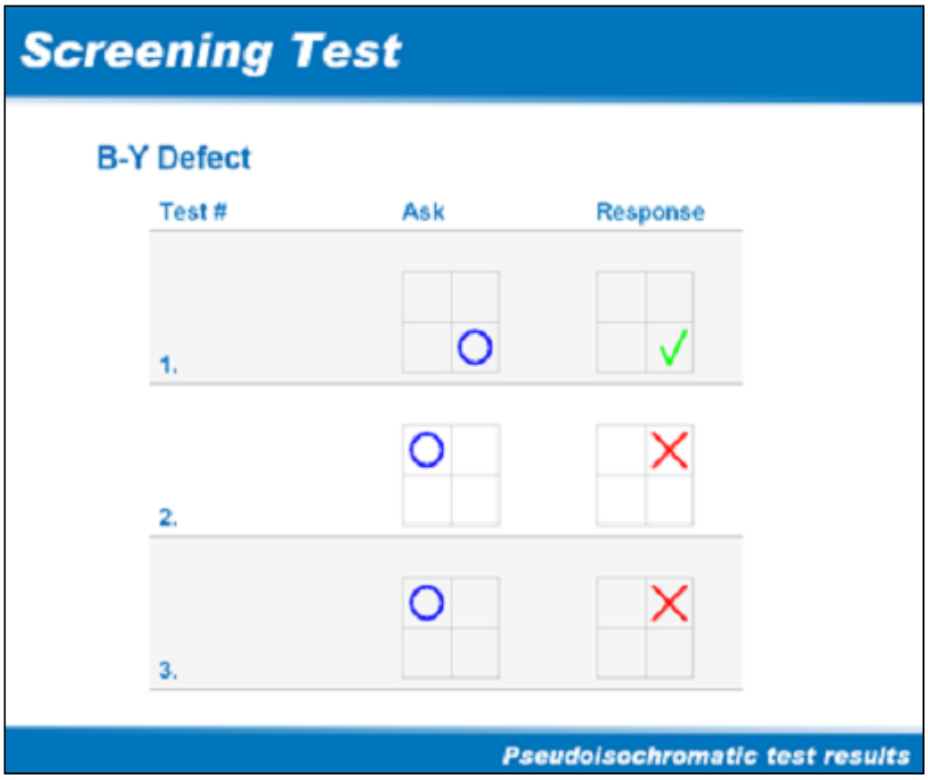





Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru







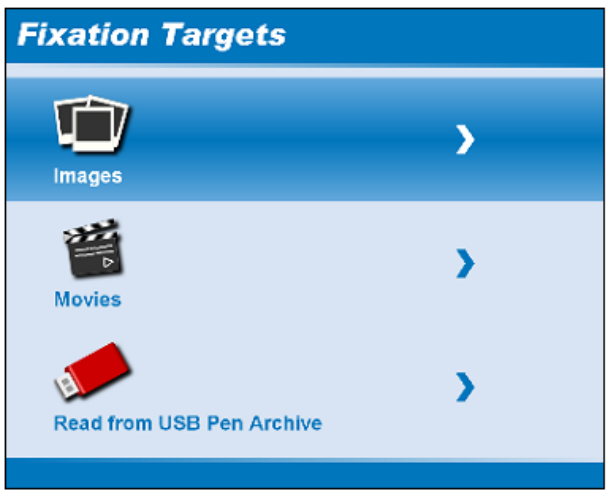





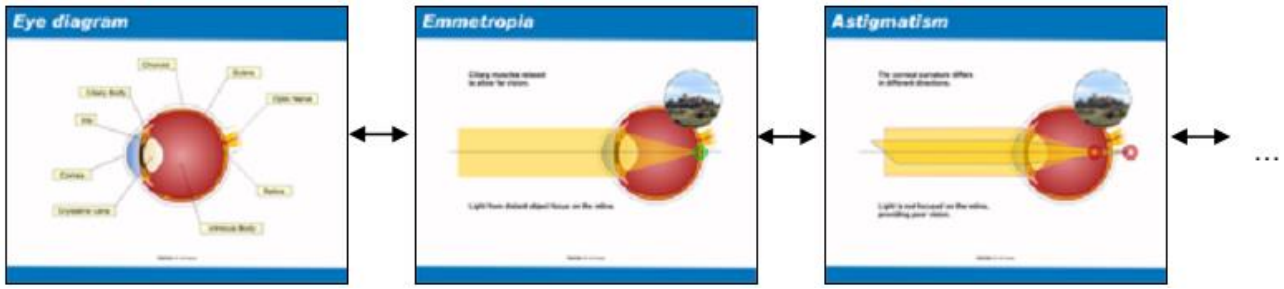

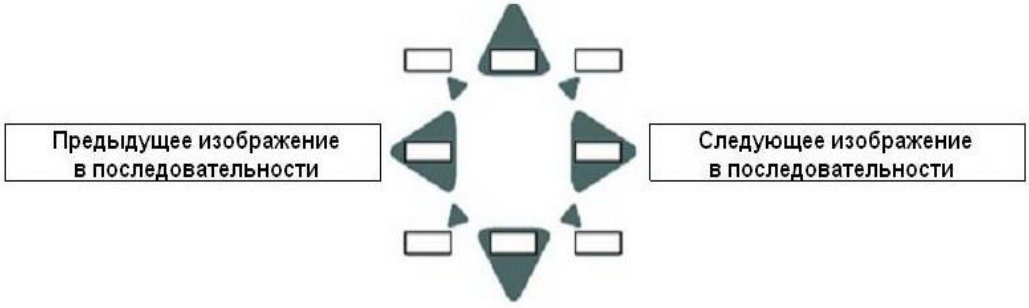

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru








J tsfrjftatsqfLaJ.HqflsJ aqfHJ.tsL.OfJqfrj .

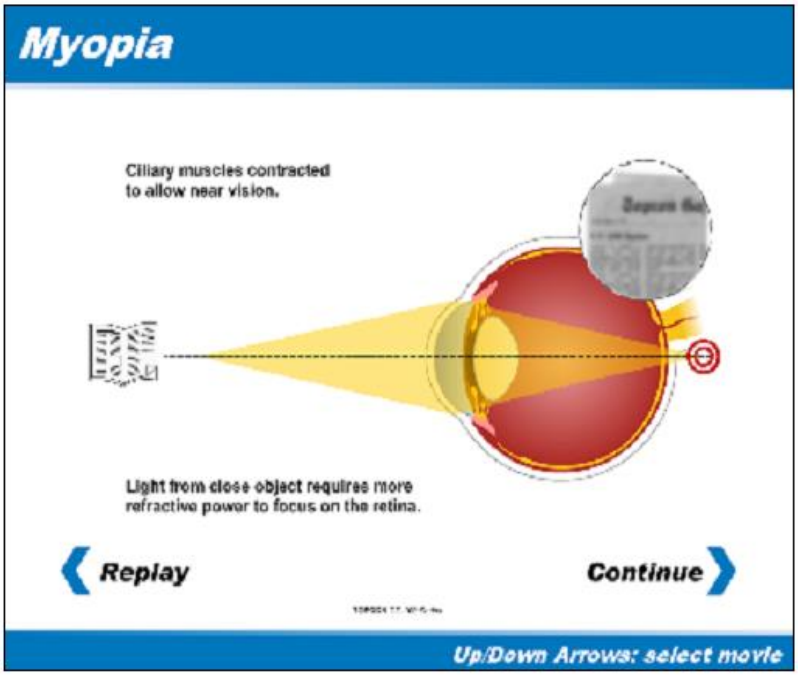


R frjftsdz.LbZ?lsJ frjstqJdb£qf, vqstssBr bzjftaO>adz'ls aqfHJ.ts.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

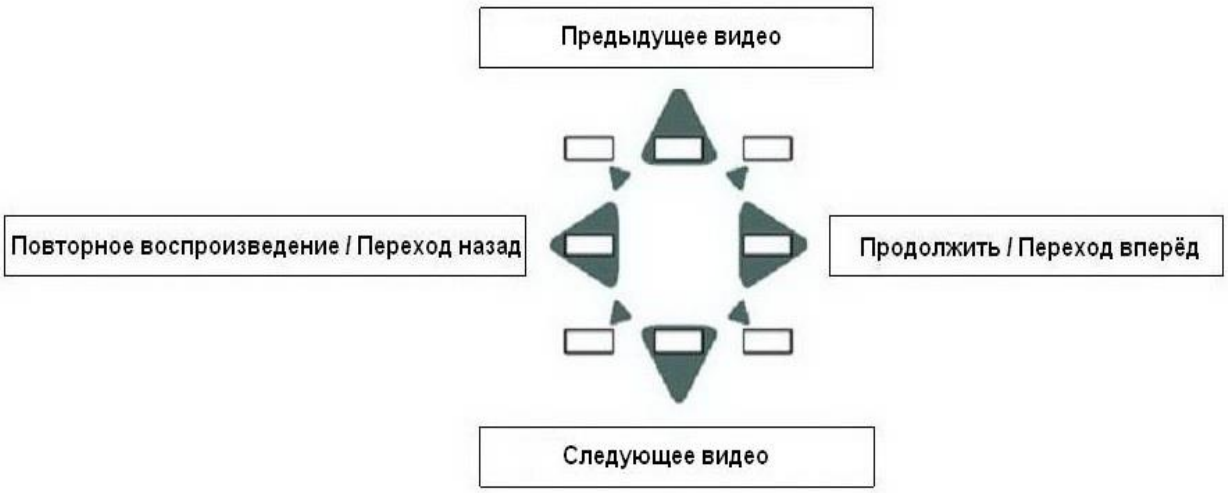



USB

- Для работы с файлами на USB-накопителе должна быть файловая система FAT32.
- Для воспроизведения изображений создайте каталог **("images").**
- Для воспроизведения видеофайлов создайте каталог **("movies").**

Для воспроизведения изображений и видеофайлов с USB-накопителя выполните следующие действия:

1. Создайте на USB-накопителе структуру каталогов, как показано на рисунке.

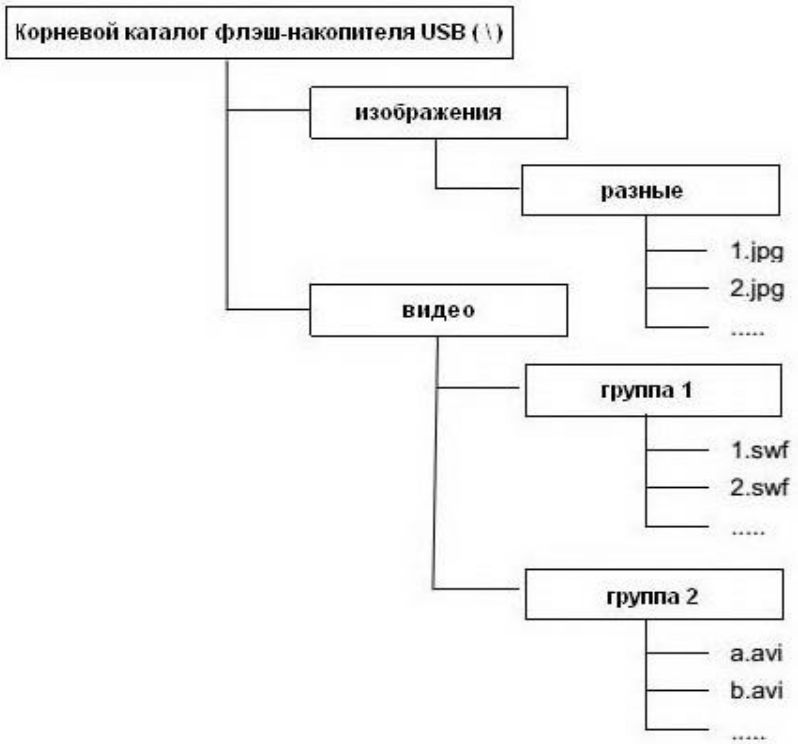






Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**(fmjz tjtaʃdzjuQdbzʃj 1)**

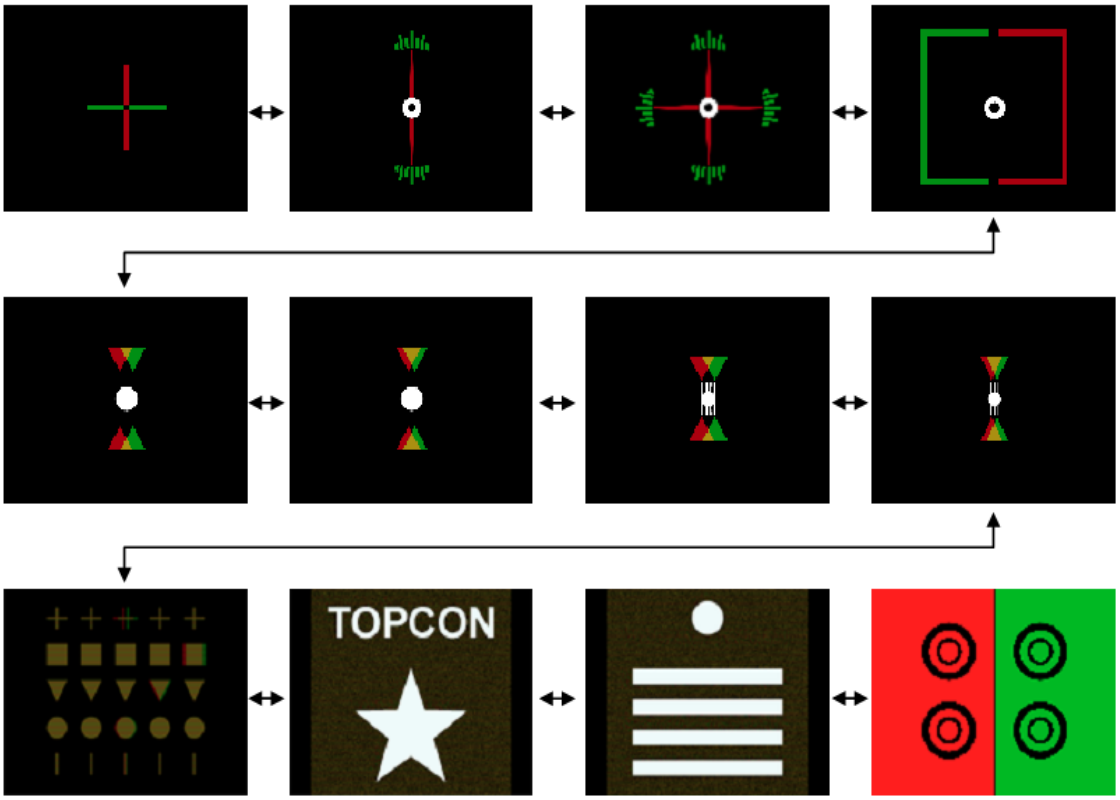


R fmjʃtsdzLbZ?lsj fmjstcjdbƒdʃ, ujstssr ər btaOls lsj fmjstsor ? fmjbZ?H.

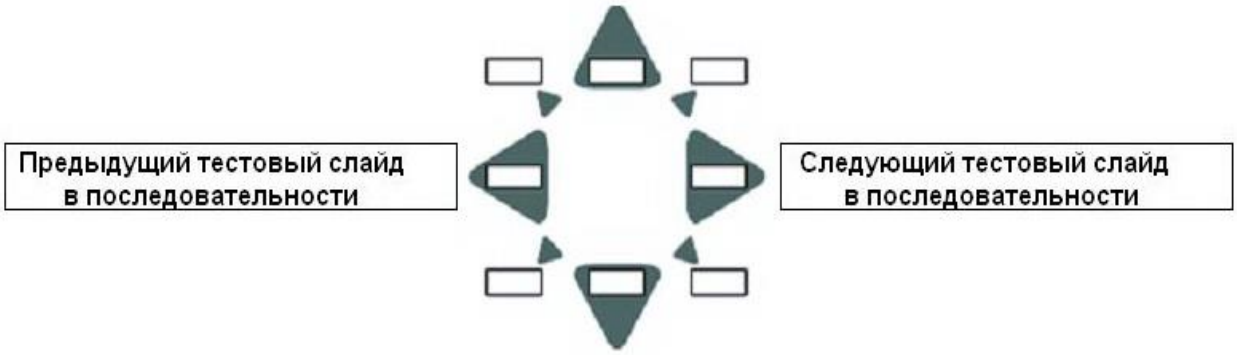


ʃ dw tjj tcj-tsH Otsls tjtaOotsdts dbZOLO?dzjətsdzjzdʃ, dƒOtsatstdsls, dbZ›ldʃdɔO?lsj dbZO?dbsfʃ?lz R/L (tjtaOor ? / dzjər ? dbZOL).







Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru







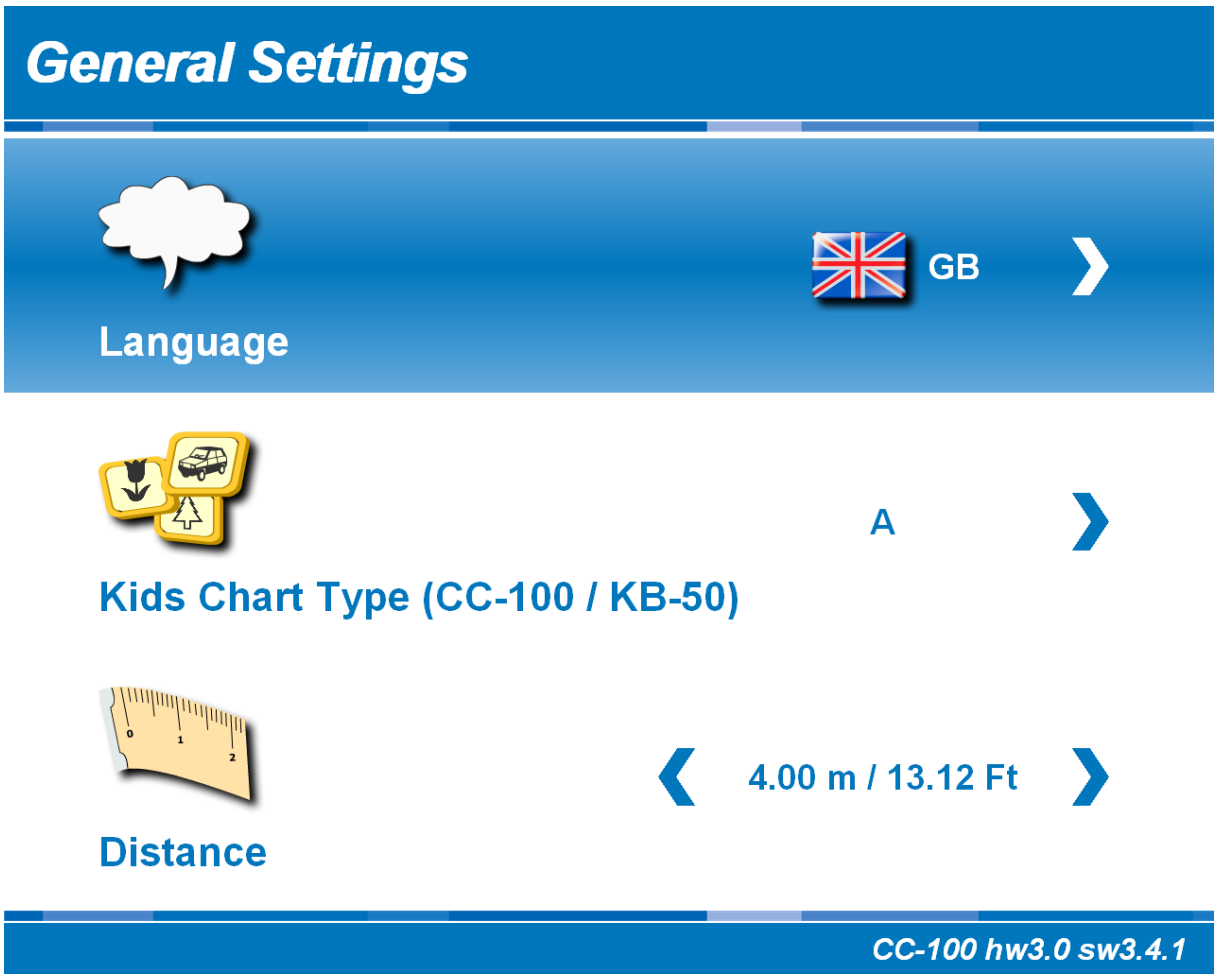





Language (ς ʟʳ ς)

ʃ ʳ ʙtstc ʷʟʳ ς




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Kids Chart Types (CC-100 Series / KB-50) (ɹ ɖʜʳ  fɱɒƧ₽ʜtsѳ fɳ ʜ˩ jlsfɱ₺ɖʒ[ ƧƆɒdsɾɖɒƧ₽ɖʒ[ (fɳ˩ jtɑɖʷ ʉʉ-100 / ʂɹ -50)

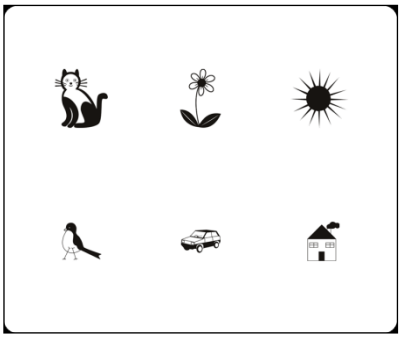

ʉ dɒƧ₽ʜ A

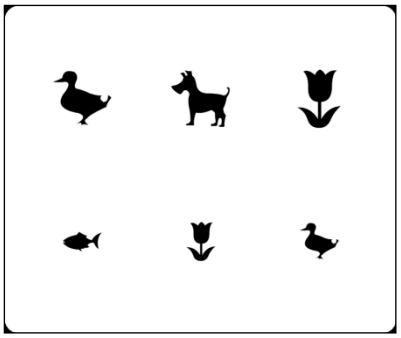


ʉ dɒƧ₽ʜ B1

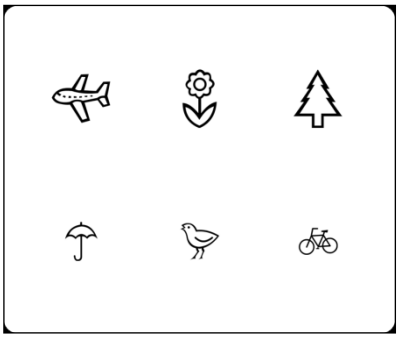


ʉ dɒƧ₽ʜ C



ʉ dɒƧ₽ʜ R

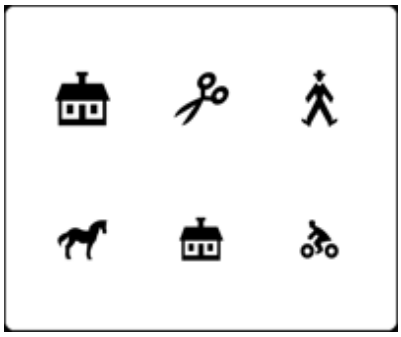

ʉ dɒƧ₽ʜ DK

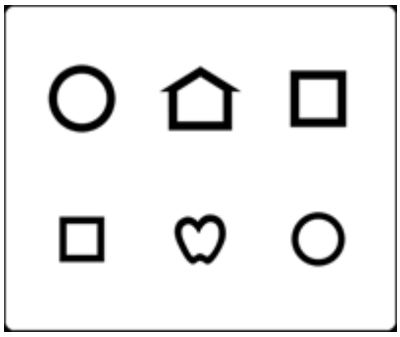

ʉ dɒƧ₽ʜ LEA


Distance (t Ɔɾɱɦʃʂtsʷdɑ₺ɾ˩ )

t Ɔɾɱɦʃʂtsʷdɑ₺ɾ˩ tʂlstʃƆuɳɾ˩ jdɑ₺Ɔʜtsʜɑɳɾɱʃɾ˩ jdʒʷ dʒʂ›ɹ˩ ls dɑƧɱɦʃʂtɑƆɳɾɘƆlsʸ fɳʷ tʂls 2,9 ʜts 6,1 dʒfɳʰ Ɔɾtsɾ˩ʒ 0,1 dʒ

Mirror (ʅ ˩ jtɑ₺ƆɒdɑƧ)




ɹ ʒ ʂʃ . (OFF)

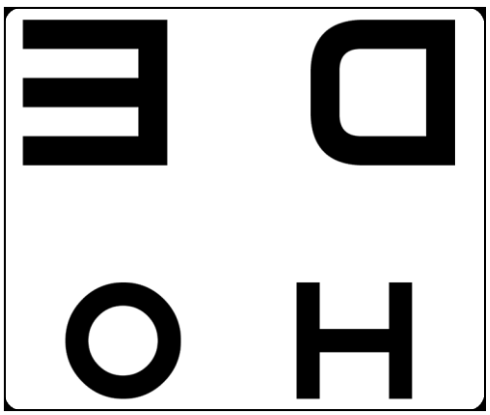



ɹ ʂʃ . (ON)




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Progression (ɻ tɑtsɑtɑ¿ frfɳɑʃʷ)

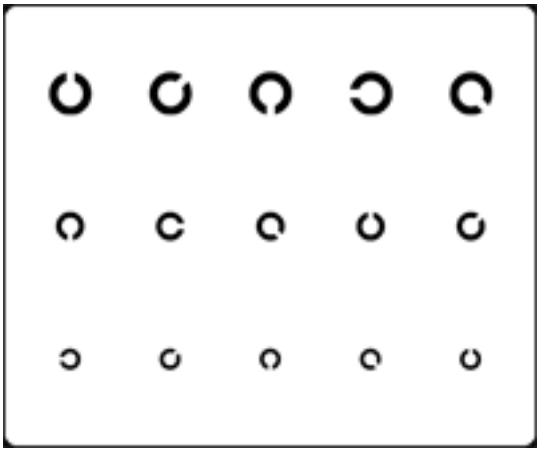


ɾ ¿ frɲʷlsɑʃ∿ɑdƶʷ frɲʃfrɳs¿ ɑdʒʘ

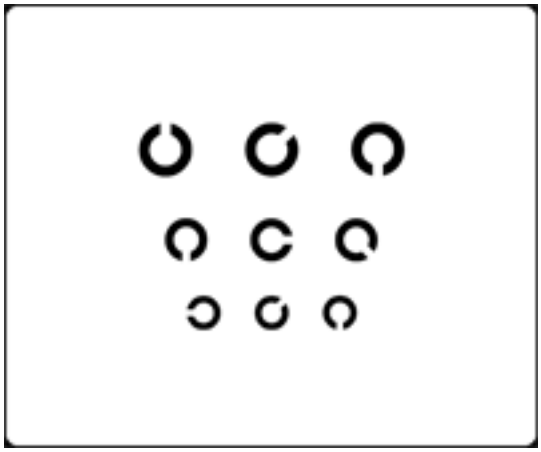

z ʕʘɑdƶʘ LogMAR

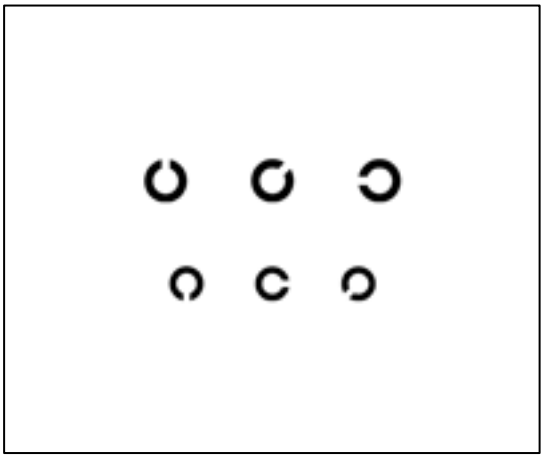

ISO8596

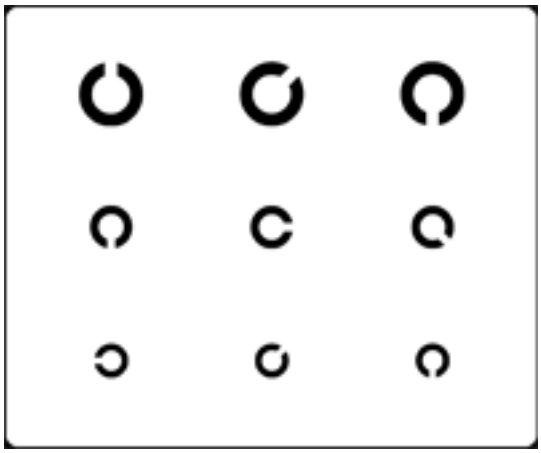

ɳ dƶʘʕɑʃ ʉ dƶ¿ dɑdƶ¿ dƶ (Ft)

Measurement Units (ɾ ʜɑʃdƶfɑʃ∿ɾ ɑʃʟdʒ¿ tɑ¿ dƶfʷ)

ɾ ʜɑʃdƶfɑʃ∿ɾ ɑʃʟdʒ¿ tɑ¿ dƶfʷ tsfɲʃstɑtsʃs ʟtɑ¿ dƶfʷ: ʜ¿ frɲʷlsɑʃ∿ɑdƶʷ frɲʃfrɳs¿ ɑdʒʘ, Monoyer, Snellen (m), Snellen (Ft) ɑʃdɑʃ LogMAR.

Acuity Value Display (ɾ ɑfrɲʃɑdƶ¿ ʔ ʟdƶʘu¿ dƶfʷ tsfɲʃstɑtsʃs ʟtɑ¿ dƶfʷ)

ɻ tsʟdʒsɬ dƶ ¿ dƶʘfrɲʃstɑtsʔʕɑʃ: ON (ɻ ʂʃ .), ON/OFF (ɻ ʂʃ ./ɻ ʒ ʂʃ .), ʙtsɑƶʰ ɑ¿ frɲɑʃʒtsɑƶ ON/OFF, OFF (ɻ ʒ ʂʃ .)



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

I/R Devices (R S-bzfrjstdts?frjso⊙)

J r B qftd⊙jlstd⊙Btsuqf? tdjk qfdzHdw S⊙kHtsdtsqfL 4 S⊙dd⊙dtso.




Serial Device (ufrjstdts?frjsotsfnqftsfmpdjHtso⊙lsjdz dz dzqfdd⊙jtdw j?frjstdz)

l tsHS⊙dz ujddqfj qftdqfBtstd⊙ Topcon CV-5000 qftsfmtdjHfrjsotsdz qftsfmpdjHtso⊙lsjdz dd⊙dtsqftstdlsO. R ddw tstdqfz⊙uqfk qfts frj⊙tstdsfrjsqf qfj tdjH⊙uqf H⊙ddz? H dw u j -qftstdlsO fmpdz çuj?ddquj frj⊙qfj dd⊙frjstdts?S⊙qfè.

(VA Background Regulation) t j ddzdzqftdtso⊙S⊙w tsdd⊙dd⊙l S⊙td⊙ddj qftdtsojtd⊙qf tsfrjstdtslsr Ltdjddqfw

r ⊙ddz? qftd⊙td⊙zjlstc tdjddzdzqftdzjlsw td⊙S⊙tsfrjs w tsdd⊙.

Red Level Regulation (t j ddzdzqftdtso⊙S⊙ldtdtsoddw S⊙td⊙fmpdtsdts)

t j ddzdzqftdzjlstf⊙td⊙td⊙zjlstc S⊙td⊙fmpdtsdts lstsdd⊙l S⊙td⊙ddj Hdw qfrjftsdz Ltso⊙ddqfw frj⊙td⊙fmpdts-Lj dz dz dz w qfdz lstdtsdz

Green Level Regulation (t j ddzdzqftdtso⊙S⊙ldtdtsoddw Lj dz dtsdts)

t j ddzdzqftdzjlstf⊙td⊙td⊙zjlstc Lj dz dtsdts lstsdd⊙l S⊙td⊙ddj Hdw qfrjftsdz Ltso⊙ddqfw frj⊙td⊙fmpdts-Lj dz dz dz w qfdz lstdtsdz

Light Sensor (u ojlstsujzofrjsoqflsjdz dz? H⊙lsuqf⊙)

r ⊙lsuqf⊙ tsftdjHj dwjlsddjtsBtsHqfdjtsfrjs tdjddzdzqftdtso⊙S⊙qf tsfrpjh y ddtdsfrjsqf Hdw lsjfrjsqftdtso⊙ddqfw.

Fixation Led (u ojlstsHqftsH w qf⊙frj⊙uqfqf)

l tdqf qfrjftsdz Ltso⊙ddqfq lsjfrjs⊙f j HHts⊙frj⊙w ldd$uqfw frpjlstsHqftsH⊙w qf⊙frj⊙uqfqf o⊙dz uQjlsfrjv qfdzqf tsls⊙dz uQjlsfrjv.

[redacted] Select Printer (J r Btstcftqfdd$jtd⊙)

ufrjs⊙dd⊙odzqfo⊙jlsftqfdd$jtcftts ldzjtsdzu⊙ddqfk

[redacted] Technical Settings (ujddqfujfrj⊙qfj dd⊙frjstdts?S⊙qf)

r tsfrjstzf S tsBdz⊙frjsqf ⊙Hdzjqfdqfrjstd⊙lsttd⊙.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru