АМПЛИТУДА

КОНТЕЙНЕРЫ РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЕ ТИПА КС-400А

Инструкция по применению

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Контейнеры радиационно-защитные типа КС-400А (далее - контейнеры) предназначены:

- КС-401А, КС-402А, КС-403А, КС-404А и КС-405А для сбора и перемещения твердых радиоактивных отходов (РАО) внутри специализированных лечебных учреждений;
- КС-411А для снижения дозовой нагрузки на персонал при перемещении генераторов технеция внутри специализированных лечебных учреждений;
- КС-431А для снижения дозовой нагрузки на персонал при перемещении фасовок радиофармпрепаратов (РФП) внутри специализированных лечебных учреждений.

2 Требования безопасности

2.1 По возможным последствиям отказа контейнеры должны относиться к классу В по ГОСТ Р 50444-92.

2.2 При эксплуатации контейнеров должны выполняться требования ГОСТ 12.2.003-91, а также соблюдаться

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».

3 Основные технические характеристики

3.1 Габаритные размеры, масса и защитные свойства контейнеров должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование, тип	Габаритные размеры, не более, мм	Емкость, л	Масса, не более, кг	Свинцовый эквивалент защиты, не менее, мм
КС-401А	330×646×782	20	105	10
КС-402А	330×475×683	20	105	10
КС-403А	330×646×795	20	75	5
КС-404А	330×526×689	10	54	5
КС-405А	330×686×776	20	63	5
КС-406А	330×554×681	20	59	5
КС-411А	330×604×782	6	155	40
КС-431А	336×615×782	3	95	40

3.2 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха ..... от 10 до 35 °С.
- относительная влажность воздуха при 25 °С ..... до 80 %.
- атмосферное давление ..... от 84 до 106,7 кПа.

3.3 Средний срок службы, не менее ..... 5 лет.

Средний срок сохраняемости, не менее ..... 1.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


4 Состав и устройство контейнеров

4.1 Устройство контейнера показано на рисунках 1 - 3.

4.1.1 Внешний вид контейнеров КС-401А и КС-403А представлен на рисунке 1.

На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

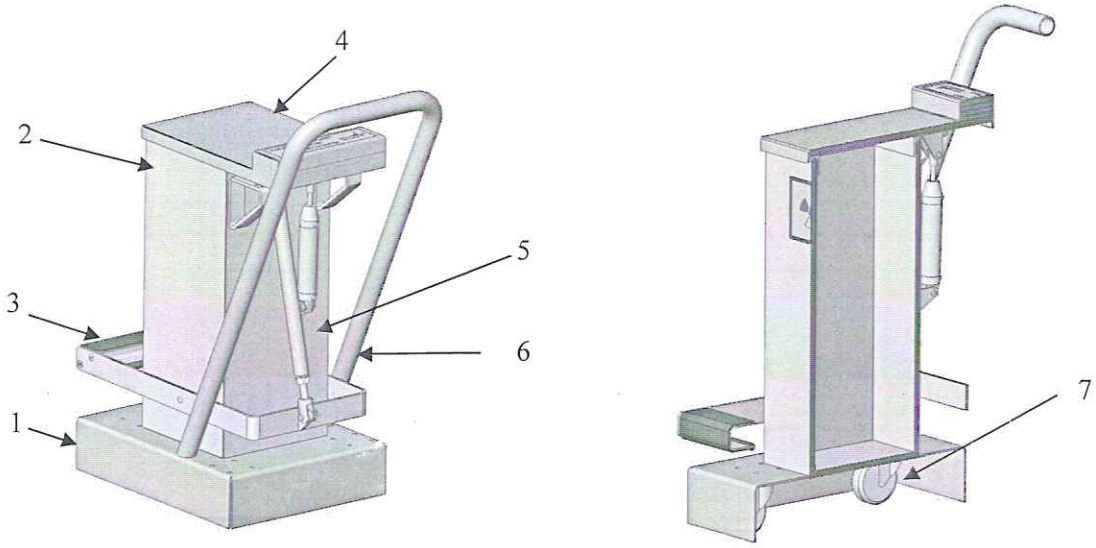

А Б

А – вид спереди, Б – вид сзади

1 - основание; 2 – корпус; 3 - педаль для открывания крышки; 4 - крышка; 5 – тяга механизма открывания крышки; 6 - ручка 7 - колеса


Рисунок 1 – Контейнер КС-401А и КС-403А

4.1.2 Внешний вид контейнеров КС-402А и КС-404А представлен на рисунке 2.

На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех металлических регулируемых по высоте опорах.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

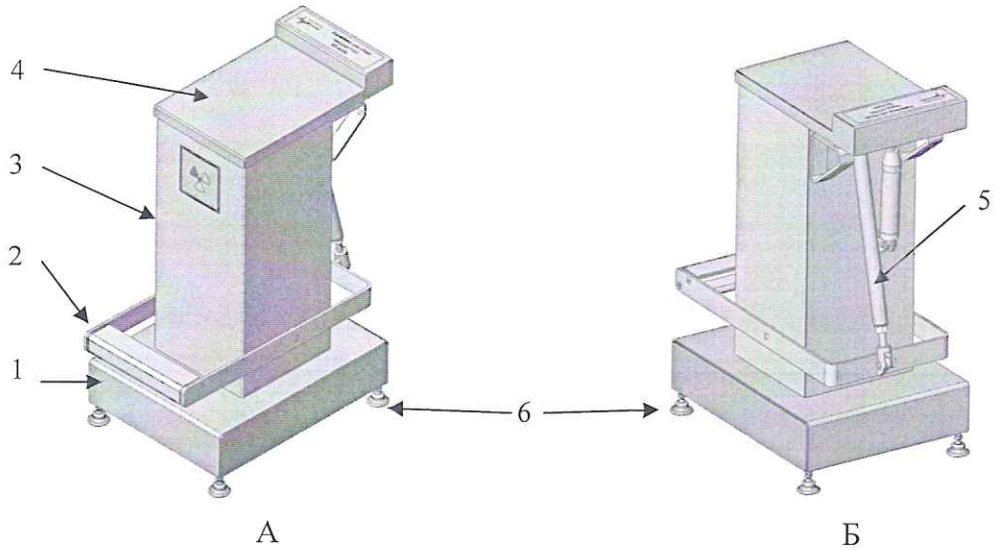

А – вид спереди, Б – вид сзади

1 - основание; 2 - педаль для открывания крышки; 3 – корпус; 4 - крышка;
5 – тяга механизма открывания крышки; 6 – опоры


Рисунок 2 – Контейнер КС-402А и КС-404А

4.1.3 Внешний вид контейнеров КС-405А, КС-411А и КС-431А представлен на рисунке 3.

Устройство контейнера КС-405А. На стальном основании закреплен свинцовый короб со свинцовой крышкой. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

Устройство контейнеров КС-411А, КС-431А. На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Основание представляет собой сварной каркас из стального листа, установленный на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

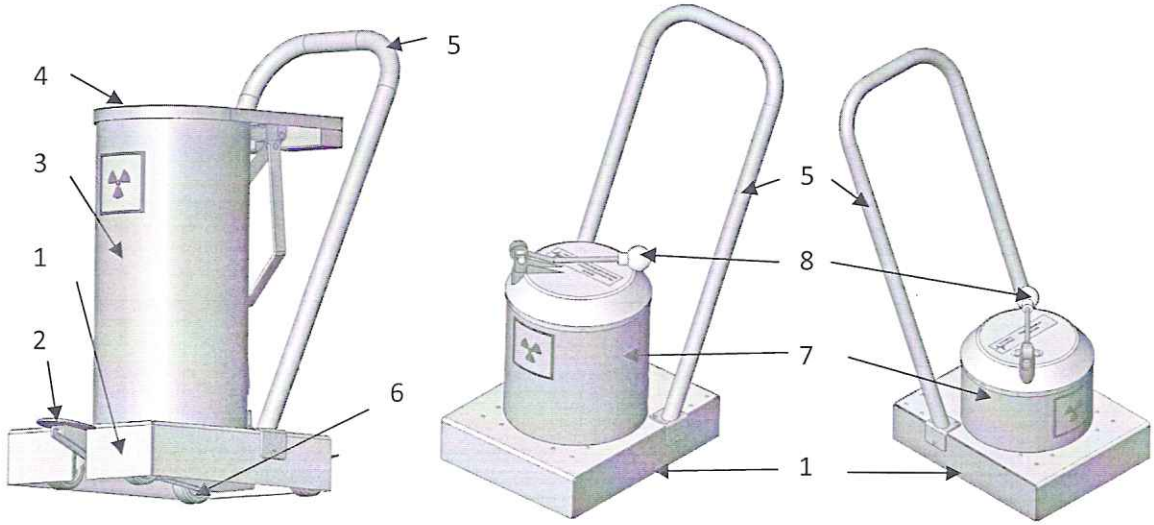

КС-405А КС-411А КС-431А

1 - основание; 2 - педаль для открывания крышки; 3 – корпус; 4 - крышка;
5 – ручка; 6 – колеса; 7 –короб; 8 – рукоятка крышки контейнера

Рисунок 3 – Контейнер КС-405А, КС-411А и КС-431А

57690 Ук 0706.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Порядок действий обслуживающего персонала при работе с контейнером

5.1 Контейнеры можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии.

5.2 Перед началом работы производить осмотр рабочей зоны с целью обнаружения препятствий и иных предметов, угрожающих безопасности работника или оборудования.

5.3 При работе с контейнерами КС-411А особое внимание следует уделять безопасному выполнению операций загрузки и выгрузки генераторов технеция.

5.4 В контейнерах КС-401А, КС-403А, КС-402А, КС-404А и КС-405А для уменьшения загрязнения внутренних поверхностей стенок контейнера рекомендуется использовать пластиковые мешки для сбора отходов. Для фиксации пластиковых мешков предусмотрена рамка из углового профиля.

5.5 Крышку контейнеров КС-401А, КС-403А, КС-402А, КС-404А и КС-405А открывать с помощью педали.

Крышку контейнеров КС-402А, КС-404А открывать с помощью рукоятки крышки контейнера.

5.6 При перемещении контейнеров КС-401А, КС-403А, КС-405А, КС-411А и КС-431А не совершать резких манёвров во избежание опрокидывания или столкновения с другими объектами. Движение контейнера по наклонным пандусам не предусмотрено.

У контейнеров КС-402А, КС-404А самостоятельное передвижение не предусмотрено.

5.7 Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

5.8 Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

6 Хранение

6.1 До введения в эксплуатацию контейнеры в упаковке предприятия–изготовителя должны храниться в условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С

Содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, в помещениях, где хранятся контейнеры, не должно превышать содержаний коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации контейнера можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

Перед утилизацией необходимо проконтролировать загрязненность стенок контейнера радиоактивными веществами, при превышении допустимых норм произвести дезактивацию.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рован-ных					
1	—	1,2	—	—	6	504-24			03.06.2
2	—	1, 2	—	—	6	542-24			10.06.2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»
_____ С.А. Ермилов
«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-401А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-01ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-401А

Паспорт

АЖНС.942819.007-01ПС

12900 Шишч 03.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации и хранению	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

12900 Цфт 29.12.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно – защитный типа КС-401А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для сбора и перемещения твердых радиоактивных отходов (РАО) внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- емкость контейнера, л ……20;
- толщина свинцовой защиты, мм ……..10;
- габаритные размеры, мм ……..... 330×646×782;
- масса, кг, не более ……105.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ……..…… от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % ……..…… до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия

Контейнер является вспомогательным технологическим оборудованием для сбора и перемещения твердых РАО.

Устройство контейнера показано на рисунке 1.

На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

По требованию заказчика корпус контейнера изготавливается из нержавеющей стали.

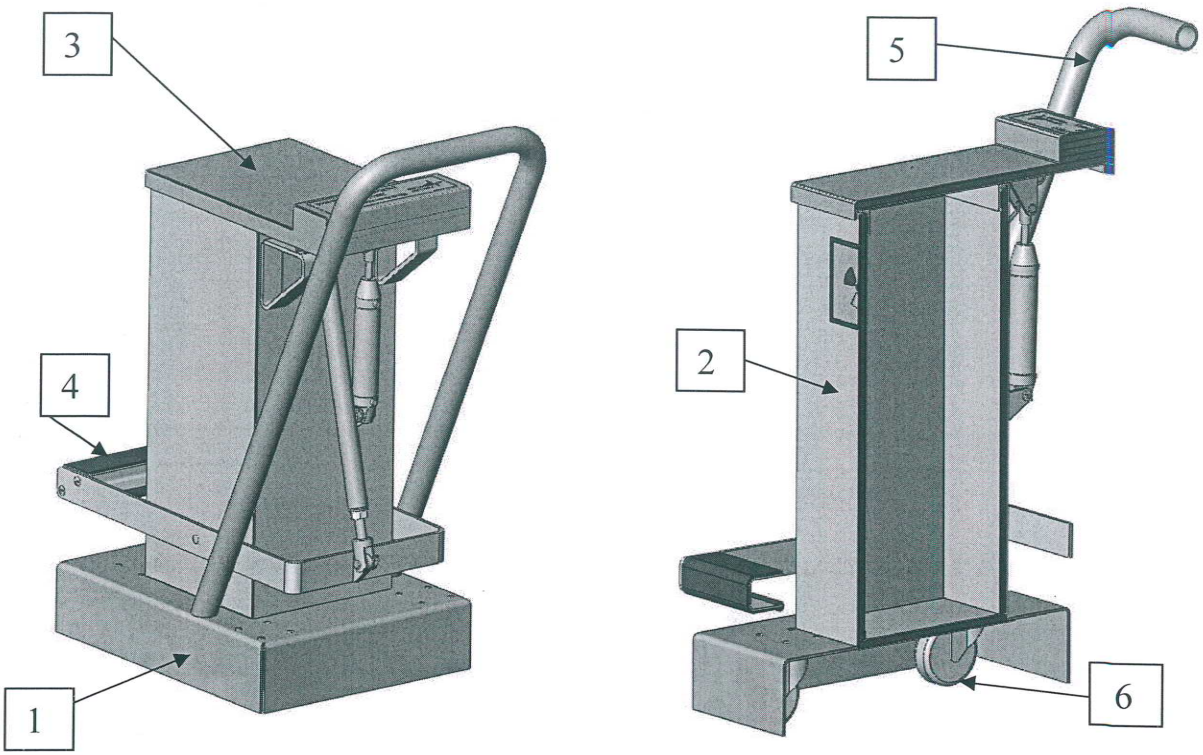


Рисунок 1 – Контейнер КС-401А.

1 - основание; 2 – короб; 3 - крышка; 4 - педаль для открывания крышки; 5 - ручка; 6 – колеса

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование и тип	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-401А	АЖНС.942819.007-01	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-01ПС	1	

Комплектность проверил: _____

Дата _____

129000 Москва 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы

Средний срок службы – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы - 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации;
- неправильное техническое обслуживание или несоблюдение периодичности технического обслуживания;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры);

3.2.5 При отказе в работе в период гарантийного срока изделие должно быть направлено изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 15,
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

1

3.2.8 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

12900 Иварт 15.11.18
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru
15.11.18

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслужива-ния (ремонта)	Наработка		Осно-вание	Должность ФИО		Приме-чание
		после ремонта	с начала эксплуатации		выполнив-шего работу	проверив-шего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии. Для уменьшения загрязнения внутренних поверхностей стенок контейнера рекомендуется использовать пластиковые мешки для сбора отходов. Для фиксации пластиковых мешков предусмотрена рамка из углового профиля.

При перемещении контейнера не совершать резких манёвров во избежание опрокидывания или столкновения с другими объектами. Движение контейнера по наклонным пандусам не предусмотрено.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

12900 Цфаг 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации контейнера можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

Перед утилизацией необходимо проконтролировать загрязненность стенок контейнера радиоактивными веществами, при превышении допустимых норм произвести дезактивацию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно – защитный типа КС-401А, заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12900 Ифарт 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	106-18			15.11.18
2	—	титул. лист, 3	—	—	8	501-24	—		03.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12900 Ирбит 29.10.12

НТЦ АМПЛИТУДА

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»

_____ С.А. Ермилов

«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-402А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-02ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-402А

Паспорт

АЖНС.942819.007-02ПС

12.940 Тишу 03.06.14

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

12910 Цвет 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно – защитный типа КС-402А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для сбора твердых радиоактивных отходов (РАО) внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- емкость контейнера, л 20;
- кратность ослабления, не менее,

  по I-131..... 11,8;
  по Cs-137..... 2,1;
  по Co-60..... 1,3;

- габаритные размеры, мм ..... 330×475×683;
- масса, кг .....105.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % .....до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия


Контейнер является вспомогательным технологическим оборудованием для сбора твердых РАО.

Устройство контейнера показано на рисунке 1.

На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех металлических регулируемых по высоте опорах.

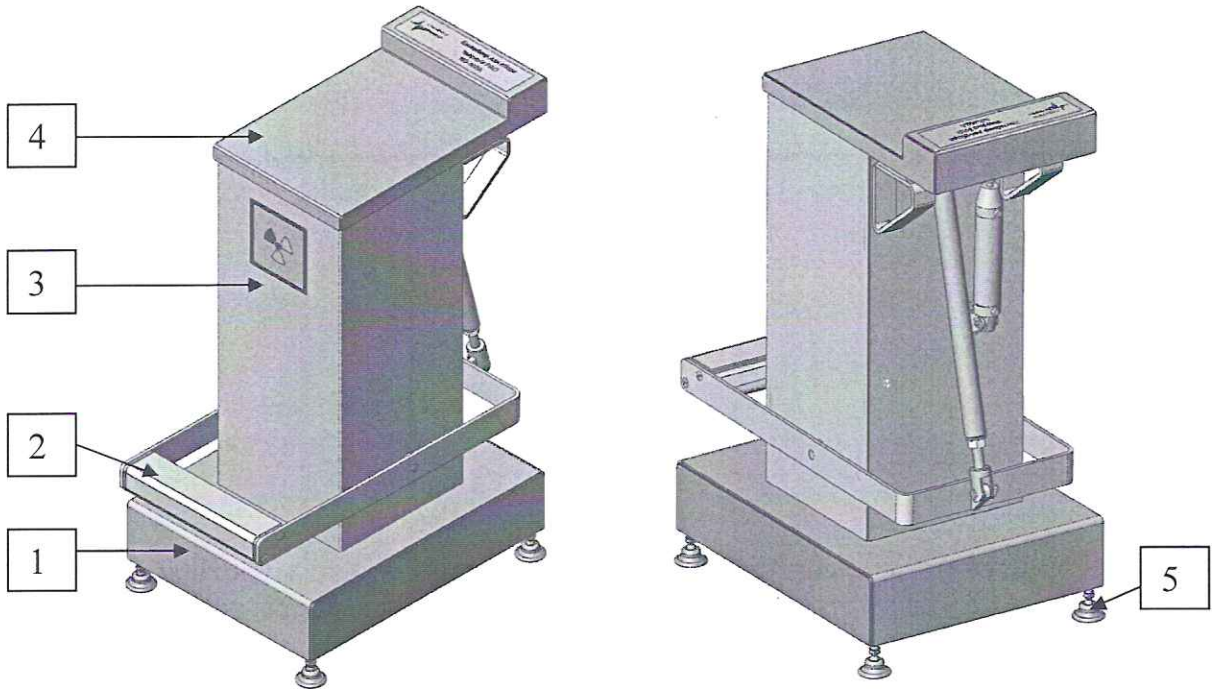

А Б

Рисунок 1 – Контейнер КС-402А

А – вид спереди, Б – вид сзади

1 - основание; 2 - педаль для открывания крышки; 3 – корпус; 4 - крышка; 5 – опоры.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-402А	АЖНС.942819.007-02	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-02ПС	1	

Комплектность проверил: _____

Дата _____

12910 Цфея 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Срок службы контейнера – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1Л по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации и перегрузки;
- неправильное техническое обслуживание или несоблюдение периодичности технического обслуживания;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры).

3.2.5 При отказе в работе в период гарантийного срока изделие должно быть направлено изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д. 15,
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

1

12910 Изм 15.11.18
1 Зам 107-18 Изм 15.11.18
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.2.6 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслужива-ния (ремонта)	Наработка		Осно-вание	Должность ФИО		Приме-чание
		после ремонта	с начала эксплуа тации		выполнив-шего работу	проверив -шего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии, с учетом рекомендаций техники безопасности, а так же действующих правил и норм. Для уменьшения загрязнения внутренних поверхностей стенок контейнера рекомендуется использовать пластиковые мешки для сбора отходов. Для фиксации пластиковых мешков предусмотрена рамка из углового профиля.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

12940 Цфаст 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации контейнера можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

Перед утилизацией необходимо проконтролировать загрязненность стенок контейнера радиоактивными веществами, при превышении допустимых норм произвести дезактивацию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно – защитный типа КС-402А, заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12910 Ифвэл 29.10.14

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	107-18			15.11.18
2	—	л. 1, л. 3	—	—	8	500-24	—		03.06.24

12910 Ивдат 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»

_____ С.А. Ермилов

«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-403А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-03ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г.

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г.

57 704 07.06 24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-403А

Паспорт

АЖНС.942819.007-03ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

129820 Ифарт 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно – защитный типа КС-403А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для сбора и перемещения твердых радиоактивных отходов (РАО) внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- емкость контейнера, л 20;
- толщина свинцовой защиты, мм 5;
- габаритные размеры, мм ..... 330×646×795;
- масса, кг, не более ..... 75.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % ..... до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия

Контейнер является вспомогательным технологическим оборудованием для сбора и перемещения твердых РАО.

Устройство контейнера показано на рисунке 1.

На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

12920

07.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

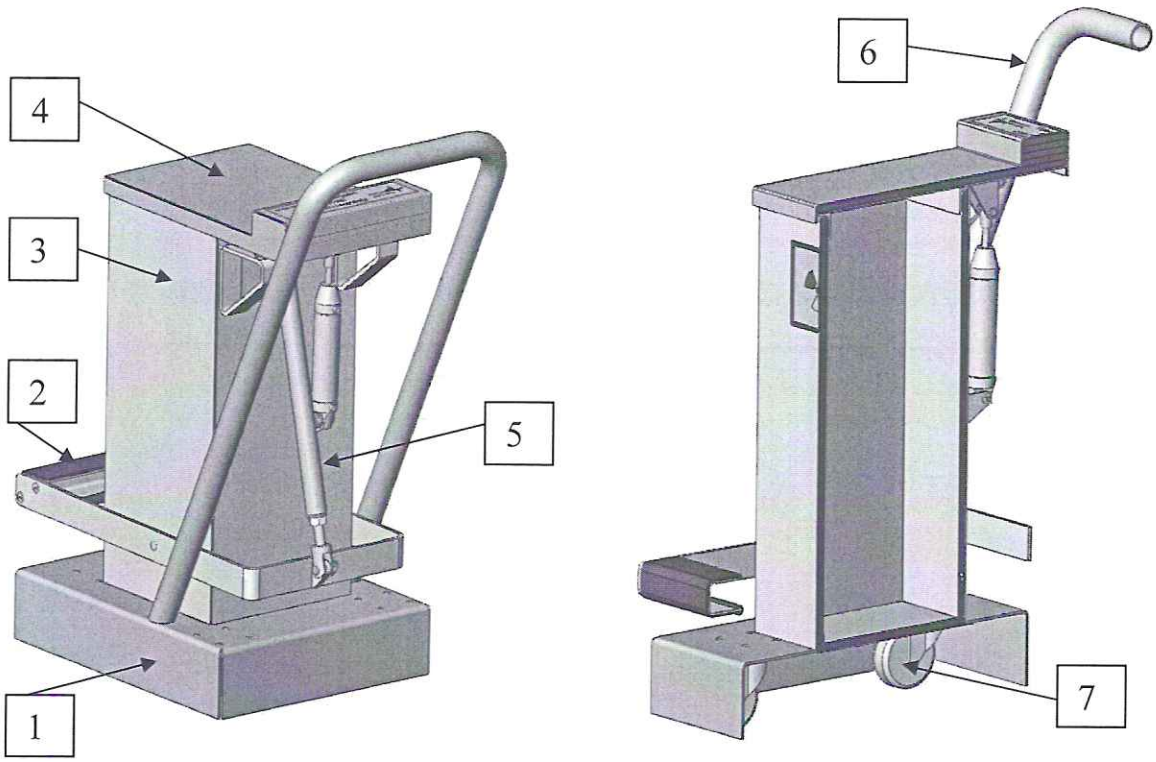


Рисунок 1 – Контейнер КС-403А.

1 - основание; 2 – корпус; 2 - педаль для открывания крышки; 4 - крышка;

5 – тяга механизма открывания крышки; 6 - ручка 7 - колеса

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование и тип	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-403А	АЖНС.942819.007-03	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-03ПС	1	

Комплектность проверил: _____

Дата _____

1292 Цфет 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы

Средний срок службы – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы - 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации;
- неправильное техническое обслуживание или несоблюдение периодичности технического обслуживания;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры);

3.2.5 При отказе в работе в период гарантийного срока изделие должно быть направлено изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.15,
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

1

3.2.6 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

12920 Иван 15.11.18

1 Зам 12920 Иван 15.11.18

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслужива-ния (ремонта)	Наработка		Осно-вание	Должность ФИО		Приме-чание
		после ремонта	с начала эксплуа тации		выполнив-шего работу	проверив -шего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии. Для уменьшения загрязнения внутренних поверхностей стенок контейнера рекомендуется использовать пластиковые мешки для сбора отходов. Для фиксации пластиковых мешков предусмотрена рамка из углового профиля.

При перемещении контейнера не совершать резких манёвров во избежание опрокидывания или столкновения с другими объектами. Движение контейнера по наклонным пандусам не предусмотрено.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

12920 Ифарб 19.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации контейнера можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

Перед утилизацией необходимо проконтролировать загрязненность стенок контейнера радиоактивными веществами, при превышении допустимых норм произвести дезактивацию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно – защитный типа КС-403А, заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

1298 Инвент 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	108-18			15.11.18
2		1,3			8	545-24			07.06.24

12910 Ибрэ 19.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»



_____ С.А. Ермилов

«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-404А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-04ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-404А

Паспорт

АЖНС.942819.007-04ПС

12900 07.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

07.06.24

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

12930 ИФВТ 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно – защитный типа КС-404А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для сбора твердых радиоактивных отходов (РАО) внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- емкость контейнера, л 10;
- свинцовый эквивалент защиты, мм 5;
- габаритные размеры, мм ..... 330×526×689;
- масса, кг .....54.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % ..... до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия

Контейнер является вспомогательным технологическим оборудованием для сбора твердых РАО.

Устройство контейнера показано на рисунке 1.


На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех металлических регулируемых по высоте опорах.

12900 26.06.24

И.о.н. 671-24 26.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

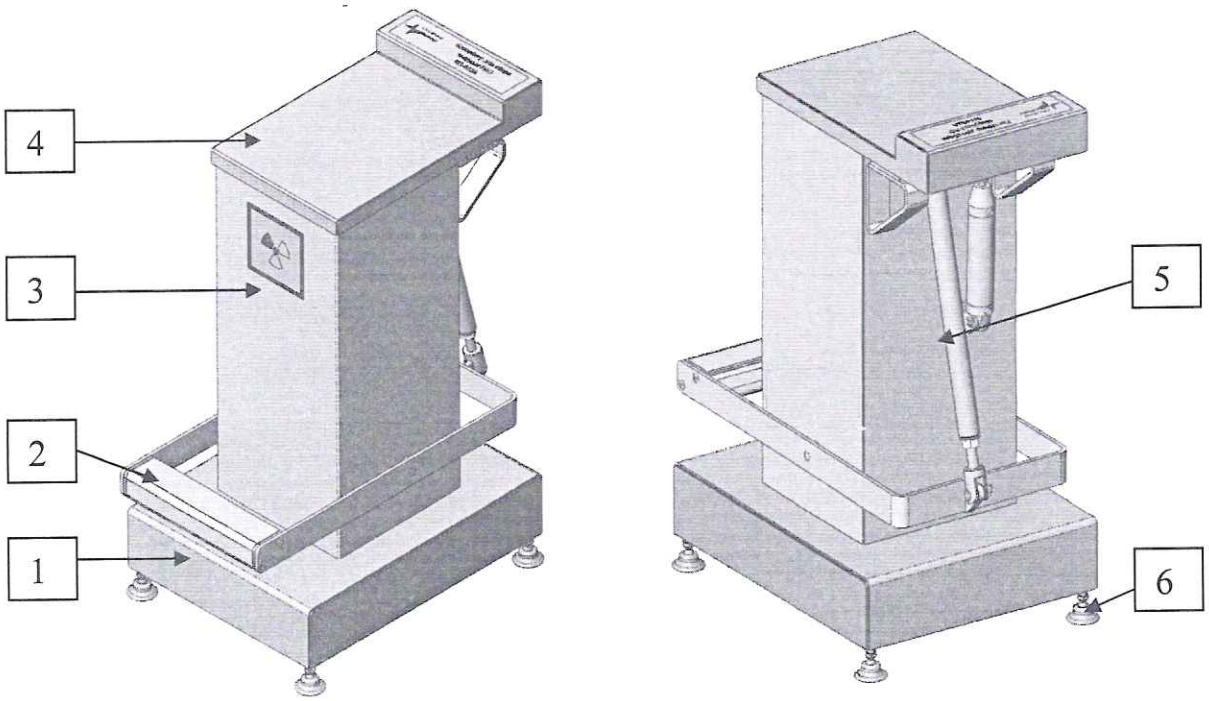

А Б

Рисунок 1 – Контейнер КС-404А

А – вид спереди, Б – вид сзади

1 - основание; 2 - педаль для открывания крышки; 3 – корпус; 4 - крышка;

5 – тяга механизма открывания крышки; 6 – опоры

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-404А	АЖНС.942819.007-04	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-04ПС	1	

Комплектность проверил: _____

Дата _____

12900 26.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

541-24 26.06.24

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Срок службы контейнера – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1Л по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации и перегрузки;
- неправильное техническое обслуживание или несоблюдение периодичности технического обслуживания;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры);

3.2.5 При отказе в работе в период гарантийного срока изделие должно быть направлено изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.15,
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

1

3.2.6 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслужива-ния (ремонта)	Наработка		Основание	Должность ФИО		Примечание
		после ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии, с учетом рекомендаций техники безопасности, а так же действующих правил и норм. Для уменьшения загрязнения внутренних поверхностей стенок контейнера рекомендуется использовать пластиковые мешки для сбора отходов. Для фиксации пластиковых мешков предусмотрена рамка из углового профиля.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

12930 Ивдат 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации контейнера можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

Перед утилизацией необходимо проконтролировать загрязненность стенок контейнера радиоактивными веществами, при превышении допустимых норм произвести дезактивацию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно – защитный типа КС-404А, заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12930 Ивэст 19.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	109-18			15.11.18
2		1, 3			8	77-22			04.05.22
3		1			8	538-24			07.06.24
4	—	3; 4	—	—	8	571-24	—		26.06.24

12930 Цфар 5 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»
_____ С.А. Ермилов
«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-405А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-05ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г.

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-405А

Паспорт

АЖНС.942819.007-05ПС

12940 07.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

07.06.24

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации и хранению	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

12940 Цфирт 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно – защитный типа КС-405А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для сбора и перемещения твердых радиоактивных отходов (РАО) внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- емкость контейнера, л 20;
- кратность ослабления, не менее,

  по I-131..... 5,8;
  по Cs-137..... 1,6;
  по Co-60..... 1,1;

- габаритные размеры, мм ..... 330×686×776;
- масса, кг ..... 63.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % ..... до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия

Контейнер является вспомогательным технологическим оборудованием для сбора и перемещения твердых РАО.

Устройство контейнера показано на рисунке 1.

На стальном основании закреплен свинцовый короб со свинцовой крышкой. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

12940 Шифр 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

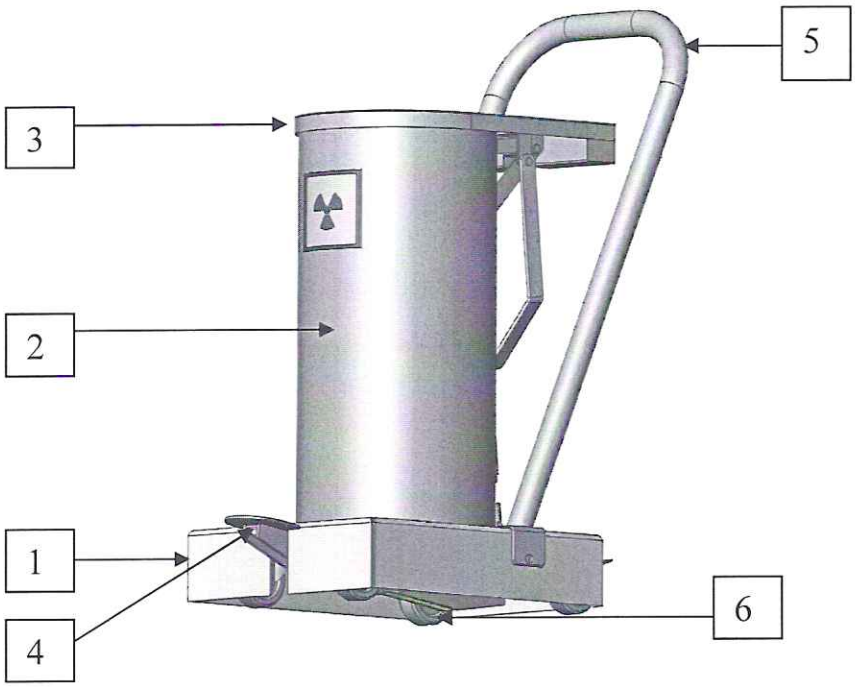


Рисунок 1 – Контейнер КС-405А.

1 - основание; 2 –корпус; 3 - крышка; 4 - педаль для открывания крышки;

5 - ручка; 6 – колеса

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-405А	АЖНС.942819.007-01	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-01ПС	1	

Комплектность проверил: _____

Дата _____

11940 Цфарт 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы

Средний срок службы – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы - 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации;
- неправильное техническое обслуживание или несоблюдение периодичности технического обслуживания;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры);

3.2.5 При отказе в работе в период гарантийного срока изделие должно быть направлено изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.15,
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

1

3.2.8 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

12940 Цфар 15.11.18

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

15.11.18

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания (ремонта)	Наработка		Основание	Должность, ФИО		Примечание
		после ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии. Для уменьшения загрязнения внутренних поверхностей стенок контейнера рекомендуется использовать пластиковые мешки для сбора отходов.

При перемещении контейнера не совершать резких манёвров во избежание опрокидывания или столкновения с другими объектами. Движение контейнера по наклонным пандусам не предусмотрено.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

11940 Ибфут 29.12.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации контейнера можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

Перед утилизацией необходимо проконтролировать загрязненность стенок контейнера радиоактивными веществами, при превышении допустимых норм произвести дезактивацию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно – защитный типа КС-405А, заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

129 40 Идфорт 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	110-18			15.11.18
2		1			8	339-24			07.06.24

11940 Цфат 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»

_____ С.А. Ермилов

«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-406А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-06ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г.

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г.

576886 Инв. № подл. 07.06 ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-406А

Паспорт

АЖНС.942819.007-06ПС

57684 26.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

572-24 26.06.24

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно-защитный КС-406А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для сбора твердых радиоактивных отходов (РАО) внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- емкость контейнера, л 20;
- кратность ослабления, не менее,
  - по I-131 ..... 5,8;
  - по Cs-137 ..... 1,6;
  - по Co-60 ..... 1,1;
- габаритные размеры, мм ..... 330×554×681;
- масса, кг ..... 59.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, % ..... до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия

Контейнер является вспомогательным технологическим оборудованием для сбора и перемещения твердых РАО.

Устройство контейнера показано на рисунке 1.

На стальном основании закреплен свинцовый короб со свинцовой крышкой. Крышка открывается с помощью педали, расположенной спереди.

Основание представляет собой сварной каркас из стального листа. Основание установлено на четырех металлических регулируемых по высоте опорах.

57687 04.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

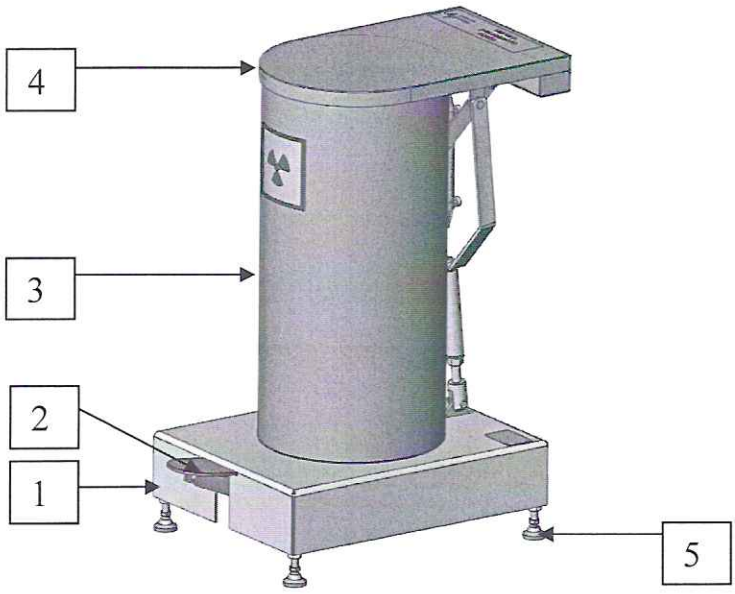


Рисунок 1 – Контейнер КС-406А

1 - основание; 2 – педаль для открывания крышки; 3 - корпус; 4 - крышка; 5 - опора

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-406А	АЖНС.942819.007-06	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-06ПС	1	

Комплектность проверил: _____

Дата _____

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы

Средний срок службы – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы - 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации;
- неправильное техническое обслуживание или несоблюдение периодичности технического обслуживания;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры);

3.2.5 При отказе в работе в период гарантийного срока изделие должно быть направлено изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.15
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

1

3.2.8 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания (ремонта)	Наработка		Основание	Должность, ФИО		Примечание
		после ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии. Для уменьшения загрязнения внутренних поверхностей стенок контейнера рекомендуется использовать пластиковые мешки для сбора отходов.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации контейнера можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

Перед утилизацией необходимо проконтролировать загрязненность стенок контейнера радиоактивными веществами, при превышении допустимых норм произвести дезактивацию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно - защитный КС-406А, заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	111-18			15.11.18
2		1			8	541-24			04.06.24
3	—	1	—	—	8	572-24	—		26.06.24

57687 04.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»

_____ С.А. Ермилов

«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-411А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-11ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-411А

Паспорт

АЖНС.942819.007-11ПС

11960 Шишч 03.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации и хранению	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

12960 Цфар 89.12.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно – защитный типа КС-411А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для снижения дозовой нагрузки на персонал при перемещении генераторов технеция внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- габаритные размеры, мм ..... 330×604×782;
- толщина свинцовой защиты не менее, мм 40;
- масса, кг .....155.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % ..... до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия

Контейнер является вспомогательным оборудованием для перемещения генераторов технеция.

Устройств контейнера показано на рисунке 1.

На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Основание представляет собой сварной каркас из стального листа, установленный на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

Дубл. Инв. № 03.06.24

3 Зам 503-2024 03.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

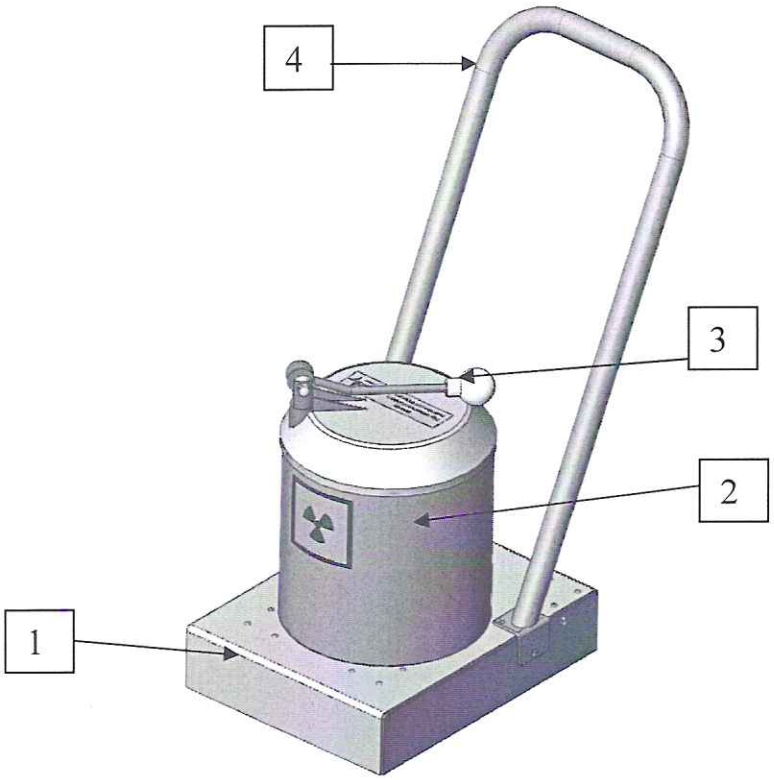


Рисунок 1 – Контейнер КС-411А

1 - основание; 2 –короб; 3 –рукоятка крышки контейнера;
4 – ручка.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-411А	АЖНС.942819.007-11	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-11ПС	1	

Комплектность проверил: _____
Дата _____

12960 Ивдт 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы

Средний срок службы – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации;
- неправильное техническое обслуживание или несоблюдение периодичности технического обслуживания;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры);

3.2.5 При отказе в работе в период гарантийного срока контейнер должен быть направлен изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.15,
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

12960 Цифра 15.11.18

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.2.6 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания (ремонта)	Наработка		Основание	Должность ФИО		Примечание
		после ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии. Особое внимание следует уделять безопасному выполнению операций загрузки и выгрузки генераторов технеция.

Перед началом работы производить осмотр рабочей зоны с целью обнаружения препятствий и иных предметов, угрожающих безопасности работника или оборудования. При движении не совершать резких манёвров во избежание опрокидывания контейнера или столкновения с другими объектами. Движение по наклонным пандусам не предусмотрено.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

12960 Ибарб 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации можно утилизировать содержащиеся в нем материалы, в том числе: сталь, свинец.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно – защитный типа КС-411А заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годным для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12960 Цфр 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	112-18		Ивар	15.11.18
2		1,3			8	78-22		Ивар	04.05.22
3	—	1,3	—	—	8	503-24	—	Ивар	03.06.24

12960 Ивар 29.12.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

НТЦ АМПЛИТУДА

ОКП 945240

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НТЦ Амплитуда»

_____ С.А. Ермилов

«15» ноября 2018 г.

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-431А

Паспорт

Лист утверждения
АЖНС.942819.007-31ПС-ЛУ

Старший инженер по стандартизации
_____ Е.А. Чикачева
«15» 11 2018 г.

Нормоконтролер
_____ И.А. Габрилович
«15» 11 2018 г.

Начальник отдела разработок
_____ Д.М. Шумаков
«15» 11 2018 г.

Зам. ген. директора по качеству
_____ О.А. Казакова
«15» 11 2018 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АМПЛИТУДА

ОКПД2 32.50.50.190

КОНТЕЙНЕР РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЙ ТИПА КС-431А

Паспорт

АЖНС.942819.007-31ПС

12970 07.06.24

07.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

1	Основные сведения об изделии и технические данные	3
2	Комплектность	4
3	Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии изготовителя	5
4	Учет технического обслуживания	6
5	Заметки по эксплуатации и хранению	6
6	Сведения об утилизации	7
7	Свидетельство о приемке.....	7
8	Особые отметки	7
	Лист регистрации изменений	8

12970 Цфет 29.12.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящий паспорт распространяется на контейнер радиационно – защитный типа КС-431А (далее по тексту - контейнер).

При эксплуатации контейнера наряду с указаниями настоящего паспорта необходимо выполнять инструкции и положения по предотвращению несчастных случаев, действующие на предприятии.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Контейнер предназначен для снижения дозовой нагрузки на персонал при перемещении фасовок РФП внутри объекта.

1.2 Основные технические характеристики:

- габаритные размеры, мм ..... 336×615×782;
- кратность ослабления, не менее,
  - по I-131 ..... $6 \cdot 10^5$;
  - по Cs-137 ..... 65;
  - по Co-60 ..... 7,7;
- масса, кг .....95.

1.3 Допустимые условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха, °С ..... от 10 до 35;
- относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % ..... до 80.

1.4 Индивидуальные особенности изделия

Контейнер является вспомогательным оборудованием для перемещений фасовок с РФП.

Устройство контейнера показано на рис. 1.

На стальном основании закреплен стальной короб с крышкой, стенки короба двойные, между стенками установлена свинцовая защита. Основание представляет собой сварной каркас из стального листа, установленный на четырех колёсах. Передние колёса поворотные.

12970 07.06.24

2 изм. 540-24 07.06.24

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

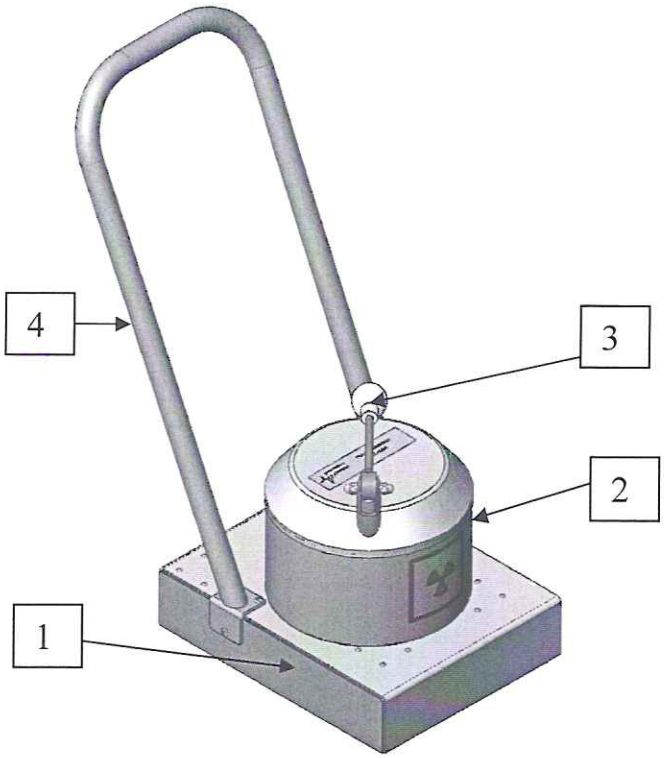


Рисунок 1 – Контейнер КС-431А

1 - основание; 2 – короб; 3 –рукоятка крышки контейнера;

4 – ручка.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2.1 - Комплект поставки

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Контейнер КС-431А	АЖНС.942819.007-31	1	
Паспорт	АЖНС.942819.007-31ПС	1	

Комплектность проверил: _____

Дата _____

12970 Ибф 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Ресурсы, сроки службы

Средний срок службы – 6 лет.

3.2 Гарантии изготовителя

3.2.1 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с момента продажи.

3.2.2 Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев в условиях 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2.3 Гарантийные обязательства вступают в силу при отказе изделия в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, обслуживания, транспортирования и хранения.

3.2.4 Гарантия не предоставляется в случаях:

- при ремонте или попытке ремонта покупателем или неуполномоченными на то третьими лицами;
- выход из строя из-за неправильной эксплуатации;
- повреждения вследствие механических воздействий и воздействий неблагоприятных внешних условий (влага, повышенные или пониженные температуры);

3.2.5 При выполнении изготовителем гарантийных претензий гарантийный срок не продлевается и новый гарантийный срок не начинается.

3.2.6 При отказе в работе изделия в период гарантийного срока изделие должно быть направлено изготовителю для ремонта вместе с паспортом.

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, а/я 120
Фактический адрес: г. Москва, г. Зеленоград, Проспект Генерала Алексеева, д.15
ООО «НТЦ Амплитуда»
Тел/факс (495) 777-1358, (495) 777-1359
Internet: www.amplituda.ru; e-mail: info@amplituda.ru

1

3.2.7 По истечении гарантийного срока изготовитель осуществляет сервисное обслуживание изделия на договорных условиях.

12970 Идат 15.11.18
15.11.18
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 4.1 - Учет технического обслуживания

Дата	Вид технического обслуживания	Наработка		Основание	Должность ФИО		Примечание
		после ремонта	с начала эксплуатации		выполнившего работу	проверившего работу	

5 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Контейнер можно эксплуатировать только в исправном техническом состоянии.

При перемещении не совершать резких манёвров во избежание опрокидывания или столкновения с другими объектами. Движение по наклонным пандусам не предусмотрено.

Дезинфекцию проводить в соответствии с МУ-287-113 путем двукратного обтирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в дезинфицирующем растворе и отжатой. Дезинфицирующий состав – 3 % раствор перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % синтетического моющего средства.

Дезактивацию проводить методом трехразовой обтирки марлевым тампоном, смоченным раствором синтетического моющего средства.

По окончании обработки составные части изделия протереть салфеткой из бязи или марли, смоченной дистиллированной водой, и высушить на воздухе в течение 2 ч.

12970 Цфайд 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Контейнер не содержит драгоценных металлов, вредных веществ и материалов и подлежит утилизации в обычном порядке.

После окончания эксплуатации тележки можно утилизировать содержащиеся в ней материалы, в том числе: сталь, свинец.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контейнер радиационно – защитный типа КС-431А, заводской номер №_____, изготовлен, испытан и принят в соответствии с действующей технической документацией, и признан годной для эксплуатации.

Ответственный за приемку

М.П.

_____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

8 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

12970 Цфаб 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					
1		5			8	113-18			15.11.18
2	-	1,3	-	—	8	540-24			07.06.24

12970 Цфдр 29.10.12

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru