

Литература:

1. Инструкция «О порядке направления водителей транспортных средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования», утв. МВД, Минздравом, Минюстом Республики Беларусь, введ. в действие с 01.07.94 г.
2. Положение о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.
Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 апреля 2011 г. № 497.
3. Методические указания по диагностике алкогольного опьянения. Приложение №3 к приказу по МЗ СССР №523 от 22.11.54 г.
4. Острые отравления. Диагноз. Лечение. Медицинское издательство. Бухарест, 1984 г.
5. Инструкция по применению прибора для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе ППС-1 и генератора контрольных смесей ГС-1 (Ра 2.840.112ДII). Рекомендована комиссией по приборам и аппаратам, приемлемым для исследования газообмена, газоанализа и газов в крови, Комитетом по новой медицинской технике Управления по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники – протокол №5 от 20.12.83 г. Утверждена 12.06.84 г.
6. Рекламные материалы фирмы Figaro Engineering Inc., Япония, префектура Осака, г. Миноо.
7. Если вы за рулем: Медицинские аспекты безопасности дорожного движения. – Мн.: Польша. 1989.



Прибор специализированный
определения концентрации паров этанола
в выдыхаемом воздухе

«АЛКОНТ 01СМ»

ФОРМУЛЯР

ТФАГ 413422.001-01 ФО



Содержание

Общие указания	4
Основные сведения об изделии	4
Основные технические данные	5
Индивидуальные особенности изделия	8
Комплектность	9
Указания мер безопасности	9
Подготовка к работе	10
8 Порядок работы при освидетельствовании	12
9 Контроль состояния системы. Возможные неисправности и способы их устранения	13
10 Ресурсы, сроки службы и хранения; гарантии изготовителя	19
11 Свидетельство об упаковке	20
12 Свидетельство о приемке	21
13 Движение изделия при эксплуатации	22
14 Учет работы изделия	23
15 Учет технического обслуживания	23
16 Работы при эксплуатации	25
17 Хранение	28
18 Ремонт	29
19 Особые отметки	30
20 Контроль состояния изделия и ведения формуляра	31
21 Перечень приложений	32

- менее 0,3 промилле - влияние алкоголя отсутствует;
- от 0,3 до 0,5 промилле - незначительное влияние алкоголя;
- от 0,5 до 1,5 промилле - легкое опьянение;
- от 1,5 до 2,5 промилле - опьянение средней степени;
- от 2,5 до 3 промилле - сильное опьянение.

По итогам проведения освидетельствования должностным лицом в протоколе процессуального действия, врачом – в акте освидетельствования отражается одно из следующих заключений:

1. Состояние на момент освидетельствования:
 - отсутствует состояние алкогольного опьянения и (или) состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;
 - состояние алкогольного опьянения;
 - состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;
 - состояние алкогольного опьянения и состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

2. Отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования.

Основным нормативным документом, определяющим отношение водителей к алкоголю, являются Правила дорожного движения, которые "запрещают управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения". Таким образом, ограничено трактуется важнейшее требование к психофизиологическому состоянию водителя, т. е. без учета воздействия на способность к вождению малых субклинических доз алкоголя (можно быть "нетрезвым", но "не пьяным"!; можно ли быть трезвым в состоянии похмелья?).

Пока же, Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а нормативные документы органов здравоохранения уточняют и определяют границы опьянения, которое начинается с 0,3 промилле (‰) алкоголя в крови (150 мкг/л в выдыхаемом воздухе) [2].

Водитель, выпивший рюмку водки, стакан вина, бокал пива, может быть официально признан трезвым при условии – концентрация алкоголя в крови не должна составлять и превышать 0,3 ‰ (150 мкг/л).

Приложением [2] узаконено в Республике Беларусь состояние алкогольного опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в крови в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.


В европейских и североамериканских странах дело обстоит несколько иначе, что можно проследить по нижеприведенным данным, взятым из журнала "NEWSWEEK".

Спиртные напитки, выпитые в течение одного часа (☞=1доза)*	Разрешенный предел для водителя, ‰ (мг/мл)	Страна	Вероятное состояние	Вероятность несчастных случаев со смертельным исходом
☞	0,2	Швеция	Легкое чувство теплоты и расслабления. Внимание может быть рассеянным.	Повышается в 1,2 раза
☞☞	0,5	Бельгия, Финляндия, Франция, Греция, Нидерланды, Норвегия, Португалия	Замедление реакций, затруднения при принятии оптимальных решений	Повышается в 4 раза
☞☞☞	0,8	Австрия, Британия, Канада, Дания, Германия, Ирландия, ряд штатов США	Нарушение общей координации. Контроль за скоростью и управлением затруднены.	Повышается в 10 раз
☞☞☞☞	1,0	Большинство штатов США	Заторможенность реакций делает даже нормальные условия дорожного движения опасными.	Повышается в 20 раз

* 1 доза включает в себя либо 1,5 унции ликера (44,4 мл), либо 4 унции вина (118,3 мл), либо 12 унций пива (355 мл).

** Приведено содержание алкоголя в крови для мужчины весом 170 фунтов (77 кг). Содержание алкоголя в крови для лиц с меньшей массой тела может быть выше, а с большей массой тела – ниже, чем приведенные в таблице.

В отечественной медицинской практике при диагностике степени опьянения в зависимости от концентрации алкоголя в крови используются следующие нормативы:

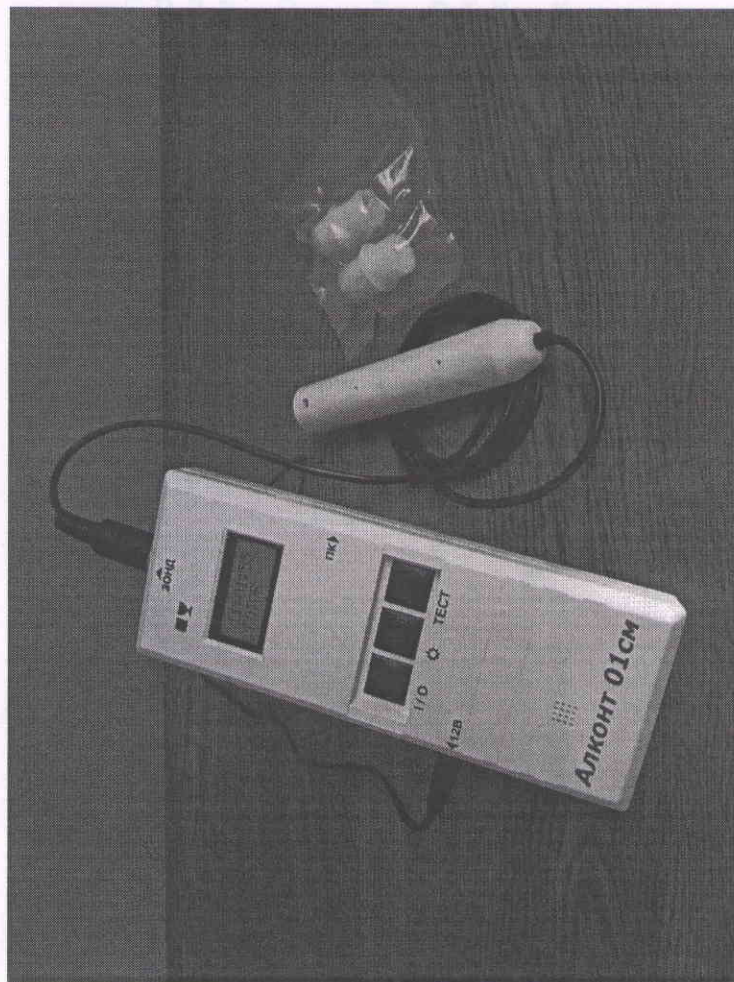

Адрес изготовителя, обслуживание, поверка, ремонт:

ООО «Брестское техническое агентство»

224 022, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Суворова 112

тел./факс. (8-0162) 52-56-58, (8-0162) 93-53-83, (8-017) 270-19-06

e-mail: microt@brest.by, <https://www.alcont.brest.by/>

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий формуляр предназначен для ознакомления обслуживающего персонала (пользователей) с устройством, принципом работы, техническими данными, правилами эксплуатации и технического обслуживания специализированного прибора определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01см» (в дальнейшем прибор).

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с формуляром изделия.

Формуляр должен постоянно находиться с прибором.

При записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо, после подписи проставляются фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче прибора на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01см» изготовлен в _____ 202_ г.

Заводской номер изделия

Сертификат об утверждении типа средств измерений (РБ) № 14513 от 1 ноября 2021 г. зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 25 0559 16 и допущен к применению в Республике Беларусь с 9 декабря 1997 года. Срок действия до 1 ноября 2026 г.

Сертификат об утверждении типа средств измерений (РФ): ВУ.С.31.999.А № 7803 от 22 апреля 2000 г. № Государственного реестра средств измерений: 19513-00

Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники (Украина) № UA-MI/3-649-2012 выдано 29 августа 2012 г.

Сертификат № 1162 о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан). Зарегистрирован в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 09.02.2022 г. за № KZ.02.03.00846-2022/14513. Действителен до 01.11.2026 г.

Декларация о соответствии Евразийского Экономического Союза Рег. № ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 02588 от 29.09.2021. Срок действия до 13 сентября 2026 г. включительно.

Значение диуреза для выведения алкоголя из организма обычно невелико: так, в первые часы выделяется всего 1-2 % введенного алкоголя. Однако, введение, наряду с алкоголем большого количества воды, а также мочегонных средств дает понижение максимальной концентрации алкоголя в крови и вместе с тем ослабление общих явлений опьянения.

Как отмечалось выше, концентрация алкоголя в крови здорового человека оказывается максимальной через 1-2 часа после приема алкоголя, и зависит не только от количества алкоголя, но и от индивидуальных особенностей организма.

Принимая во внимание все сказанное, имеющее отношение не только к крови, но и к другим биологическим средам организма человека, можно, исходя из них, установить ретроспективно не только факт употребления алкоголя, но и его приблизительное количество.

Количество выпитого алкогольного напитка и степень опьянения (для человека весом 60 кг) [6]

Количество алкогольного напитка*				Концентрация алкоголя в крови, мг/мл (‰)	Состояние
сухое вино (9% об. спирта) стакан, 0.1 л	пиво (4% об. спирта) бутылка, 0.5 л	саке (19% об. спирта) бокал, 0.18 л	виски (55% об. спирта) стопка, 0.04 л		
1,5 - 3	0,5 - 1	0,5 - 1	1 - 2	0,2 - 0,4	Появление чувства усталости, покраснение лица
3 - 6	2	1 - 2	2 - 5	0,5 - 1	Легкое опьянение, болтливость, замедление действий
6 - 9	3	3	6 - 7	1,1 - 1,5	Отмечается пошатывание, явление непонимания конечностей
15 - 20	5 - 7	5 - 7	10 - 15	> 1,6	Сильное опьянение, нечленораздельная речь, шатающаяся походка, возможны приступы тошноты

Примечание: * Возможны различия в зависимости от емкости посуды и крепости алкогольного напитка.

танные, несвязные; отмечается постепенный переход от чрезмерной говорливости к дизартрии. Притупляется чувствительность вообще, зрение и слух – в частности. Походка качающаяся, атаксическая, проявляется неуверенность в движениях нижних конечностей. В этой фазе отравившийся резко переходит от чрезмерно веселого настроения к приступам ярости, проявляет дезориентацию, спутанность, психические нарушения, ведущие к агрессивному поведению (противоправным действиям, несчастным случаям и т.д.). Нередко у отравившегося появляется рвота в результате острого спиртового гастрита.

Последняя фаза, в клиническом плане, **соответствует спиртовой коме (глубокая степень опьянения)**, концентрация спирта в крови составляет 4,0-5,5 ‰ [3] (превышает 2,5 ‰ [4]). В принципе спиртовая кома протекает спокойно, сопровождается признаками анестезии в связи со снотворным действием алкоголя. Костносухожильные рефлексы выпадают, зрачки нормальные или расширенные. В редких случаях появляются приступы судорог. Кома, вызванная потреблением сублетальной дозы спирта, продолжается 6-12 часов.

Глубокая спиртовая кома, наступающая после потребления летальной дозы спирта, затягивается и протекает со смертельным исходом за счет недостаточности дыхания или кровообращения.

По данным источника [3], концентрация алкоголя в крови выше 8,0 ‰ (10 мл спирта на 1 л крови) почти никогда не наблюдается у человека.

Констатируя в крови живого человека определенную концентрацию алкоголя, можно судить и о количестве выпитого им, принимая во внимание следующие обстоятельства:

1. Время, прошедшее от момента приема алкоголя до момента исследования. При этом надо учесть, что в организме человека перерабатывается за 1 час в среднем 7-10 см³ чистого алкоголя (5,5-8,0 г спирта) или 18-25 см³ 40° водки. Преобразование алкоголя в организме хронического алкоголика происходит обычно быстрее (но не более чем на 1/3). В вечерние часы алкоголь расщепляется в среднем на 25% быстрее, чем в утренние.
2. Концентрацию принятого испытуемым алкогольного напитка. Известно, что более крепкие напитки дают более высокую и быструю максимальную концентрацию алкоголя в организме, и наоборот.
3. Условия приема алкоголя. В одних случаях он может быть введен единовременно (или быстро следующими одна за одной порциями), в других случаях, наоборот, медленно, малыми порциями. Естественно, что в первом случае, имеющем большое судебно-экспертное значение, концентрация алкоголя в крови окажется более высокой и картина опьянения – более резкой. То же произойдет, если алкоголь принят на пустой желудок; прием же пищи до введения алкоголя ведет к более медленному всасыванию последнего и более мягкой картине опьянения (хотя и более длительной).

Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015 зарегистрирован в реестре Национальной Системы подтверждения соответствия Республики Беларусь **11 февраля 2022 г. № BY1112 05.01.003.01 00311**. Действителен до 10 февраля 2025 г.

Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 зарегистрирован в реестре Национальной Системы подтверждения соответствия Республики Беларусь **11 февраля 2022 г. № BY1112 05.06.003.01 00312**. Действителен до 10 февраля 2025 г.

2.1 Прибор предназначен для определения концентрации паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Как правило, используется в качестве детектора присутствия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

2.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, с верхним значением рабочей температуры 35 °С, с нижним значением рабочей температуры 10 °С.

2.3 Прибор соответствует группе 2 по ГОСТ 20790-93 с возможностью работы вне лечебных учреждений в служебных помещениях, в салонах автомобилей, а также на открытом воздухе без прямого воздействия осадков и солнечных лучей.

2.4 Питание прибора 12,6 ± 2 В, 230 В (+6 -10 %) (посредством сетевого адаптера).

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Прибор после включения должен обеспечивать автоматический контроль функционирования системы и подготовку к работе.

Время подготовки к работе – не более 15 мин.

3.2 Коэффициент пересчета входной величины прибора – концентрации паров этанола в паро-газовой смеси (мг/м³) в отображаемую выходную величину – концентрацию этанола в крови (‰) равен 450 (45 мг/м³ (0,045 мг/л) – 0,1 ‰ (промилле)).

3.3 Полный диапазон измеряемых значений входной величины – от 0 до 990 мг/м³, отображаемых в выходную величину – от 0 до 0,990 мг/л с дискретностью 0,001 мг/л (от 0,0 до 2,2 ‰, с дискретностью показаний 0,1 ‰).

3.4 Дополнительный диапазон экстраполируемых и отображаемых в специальном режиме значений входной величины свыше 990 мг/м³ в значения выходной величины от 0,990 мг/л (от 2,2 ‰) и выше (по верхней границе не лимитируется) – рассчитывается микро-ЭВМ прибора благодаря линейности измеряемой величины выше верхней границы нормируемого диапазона.

3.5 Приведенная погрешность прибора ($\gamma_{\text{пр}}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины I – от 0 до 500 мг/м³, отображаемых в выходные величины от 0 до 0,500 мг/л (от 0,0 до 1,1 %), не более (± 10) %.

3.6 Относительная погрешность ($\sigma_{\text{отн}}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины II – свыше 500 мг/м³ до 990 мг/м³, отображаемых в выходные величины > 0,500 до 0,990 мг/л (> 1,1 до 2,2 %), не более (± 10) %.

3.7 Продолжительность анализа пробы выдыхаемого воздуха по методике экспресс-теста – не более 15 с.

3.8 Продолжительность подготовки прибора к следующему тесту после пробы с концентрацией паров этанола в воздухе на уровне 450 мг/м³ (0,450 мг/л, 1,0 %) – не более 40 с.

3.9 Максимальная электрическая мощность, потребляемая прибором, – не более 6,0 Вт.

3.10 Масса прибора – не более 0,4 кг.

3.11 Габаритные размеры прибора без разъемов, соединительных шнуров и выносных частей – 191×74×27 мм.

3.12 Средняя наработка прибора на отказ – не менее 6000 ч.

3.13 Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 8 ч в сутки.

3.14 Среднее время восстановления работоспособности прибора путем замены отказавшего газового сенсора – не более 30 мин.

3.15 Средний срок сохранения прибора должен быть не менее 6 месяцев.

3.16 Устройство и принцип работы.

Прибор «Алконт 01см» представляет собой (рис. 1) пластмассовый блок, имеющий на лицевой панели (поз. 1) двухстрочный жидкокристаллический дисплей (поз. 5) с организацией 2×8 символов, «окошко» сигнального светодиода (поз. 6) и три кнопки управления: левая (поз. 3) – включения/выключения прибора (I/O); средняя (поз. 4) – включения/выключения подсветки дисплея (⚡); правая (поз. 10) – вызова режима (ТЕСТ).

На левой боковой поверхности прибор имеет разъем-вилку (поз. 2) для подключения источника питания (маркировка «12 В»), на верхней торцевой – разъем-розетку (поз. 7) для стыковки сенсорного зонда с мундштуком (поз. 12, 11) (маркировка «ЗОНД»). На боковой поверхности справа находится разъем mini-USB (поз. 9) для подключения прибора к персональному компьютеру (маркировка «ПК»).

Изделие имеет съемную приборную ножку-подставку (поз. 8) для его установки на горизонтальной поверхности при эксплуатации.

На задней поверхности корпуса расположена товарная табличка.

трация спирта в крови до 1,0 ‰ (промилле) в принципе достигается после потребления 1 грамма чистого спирта на 1 кг веса. Предельная концентрация спирта в крови отмечается спустя 20 - 30 минут после потребления спирта на голодный желудок или спустя 1 - 2 часа после еды. Наибольшая часть поглощаемого спирта концентрируется в головном мозге, остальная часть, в нисходящем порядке, в других органах – легких, селезенке, почках. Скапливающееся в печени количество спирта нелегко определить, поскольку в этом органе происходит его биологическое преобразование.

Этиловый спирт не накапливается в организме, он удаляется быстро, стойким ритмом с момента его появления в тканях. Наибольшая доза поглощаемого спирта (90 - 95%) подлечит метаболизму и лишь незначительная часть (5 - 10 %) удаляется как таковая с мочой (2 - 4 %) и выдыхаемым воздухом (3 - 7 %). Рост мочеотделения или гипервентиляция не ускоряют существенно удаление спирта из организма. Биохимическое преобразование спирта осуществляется микро索ами печени под воздействием фермента – алкогольдегидрогеназы.

Симптомология острого алкогольного отравления тесно связана с концентрацией спирта в крови. При этом, ее течение трехфазное: фаза возбуждения (легкая степень опьянения), фаза судебной медицины (выраженное опьянение, средняя степень опьянения), фаза коматозного состояния (глубокая степень опьянения).

В ряде источников, в том числе, использованных [3], [4], данные о содержании алкоголя в крови, сопутствующими каждой из фаз, несколько отличаются, хотя данные источника [4] более современны.

В фазе возбуждения (легкая степень опьянения), когда концентрация спирта в крови составляет 0,8-1,6 ‰ [0,5-1,5 ‰], у отравившегося отмечаются состояние эйфории, экспансивность, несдержанность и невозможность точного определения опасности. Способность наблюдения, острота зрения и слуха, быстрота рефлекторной реакции и вообще, как психическая, так и физическая способность снижены. Вот поэтому эта фаза неправильно названа “возбуждением”, поскольку она является результатом угнетающего действия этилового спирта на высшие нервные центры, выполняющие контрольную и управляющую функции в отношении низших центров. В связи с этим развивается чрезмерная необузданная активность низших центров, ускользающих из под контроля высших центров, находящихся в угнетенном состоянии. Это объясняет причину, по которой, на этой стадии, у отравившегося проявляется необузданность инстинктов и бесконтрольное – самопроизвольное и мерее критическое поведение. В этой же фазе происходит расширение периферических сосудов, создающее ощущение тепла.

В следующей фазе, названной судебно-медицинской (средняя степень опьянения, или выраженное опьянение), которая соответствует концентрации спирта в крови 1,6-3,2 ‰ [1,5-2,5 ‰], у отравившегося наблюдаются хорошо известные проявления алкогольного опьянения. Мысли спут-

Испытуемый должен быть опрошен на предмет употребления накануне измерения алкогольных напитков, лекарств, а также курения. В последнем случае измерение проводится не раньше, чем через 3 минуты после курения; в случае применения терапевтической дозы спиртосодержащих лекарств измерение проводится не раньше, чем через 15-20 минут после их приема.

При освидетельствовании водителя должен знать (и указывать на это проверяющему), что любой прибор имеет установленную погрешность, которая обязательно отражена в его эксплуатационной документации.

Важно учитывать и то, что ошибки измерения при освидетельствовании могут быть вызваны присутствием в окружающем воздухе низкомолекулярных летучих углеводородов – например, ацетона, метанола или этанола.

II. При широком практическом применении методов диагностики алкогольного опьянения следует иметь в виду следующие обстоятельства:

1. Методы диагностики должны быть по возможности просты, быстры, не требовать сложной аппаратуры.
2. Методы не должны быть тягостны для испытуемого (что имеет место при взятии проб крови, содержимого желудка и т.д.).
3. Необходимо строго учитывать разнообразие реакций на алкоголь отдельных лиц, обстоятельства, при которых был принят алкоголь, наличие клинических синдромов опьянения; помня, что проба на алкоголь в биологических средах (выдыхаемом воздухе, крови, моче, слюне и т.д.) является подсобным методом, помогающим врачу ориентироваться в состоянии испытуемого. Это соображение всегда надо иметь в виду во избежание возможных диагностических ошибок.
4. При любом из биохимических и физико-химических методов возможны отдельные ошибочные показания как в силу недостаточной концентрации алкоголя в исследуемой среде, так и вследствие неполной специфичности того или иного метода определения алкоголя.

Поэтому отрицательная реакция на алкоголь еще не исключает наличия опьянения и, наоборот, положительная (особенно слабо положительная, сомнительная) не является сама по себе доказательством опьянения.

Несмотря на довольно значительные индивидуальные различия в реакции на алкоголь, все же многие исследования концентрации алкоголя в крови указывают на известную последовательность и закономерность распространения алкоголя в организме и фаз алкогольного опьянения.

В организме человека содержится небольшое количество этилового (винного) спирта, образующегося при промежуточном метаболизме или брожении в пищеварительном тракте. Концентрация этого спирта в крови обычно не превышает 0,03 мг/мл (‰).

Винный спирт быстро поглощается пищеварительным трактом посредством слизистых оболочек рта, желудка и кишечника, и также быстро распространяется в тканях, где подвергается процессам метаболизма. Концен-

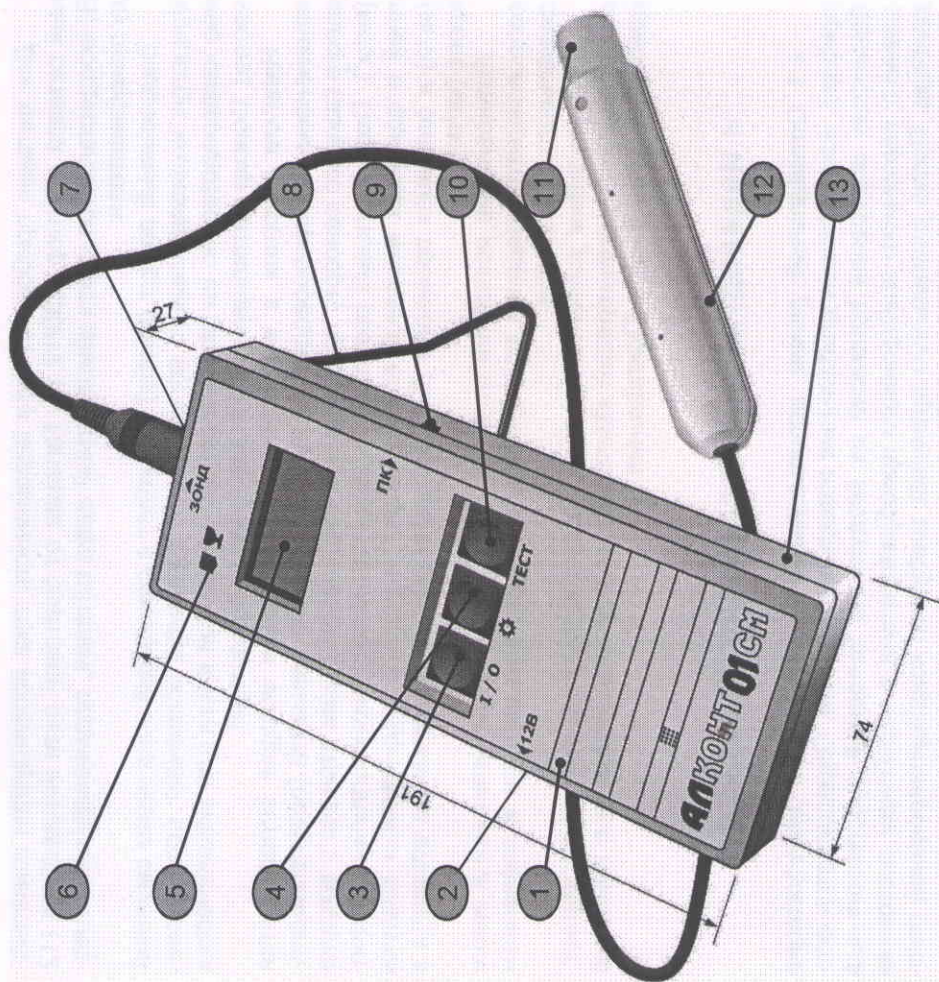


Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры прибора "Алkont 01cm".

- | | |
|--|--|
| 1 – крышка; | сенсорного зонда; |
| 2 – разъём (вилка) подключения источника питания 12 В; | 8 – съёмная ножка – подставка; |
| 3 – кнопка включения/выключения прибора; | 9 – разъём (розетка) подключения шнура связи с персональным компьютером; |
| 4 – кнопка включения/выключения подсветки дисплея; | 10 – кнопка вызова режима "ТЕСТ"; |
| 5 – дисплей; | 11 – мундштук индивидуального пользования; |
| 6 – сигнальный светодиод; | 12 – сенсорный зонд; |
| 7 – разъём (розетка) подключения | 13 – корпус. |

Для питания прибора от сети переменного тока используется комплектный сетевой адаптер (230/12 В). Питание от бортовой сети автомобиля (12 В) осуществляется через комплектный шнур питания, подключаемый к гнезду прикуривателя.

Выдыхаемый воздух (проба) поступает в сенсорный зонд через сменный мундштук индивидуального пользования. Мундштук исключает проникновение непосредственно на газовый сенсор капельной влаги или механических частиц. Сенсор вентилируется при извлечении мундштука.

Наличие алкоголя в выдыхаемом испытуемым воздухе определяется изменением электропроводности чувствительного элемента (полупроводникового газового сенсора) пропорционально концентрации этанола в воздухе (мг/м^3). Окончательный результат выводится на жидкокристаллический дисплей в единицах массовой концентрации этанола в выдыхаемом воздухе (мг/л) и единицах промилле (‰), соответствующих содержанию алкоголя в крови (мг/мл).

Установление показаний от 0,150 мг/л (0,3 ‰) (включительно) и выше сопровождается подачей повторяющегося звукового сигнала и свечением сигнального светодиода.

Обязательным условием достоверности результатов измерений является соблюдение рекомендаций «Методики освидетельствования с помощью прибора "Алкотест-01см"» (Приложение 1).

4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Оптимальный режим использования – ежедневная эксплуатация прибора, исключая длительные перерывы в работе. Определяется особенностью осаждения примесей из воздуха на холодный чувствительный элемент первичного электронного преобразователя в нерабочем состоянии прибора. После длительного хранения требуется кондиционирование газового сенсора – тренировка прибора во включенном состоянии для восстановления эксплуатационных кондиций (п. 15.1.3). С этим связаны требования к условиям текущего хранения: хранить сенсорные зонды с приборами в вентилируемых (проветриваемых) помещениях вдали от мест хранения (разлива) растворяемых, источников дыма.

4.2 Внимание, недопустимо попадание чистых растворяемых (спирта, ацетона и т. п.) или их растворов на газовый сенсор, части сенсорного зонда и прибор, а также использование указанных жидкостей для обработки (протирки) прибора и его частей.

4.3 Прибор имеет стеклянный экран дисплея на жидких кристаллах, требующий мер предосторожности при эксплуатации, упаковке, погрузке, выгрузке, транспортировании, извлечении из упаковки.

Освидетельствование в медицинских учреждениях для установления состояния опьянения проводится в любое время суток специально подготовленными врачами в:

- специальных кабинетах наркологических диспансеров;
- определенных органами здравоохранения лечебно-профилактических учреждений;
- передвижных специализированных медицинских автолабораториях.

Если проведение освидетельствования в полном объеме не представляется возможным из-за тяжести или характера полученных травм, то в лечебном учреждении в обязательном порядке должны проводиться исследования для установления наличия алкоголя в биологических средах (выдыхаемый воздух, моча, кровь, слюна).

Любому водителю, проходящему освидетельствование, необходимо знать, что при проведении освидетельствования врачом медицинского учреждения в двух экземплярах акт освидетельствования физического лица на предмет выявления состояния опьянения, удостоверенный подписью и печатью врача. Первый экземпляр акта освидетельствования выдается должностному лицу, доставившему физическое лицо в организацию здравоохранения, второй – хранится в организации здравоохранения.

Не стоит, что часто бывает, пытаться скрыть от правоохранительных органов свои паспортные данные. Лицо, направляющее на освидетельствование, обязано принять меры к установлению личности водителя, а врач – удостовериться в личности водителя путем ознакомления с соответствующим документом. **Отсутствие личных документов не служит основанием к тому, чтобы не проводить освидетельствование водителя.** При отсутствии таких документов в протоколе фиксируются приметы обследуемого, указывается, что данные о его личности записаны со слов освидетельствуемого.

Организация здравоохранения при обращении физического лица, в отношении которого проводилось освидетельствование, за получением информации о его результатах выдает ему медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую заключение, вынесенное по результатам освидетельствования, в порядке, установленном законодательством.

При подозрении на наличие у обследуемого лица травматических повреждений или заболевания, внешние проявления которого сходны с признаками алкогольного опьянения, такой водитель после оказания первой медицинской помощи (если она требуется) должен быть доставлен в лечебное учреждение для оказания основной помощи и освидетельствования на предмет опьянения.

В специальных приборах концентрация алкоголя в крови определяется косвенным методом, путем регистрации паров спирта в выдыхаемом воздухе. Данные приборы могут эксплуатироваться в строгом соответствии с их эксплуатационной документацией.

Методические указания
по диагностике алкогольного опьянения
с использованием специальных технических средств
(специализированных приборов определения
концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
«Алконт-01с»)

Освидетельствование физических лиц с целью установления состояния алкогольного опьянения имеет два взаимосвязанных аспекта: юридический и медицинский (клинико-диагностический). Незнание основ содержания этих двух составляющих приводит к конфликтам, жалобам, судебным разбирательствам.

В Республике Беларусь порядок освидетельствования был юридически закреплён в Инструкции «О порядке направления водителей транспортных средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования», утвержденной МВД, Минздравом и Минюстом РБ, и введенной в действие с 01.07.1994 года [1]. С 12.08.2011 года вступило в действие «Положение о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 апреля 2011 г. № 497 [2]. Это говорит о значимости сохранения и защиты прав граждан, подвергающихся подобной процедуре, а также о необходимости знания и соблюдения указанного порядка самими водителями.

1. Освидетельствование водителей транспортных средств, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения (перечень действий и признаков, наличие которых является достаточным основанием полагать, что физическое лицо, в отношении которого ведётся административный процесс, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения – согласно Приложению 1 к Положению [2]), проводится лицами, средствами, в местах и в порядке, установленных Положением [2].

При уклонении лица от освидетельствования составляется протокол, в котором указываются признаки опьянения и действия нарушения, по уклонению от освидетельствования.

Уклонение водителя от освидетельствования ни к чему хорошему не приведет: факт опьянения будет установлен инспектором Государственной инспекции лично и зафиксирован в протоколе, что уже никак не опровергнешь.

4.4 При переключении режимов работы прибора из-за специфики системы опроса измерительных каналов, иногда, на время до 1 секунды, на дисплее могут появляться переходные сообщения.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Количество	Заводской номер	Примечание
ТФАГ 413422.001-01	Прибор "Алконт 01с"	1		
<i>Комплект принадлежности:</i>				
ТФАГ 713423.001	мундштук	100		
AC-DC ADAPTER 230V/12V	блок питания 12 В / 500 мА	1		
ТФАГ 465139.001-01	шнур питания от бортовой сети	1		
ТФАГ 465644.001-01	шнур связи с ПК	1		
ТФАГ 304274.001	опора	1		
www.alcont.brest.by (Alc.exe)	программа поддержки для ПК	—		сайт
ТФАГ 413422.001-01ФО	формуляр	1		
МРБ МП.367-2021	методика поверки	1		
СТБ 1015-97	упаковка	1		

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К обслуживанию прибора допускаются лица только после инструктажа по технике безопасности и ознакомления с настоящим формуляром.

6.2 При эксплуатации прибора с использованием сетевого адаптера от электросети 230 В / 50 Гц использовать только исправные розетки.

6.3 Во избежание выхода прибора из строя не допускать попадания конденсированной влаги на корпус изделия, выносные части, сетевой адаптер; оберегать приборы от механических ударов, термических воздействий; не разбирать изделие, сетевой адаптер, шнуры связи, а также сенсорный зонд.

6.4 Запотевание изделия и его частей устранять протиранием х/б салфеткой.

6.5 Запрещается использовать не входящие в комплект поставки адаптеры, шнуры связи, мундштуки для работы с прибором, а также прибор и комплектные изделия не по назначению.

6.6 Приборы должны применяться и эксплуатироваться только в режимах и условиях, установленных ТУ РБ 28801552.004-99 и отраженных в формуляре ТФАГ 413422.001-01 ФО.

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Раслаковать прибор и проверить его комплектность.

7.2 Произвести внешний осмотр прибора, определить его целостность.

7.3 Присоединить сенсорный зонд к разъему "ЗОНД" прибора.

7.4 При работе от сети переменного тока, соединить комплектный сетевой адаптер с разъемом "12 В" прибора, включить вилку адаптера в сетевую розетку (230 В / 50 Гц).

7.5 При работе от бортовой сети, соединить комплектный шнур питания от бортовой сети с разъемом "12 В" прибора, включить вилку шнура в розетку прикуривателя.

Примечание: Потребитель по желанию может использовать ножку подставку.

7.6 Включить прибор. Включение (выключение) производится нажатием кнопки $< I / O >$ с удержанием её 2-3 секунды (включение) до появления звукового сигнала и названия прибора на дисплее.

Сразу же после включения, одновременно со звуковым сигналом, на дисплее появится сообщение

АЛКОНТ
01см

7.7 Система прибора после включения обеспечивает постоянный автоматический контроль функционального состояния в процессе работы. В случае обнаружения нарушений в работе частей системы выдается одно из сообщений:

ГАЗ.СЕН.
ОБРЫВ

обрыв в цепи газового сенсора.

Появление контрольного сообщения вида:

КОНТРОЛЬ
СИСТЕМЫ

$$\begin{aligned} \text{смесь 6 (II)} \quad \gamma_{\text{пр}} &= \frac{1,9 - 2,0}{2,0} \cdot 100 = -5 \% \text{ (норма по [1] } \pm 15 \%); \\ \text{смесь 1 (I)} \quad \gamma_{\text{пр}} &= \frac{0,1 - 0,1}{0,5} \cdot 100 = 0 \% \text{ (норма по [1] } \pm 20 \%); \\ \text{смесь 2 (I)} \quad \gamma_{\text{пр}} &= \frac{0,2 - 0,2}{0,5} \cdot 100 = 0 \% \text{ (норма по [1] } \pm 20 \%); \\ \text{смесь 3 (I)} \quad \gamma_{\text{пр}} &= \frac{0,7 - 0,5}{0,5} \cdot 100 = +40 \% \text{ (норма по [1] } \pm 20 \%); \end{aligned}$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{\text{пр}}$) для данного диапазона. Результаты поверки отрицательные.

$$\begin{aligned} \text{смесь 4 (II)} \quad \gamma_{\text{пр}} &= \frac{0,5 - 0,6}{2,0} \cdot 100 = -5 \% \text{ (норма по [1] } \pm 15 \%); \\ \text{смесь 5 (II)} \quad \gamma_{\text{пр}} &= \frac{0,9 - 1,0}{2,0} \cdot 100 = -5 \% \text{ (норма по [1] } \pm 15 \%); \\ \text{смесь 6 (II)} \quad \gamma_{\text{пр}} &= \frac{1,6 - 2,0}{2,0} \cdot 100 = -20 \% \text{ (норма по [1] } \pm 15 \%); \end{aligned}$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{\text{пр}}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

Библиография:

- [1] ТУ РБ 28801552.004-99. Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алkont 01с», «Алkont 01см», «Алkont 01су», «Алkont 01са». Технические условия. Формуляры
- [2] ТУ 4381-043-21298618-2009. Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-META-02М. Технические условия
- [3] Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений, утверждённые постановлением Госстандарта от 21 апреля 2021 г. № 40

7.11 Связь с персональным компьютером обеспечивается в любом режиме работы прибора. Единственное условие обеспечения связи – прибор должен быть включен (в любом режиме)!

7.12 Однократное нажатие кнопки  в режиме работы прибора включает подсветку дисплея. Последующее нажатие выключает подсветку.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ

8.1 Для проведения определения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом испытуемым воздухе, следует, руководствуясь рекомендациями Приложения 1, плотно (до упора) вставить в сенсорный зонд, соблюдая требования санитарной гигиены, ответной короткой частью мундштук индивидуального пользования.

8.2 Пользователь инструктирует испытуемого и однократным нажатием кнопки **<TEST>** выводит прибор из режима ожидания ("ГОТОВ") в состояние готовности к проведению теста, при этом на дисплее устанавливается сообщение вида:

00*TEST*
Алк: 0.0 ‰

8.3 Обследуемый сидит, на фоне спокойного дыхания, захватив мундштук губами и, удерживая зонд любой рукой, делает один полный энергичный выдох длительностью не менее 3 секунд.

После окончания выдоха испытуемый освобождает губы от мундштука и кладет сенсорный зонд, не извлекая мундштук из зонда до окончания теста.

8.4 Если испытуемый выполнил все действия правильно, то после подачи звукового сигнала включается таймер. Следующим подтверждением состоятельности теста является сопровождаемое звуковым сигналом появление сообщения вида:

03*ДОЗА*
Алк: 0.2 ‰

Это значит, что через измерительную ячейку прошло необходимое для проведения теста количество выдыхаемого воздуха.

Окончательный результат фиксируется на дисплее на 13 секунде с подачей звукового сигнала и имеет вид:

0,150 мг/л
Алк: 0.3 ‰

Если показания прибора достигли значения 0,150 мг/л (0,3 ‰) или выше, то после остановки теста с выдачей окончательного результата раздается по-

$$\gamma_{\text{пр. Y}}^I = \frac{1,2 - 1,1}{1,1} \cdot 100 = 9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%)).$$

В.2 Определение относительной погрешности $\sigma_{\text{отн.}}^{\text{II}}$:

$$\text{смесь 4 (II): } \sigma_{\text{отн. X}}^{\text{II}} = \frac{0,495 - 0,540}{0,540} \cdot 100 = -8 \%,$$

$$\sigma_{\text{отн. Y}}^{\text{II}} = \frac{1,1 - 1,2}{1,2} \cdot 100 = -8 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\text{смесь 5 (II): } \sigma_{\text{отн. X}}^{\text{II}} = \frac{1,035 - 0,990}{0,990} \cdot 100 = 5 \%,$$

$$\sigma_{\text{отн. Y}}^{\text{II}} = \frac{2,3 - 2,2}{2,2} \cdot 100 = 5 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%)).$$

В.3 Определение приведенной погрешности прибора, $\gamma_{\text{пр.}}^I$:

$$\text{смесь 1 (I): } \gamma_{\text{пр. X}}^I = \frac{0,045 - 0,090}{0,5} \cdot 100 = -9 \%,$$

$$\gamma_{\text{пр. Y}}^I = \frac{0,1 - 0,2}{1,1} \cdot 100 = -9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\text{смесь 2 (I): } \gamma_{\text{пр. X}}^I = \frac{0,180 - 0,180}{0,5} \cdot 100 = 0 \%,$$

$$\gamma_{\text{пр. Y}}^I = \frac{0,4 - 0,4}{1,1} \cdot 100 = 0 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\text{смесь 3 (I): } \gamma_{\text{пр. X}}^I = \frac{0,360 - 0,495}{0,5} \cdot 100 = -27 \%,$$

$$\gamma_{\text{пр. Y}}^I = \frac{0,8 - 1,1}{1,1} \cdot 100 = -27 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{\text{пр.}}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

В.4 Определение относительной погрешности $\sigma_{\text{отн.}}^{\text{II}}$:

$$\text{смесь 4 (II): } \sigma_{\text{отн. X}}^{\text{II}} = \frac{0,585 - 0,540}{0,540} \cdot 100 = 8 \%,$$

$$\sigma_{\text{отн. Y}}^{\text{II}} = \frac{1,3 - 1,2}{1,2} \cdot 100 = 8 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

Приложение В (обязательное)

Примеры расчетов по обработке результатов измерений при определении метрологических характеристик приборов

таблица В.1 – Примеры расчетов для приборов, выпущенных после 30.08.2021

Воздействующая парогазовая смесь, номер диапазона	Номинальное значение массовой концентрации паров этанола в воздействующей смеси X_0 , мг/м ³ (мг/л)	Номинальное значение выходной характеристики приборов Y_0 , мг/л / ‰	Фактические показания прибора при воздействии смесей X , мг/л, / Y , ‰
1	90 (0,090)	0,090 / 0,2	0,090 / 0,2
2 (I)	180 (0,180)	0,180 / 0,4	0,225 / 0,5
3	495 (0,495)	0,495 / 1,1	0,540 / 1,2
4 (II)	540 (0,540)	0,540 / 1,2	0,495 / 1,1
5	990 (0,990)	0,990 / 2,2	1,035 / 2,3
1	90 (0,090)	0,090 / 0,2	0,045 / 0,1
2 (I)	180 (0,180)	0,180 / 0,4	0,180 / 0,4
3	495 (0,495)	0,495 / 1,1	0,360 / 0,8
4 (II)	540 (0,540)	0,540 / 1,2	0,585 / 1,3
5	990 (0,990)	0,990 / 2,2	1,125 / 2,5

В.1 Определение приведенной погрешности прибора, $\gamma_{пр}^I$, %

смесь 1 (I)
(таблица 3):

$$\gamma_{пр.X}^I = \frac{0,09 - 0,09}{0,5} \cdot 100 = 0 \%,$$

$$\gamma_{пр.Y}^I = \frac{0,2 - 0,2}{1,1} \cdot 100 = 0 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%) \text{);}$$

смесь 2 (I):

$$\gamma_{пр.X}^I = \frac{0,225 - 0,180}{0,5} \cdot 100 = 9 \%,$$

$$\gamma_{пр.Y}^I = \frac{0,5 - 0,4}{1,1} \cdot 100 = 9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%) \text{);}$$

смесь 3 (I):

$$\gamma_{пр.X}^I = \frac{0,540 - 0,495}{0,5} \cdot 100 = 9 \%,$$

вторяющийся через равные промежутки времени звуковой сигнал, который дублируется свечением контрольного светодиода.

8.5 После завершения теста необходимо извлечь мундштук из зонда для вентиляции газового сенсора и однократно нажать кнопку <TEST> для продолжения работы. Прибор автоматически готовится к работе. Признак готовности к продолжению работы – появление сообщения вида:

13:59:15
ГОТОВ

8.6 Если испытуемый дует в мундштук недостаточно сильно или не дует вообще – тест не запускается и сохраняется сообщение:

00*TEST*
Алк:0.0‰

8.7 Если испытуемый делает выдох необходимой силы, но недостаточной продолжительности, или прерывистый выдох – после подачи звукового сигнала запускается таймер, но в момент установления прибором несоответствия характеристики пробоотбора норме, тест прерывается с выводом на дисплей сообщения вида:

02*ЛОЖ-
НЫЙ ТЕСТ

которое сопровождается периодической подачей звукового сигнала. Для выхода в режим продолжения дальнейшей работы необходимо однократно нажать кнопку <TEST>.

8.8 При любом варианте неправильных действий испытуемого тест необходимо повторить.


9 КONTPOЛЬ СOCTOЯHИЯ СИСТЕМЫ. BOЗMOЖHЫЕ HEИCПPABHOCTИ И CПOCOБЫ ИX YCTPAHEHИЯ

Система прибора позволяет контролировать возможные неисправности с помощью ряда контрольных сообщений (см. п. 7.7). Кроме этого, существует возможность "просмотра" состояния системы как с помощью персонального компьютера (см. Приложение 2 формуляра), так и с дисплея прибора. Для этого необходимо включить прибор, удерживая кнопку <⏏>. Появится сообщение вида:

BTA (c)
V.17

(начало цикла просмотра)
"Наименование разработчика и номер рабочей версии программного обеспечения прибора"

Последующие сообщения "перебираются" циклически однократными нажатиями кнопки <TEST>, например:

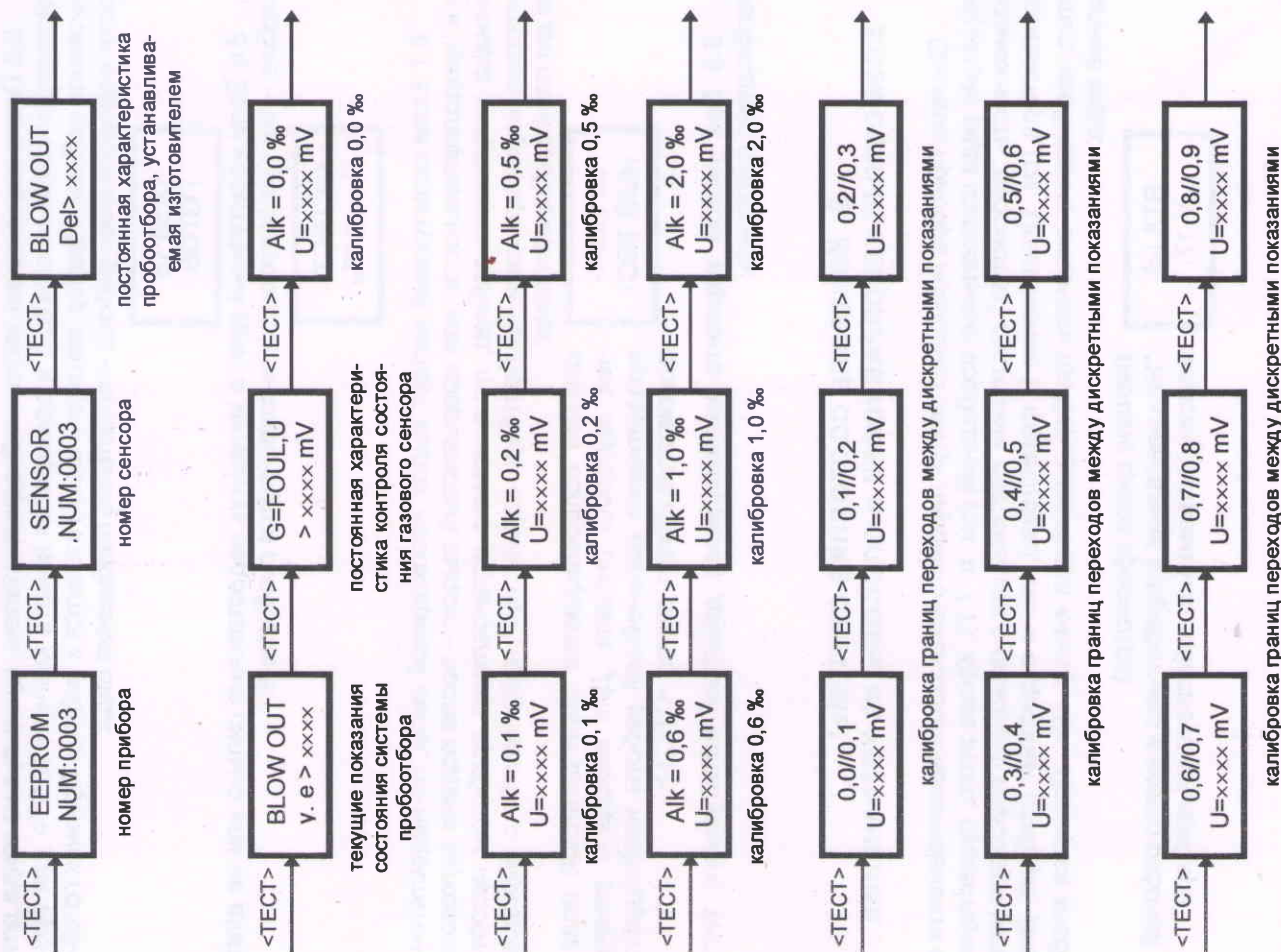

Приложение Б (рекомендуемое)

Форма протокола поверки

наименование организации, проводившей поверку

ПРОТОКОЛ № _____

поверки прибора специализированного определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с»

наименование средства измерений

тип _____ № _____ дата выпуска _____

принадлежащего _____

наименование организации

Изготовитель _____ ООО «Брестское техническое агентство»

наименование изготовителя

Дата проведения поверки _____

С ... по ...

Поверка проводится по _____ обозначение документа, по которому проводят поверку

Средства поверки _____

Таблица Б.1

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер

Условия поверки

- температура окружающего воздуха _____ °С или от 15 °С до 25 °С;

- относительная влажность воздуха _____ % или от 45 % до 75 %.

Результаты поверки

Б.1 Внешний осмотр _____

соответствует/не соответствует

Б.2 Опробование _____

соответствует/не соответствует

Б.3 Определение метрологических характеристик

Б.3.1 Определение _____

наименование метрологической характеристики

Результаты измерений и оценка метрологической характеристики _____

Б.3.2 ...

Заключение _____

соответствует/не соответствует

Свидетельство (заключение о непригодности) № _____

Поверитель _____

подпись

расшифровка подписи

Приложение А (обязательное)


Обязательные метрологические требования к характеристикам приборов, выпущенных в разные периоды

Таблица А.1 – Обязательные требования к характеристикам приборов, выпущенных до 30.08.2021

Нормируемый диапазон измерения, ‰	Фактически определяемая величина	Допустимая (предельная) величина отклонения, ‰
I 0 – 0,5	Приведённая погрешность $\gamma_{пр. I}$	± 20
II 0,6 – 2,0	Приведённая погрешность $\gamma_{пр. II}$	± 15

Таблица А.2 – Обязательные требования к характеристикам приборов, выпущенных после 30.08.2021

Нормируемый диапазон измерения, мг/л (‰)	Фактически определяемая величина	Допустимая (предельная) величина отклонения, ‰
I 0 – 0,5 (0 – 1,1)	Приведённая погрешность $\gamma_{пр. I}$	± 10
II свыше 0,5 – 0,990 (свыше 1,1 – 2,2)	Относительная погрешность $\sigma_{отн. II}$	± 10

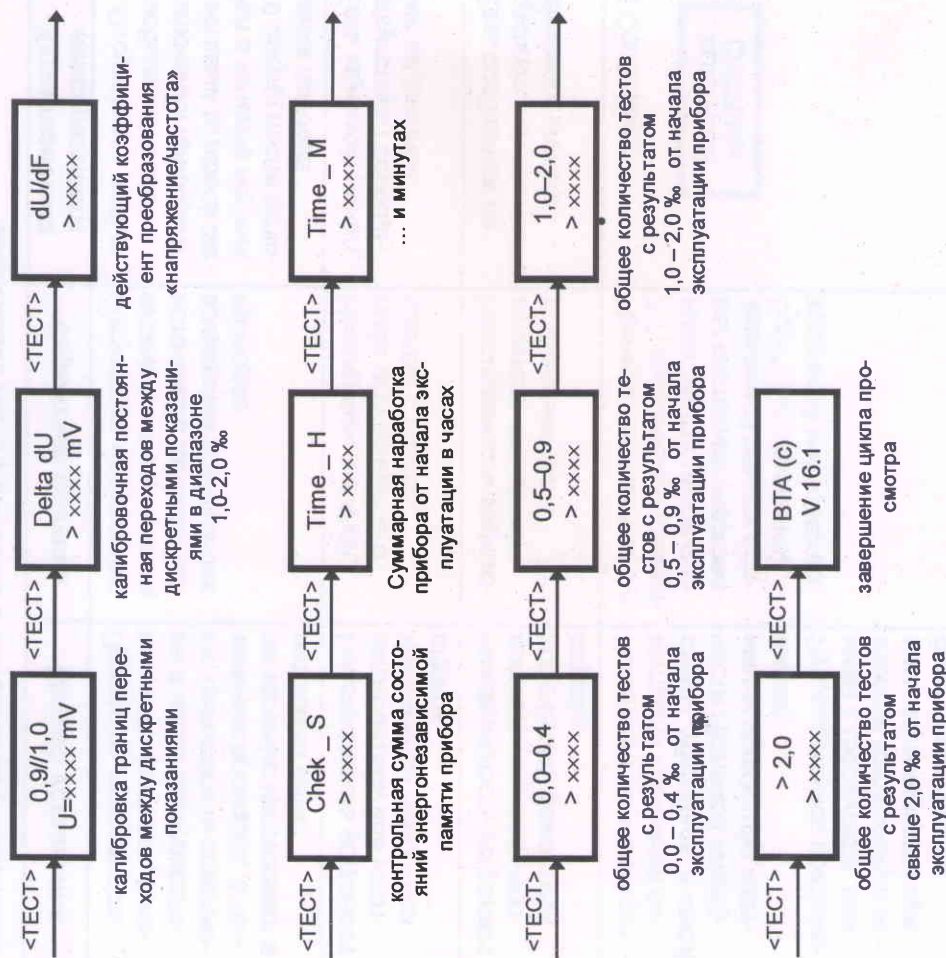

Нарушение вида приведенных сообщений может свидетельствовать о несанкционированных изменениях в системе "энергонезависимая память - процессор", что требует консультаций изготовителя (разработчика), или о конкретных нарушениях в работе частей системы (о чем пойдет речь ниже).

Возможные неисправности и способы их устранения

Характеристика неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствуют любые сообщения после включения прибора и звуковой сигнал в течение первых 10 секунд после включения прибора.	Отсутствие напряжения питания, неисправности источников питания, повреждение подводящих проводов.	Проверить исправность сетевого адаптера, гнезда и вилки прикуривателя, целостность соединительных проводов, а также наличие напряжения в питающих сетях.
Есть звуковой сигнал, отсутствуют сообщения на дисплее.	Неисправен дисплей, либо отсутствует его контакт с платой.	Неисправность устраняет изготовитель или уполномоченная ремонтная служба.
Есть сообщения на дисплее, нет тестового звукового сигнала.	Неисправность звукоизлучателя или цепей управления им.	Неисправность устраняет изготовитель или уполномоченная ремонтная служба.
2 Сообщение КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ	Причины, описанные в п. 7.7, связанные с изменением "контрольной суммы" состояний энергонезависимой памяти прибора", т.е. стиранием хранимой информации.	Используя возможности контроля состояния системы, убедиться, в какой части хранимой информации произошло нарушение. Руководствуясь приложением 2 формуляра, произвести контрольную запись характеристик прибора с компьютера. Проверить с помощью тестового считывания – восстановилась ли нарушенная информация и сохраняется ли она в процессе эксплуатации (хранения). Если информация не сохраняется – обратиться в уполномоченную ремонтную службу.

9.3 Если по результатам первичной поверки прибор признан непригодным к применению, выдают заключение о непригодности по форме согласно приложению 3 [3] и (или) техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений.

Если по результатам последующей поверки прибор признан непригодным к применению, выдают заключение о непригодности по форме согласно приложению 3 [3], свидетельство о предыдущей поверке преобразует своё действие, и знак поверки подлежит уничтожению путём приведения его в состояние, не пригодное для дальнейшего применения.

Прибор к применению не допускается.

$$\gamma'_{\text{пр}} = \frac{Y - Y_0}{Y_k} \cdot 100, \quad (2)$$

где Y – отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_0 – отображаемое прибором для данной воздействующей паргазовой смеси номинальное значение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_k – верхнее значение (граница) нормируемого диапазона отображаемых прибором значений концентрации этанола в воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰).

Значения приведенной погрешности $\gamma'_{\text{пр}}$ для нормируемого диапазона I не должны превышать $\pm 10\%$.

8.3.5 Для приборов, выпущенных после 30.08.2021, относительную погрешность в нормируемом диапазоне II $\sigma''_{\text{отн.}}$, %, определяют по формуле

$$\sigma''_{\text{отн.}} = \frac{Y - Y_0}{Y_0} \cdot 100, \quad (3)$$

где Y – отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_0 – отображаемое прибором для данной воздействующей паргазовой смеси номинальное значение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰).

Значения относительной погрешности $\sigma''_{\text{отн.}}$ для нормируемого диапазона II не должны превышать $\pm 10\%$.

Примеры расчетов при обработке результатов измерений, полученных при определении метрологических характеристик приборов, выпущенных в разные периоды, приведены в приложении В.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки заносят в протокол, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б.

9.2 Если по результатам поверки прибор признан пригодным к применению, то на него и (или) в формуляр наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке по форме, установленной в приложении 2 [3] и (или) техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений.

Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение)

3 Сообщение ГАЗ.СЕН. ОБРЫВ	Не подключен сенсорный зонд.	Включить сенсорный зонд в соответствующий разъем прибора. Выдержав прибор включенным хотя бы 1 минуту, выключить и включить прибор повторно.
	Нарушение целостности пайки соединительных проводов шнура сенсорного зонда с выводами разъема, проводов шнура. Плохой контакт сенсора с разъемом сенсорного зонда.	Проверить состояние и целостность пайки соединений, проводников, контактов. После устранения видимых причин неисправности включить прибор и убедиться в их устранении по соответствующим сообщениям на дисплее.
	Вышел из строя газовый сенсор.	Дополнительные указания на неисправность: а) Устойчивые показания прибора в режиме "контроль состояния газового сенсора" вида: 0 мг/л U=4955mV (т.е. $5,0 \pm 0,1$ В)
		б) Контрольное сообщение о состоянии системы пробоотбора вида: BLOW OUT y.e>.745 (т.е. "три" разряда вместо "четыре"). Заменить газовый сенсор.

4 Длительное сохранение сообщения видя: 17:58:21 25:06:98 (показания часов-алендаря) после включения прибора в нормальных условиях работы (приветственное помещение).	Вышел из строя газовый сенсор.	Провести контроль состояния газового сенсора и его кондиционирование согласно Приложению 3 формуляра. В случае установления факта выхода его из строя, произвести замену.
5 Постоянная потеря точности хода часов-календаря реального времени.	Неправильная установка хода часов	Руководствуясь Приложением 2 формуляра, установить необходимые характеристики хода часов с помощью компьютера или в ручном режиме (без компьютера) (см. Приложение 3 формуляра).
	Системное нарушение в хранении базы данных (стирание ячейки памяти).	Подтверждением данного нарушения является контрольное сообщение состояния системы (в режиме циклического просмотра) вида: G=FOUL,U >0000 mV Руководствуясь Приложением 2 формуляра, произвести контрольную запись характеристик прибора с компьютера. Произвести контрольное считывание базы данных из прибора. Если неисправность не устраняется – обратиться в уполномоченную ремонтную службу.

8.3.2 Для приборов, выпущенных после 30.08.2021, определение приведённой погрешности $\gamma'_{пр}$ в диапазоне I и относительной погрешности $\sigma'_{отн}$ в диапазоне II проводят последовательным воздействием на газовый сенсор прибора паразитными смесями. Концентрации смесей должны соответствовать таблице 4.

Таблица 4 – Номинальные значения концентраций воздействующих паразитных смесей для приборов, выпущенных после 30.08.2021

Нормируемый диапазон концентраций воздействующих смесей, мг/м ³ (‰)	Номер воздействующей смеси	Номинальное значение концентрации воздействующей смеси X ₀ , мг/м ³ , (номинальное значение, отображаемое прибором Y ₀ , мг/л / ‰)
I 0 – 500 (0,0 – 1,1)	1	90 (0,090 / 0,2)
	2	180 (0,180 / 0,4)
	3	495 (0,495 / 1,1)
II свыше 500 – 990 (свыше 1,1 – 2,2)	4	540 (0,540 / 1,2)
	5	990 (0,990 / 2,2)

Пропускание смесей осуществляют в следующей последовательности:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

Порядок выполняемых действий – согласно 8.2.3.

8.3.3 Для приборов, выпущенных до 30.08.2021, приведённую погрешность в нормируемом диапазоне I $\gamma'_{пр}$, %, приведённую погрешность в нормируемом диапазоне II $\gamma''_{пр}$, %, определяют по формуле

$$\gamma'^{,II}_{пр} = \frac{Y - Y_0}{Y_k} \cdot 100, \quad (1)$$

где Y – отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в крови, ‰;

Y₀ – отображаемое прибором для данной воздействующей паразитной смеси номинальное значение концентрации этанола в крови, ‰;

Y_k – верхнее значение (граница) нормируемого диапазона отображаемых прибором значений концентрации этанола в крови, ‰.

Значения приведённой погрешности в нормируемом диапазоне I $\gamma'_{пр}$ не должны превышать ± 20 %.

Значения приведённой погрешности в нормируемом диапазоне II $\gamma''_{пр}$ не должны превышать ± 15 % (для смеси № 4 (X₀ = 270 мг/м³, Y₀ = 0,6 ‰) $\gamma_{пр} = +15 / -5$ %).

8.3.4 Для приборов, выпущенных после 30.08.2021, приведённую погрешность в нормируемом диапазоне I $\gamma'_{пр}$, %, определяют по формуле

Каждое последующее измерение (воздействие новой смеси) проводят только после полного восстановления газового сенсора в процессе работы в воздухе с установлением на индикаторе показаний 0,0 ‰.

Сравнивают соответствие показаний приборов в ‰ и номинальных значений концентрации воздействующих парогазовых смесей с учётом погрешности приборов и коэффициента пересчёта (воздух – кровь) [1].

Прибор считают прошедшим опробование при соответствии всех показаний для указанных воздействующих смесей значениям, приведенным в таблице А.1 приложения А.

8.2.4 При опробовании приборов, выпущенных после 30.08.2021, для установления правильности их калибровки подают на газовый сенсор следующие парогазовые смеси: 0,090 мг/л паров этанола в воздухе (0,2 ‰); 0,180 мг/л (0,4 ‰); 0,540 мг/л (1,2 ‰); 0,990 мг/л (2,2 ‰). Фиксируют максимальные установившиеся в результате воздействия показания приборов в мг/л (‰).

Порядок действий – аналогичный изложенному в п.8.2.3.

Прибор считают прошедшим опробование при соответствии всех показаний для указанных воздействующих смесей значениям, приведенным в таблице А.2 приложения А.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Для приборов, выпущенных до 30.08.2021, определение приведенной погрешности $\gamma'_{пр}$ в диапазоне I и приведенной погрешности $\gamma'_{пр}$ в диапазоне II проводят последовательным воздействием на газовый сенсор прибора парогазовыми смесями. Концентрации смесей должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3 – Номинальные значения концентраций воздействующих парогазовых смесей для приборов, выпущенных до 30.08.2021

Нормируемый диапазон концентраций воздействующих смесей, мг/м ³ (‰)	Номер воздействующей смеси	Номинальное значение концентрации воздействующей смеси X ₀ , мг/м ³ , (номинальное значение, отображаемое прибором, Y ₀ , ‰)
I 0 – 225 (0,0 – 0,5)	1	45 (0,1)
	2	90 (0,2)
	3	225 (0,5)
II 270 – 900 (0,6 – 2,0)	4	270 (0,6)
	5	450 (1,0)
	6	900 (2,0)

Пропускание смесей осуществляют в следующей последовательности:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6.

Порядок выполняемых действий – согласно 8.2.3.

Возможные неисправности и способы их устранения (продолжение)

	Отказы элементов схемы корректировки хода часов.	Для устранения неисправности обратиться в уполномоченную ремонтную службу.
	Отказ или выработка ресурса источника питания часов-календаря.	

Примечание: После операции замены газового сенсора необходимо провести проверку и настройку прибора согласно Приложения 3 формуляра и внеочередную поверку прибора согласно Приложения 5 формуляра.

10 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ; ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

10.1.1 Средняя наработка прибора на отказ должна составлять не менее 6000 ч.

10.1.2 Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 8 ч в сутки.

10.1.3 Среднее время восстановления работоспособности прибора путем замены отказавшего газового сенсора (мелкий ремонт) – не более 30 мин.

10.1.4 Средний срок сохраняемости прибора – не менее 6 месяцев (см. п. 4.1).

10.2 Гарантии изготовителя

10.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ РБ 28801552.004-99 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

10.2.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня продажи (поставки прибора потребителю).

10.2.3 В течение срока гарантии предприятие – изготовитель безвозмездно производит ремонт прибора или его замену при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

10.2.4 За повреждение прибора вследствие его неправильной эксплуатации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

10.2.5 Кондиционирование газового сенсора продолжительностью до 6 ч после длительного хранения прибора с целью восстановления эксплуатационных характеристик (см. п. 4.1) представляет собой один из режимов технического обслуживания (п.15.1 и Приложение 3 формуляра) и также не является причиной признания факта брака.

10.2.6 Гарантийный срок хранения приборов – 6 месяцев.

10.2.7 После истечения гарантийного срока ремонт приборов осуществляется изготовителем по отдельной договоренности или специализированными ремонтными службами в соответствии с эксплуатационной документацией.

10.2.8 Изготовитель может поставлять по заказу необходимые для ремонта комплектующие.

10.2.9 В случае отказа газовых сенсоров, изготовитель может поставить их по заказу с таблицей калибровки.

10.2.10 При проведении гарантийного ремонта с заменой газового сенсора изготовитель обязуется возратить потребителю изделие "Алkont 01cm" (средство измерения) после проведения внеочередной поверки.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе

наименование изделия	«Алkont 01cm»	обозначение	заводской номер
Упакован	ООО «Брестское техническое агентство»	наименование или код изготовителя	

согласно требованиям, предусмотренным ТУ РБ 28801552.004-99.

УПАКОВЩИК N 2

должность	личная подпись	расшифровка подписи
-----------	----------------	---------------------

год, месяц, число

7 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

7.1 Проверяют техническое состояние и выполняют подготовку к приговлению спирто-воздушных смесей используемого генератора спирто-воздушных смесей согласно его эксплуатационной документации [2].

7.2 Размещают у места поверки гигрометр психрометрический ВИТ-1.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемых приборов следующим требованиям:

8.1.1 Внешний вид должен соответствовать рисунку 1 [1].

8.1.2 Комплектность должна соответствовать разделу 5 [1].

8.2 Опробование

8.2.1 Включают приборы и проводят контроль функционирования согласно разделу 7 [1].

8.2.2 Выходят в режим "Поверка" согласно [1].

8.2.3 Для опробования приборов, выпущенных до 30.08.2021, используют парогазовые смеси: 225 мг/м³ паров этанола в воздухе (0,5 ‰); 450 мг/м³ (1,0 ‰); 900 мг/м³ (2,0 ‰).

Время воздействия (подачи) парогазовой смеси на чувствительный элемент прибора – 5 с.

Время фиксации показаний прибора:

- переводом правого переключателя прибора «Алkont 01су» в положение СБРОС одновременно с началом подачи парогазовой смеси – 10 с;
- нажатием кнопки ТЕСТ прибора «Алkont 01cm» одновременно с началом подачи парогазовой смеси – 10 с;
- нажатием кнопки ТЕСТ прибора «Алkont 01са» одновременно с прекращением подачи парогазовой смеси – 10 с.

Смеси подают на сенсорный зонд со вставленным мундштуком, который погружают рабочей частью в ячейку газовой магистральной (воздух, спирто-воздушные смеси) или в выходной патрубков используемого генератора спирто-воздушных смесей.

Подают смесь из генератора, показания поверяемого прибора фиксируют в протоколе, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б. Извлекают сенсорный зонд прибора из выходного патрубка генератора (ячейки газовой магистральной).

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие правила электробезопасности, инструкцию по технике безопасности при работе с легко воспламеняющимися жидкостями и ознакомившиеся с эксплуатационной документацией используемых средств поверки и поверяемых приборов.

4.2 Все работы необходимо проводить в проветриваемых (вентилируемых) помещениях. Наличие запахов не допускается.

4.3 Использованные парогазовые смеси утилизировать посредством выгрузки.

4.4 Место поверки должно быть удалено (защищено) от прямого воздействия источников теплового излучения и прямых потоков воздуха (сквозняки, вентиляторы).

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики
7	Гигрометр психрометрический ВИТ-1, скорость аспирации от 0,5 до 1,0 м/с
8.1	Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05
8.2, 8.3	Генератор ГСВС-META-02M [2]
Примечания	
1 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью.	
2 Все средства измерений должны иметь действующие клейма и (или) свидетельства о поверке.	

5 Требования к квалификации поверителей

К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих необходимую квалификацию в области обеспечения единства измерений.

6 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха (60 ± 15) %;
- атмосферное давление ($101,3 \pm 4$) кПа.

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01см» № _____ заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации ТФАГ 413422.001-01 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01см» № _____ заводской номер _____

прошёл первичную поверку и допущен к применению в качестве средства измерения.

Государственный поверитель:

М. П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Свидетельство о поверке № _____

Межповерочный интервал прибора – 6 месяцев.

13 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

[illegible]

13.1 Ограничения по транспортированию

13.1.1 Приборы в упаковке следует транспортировать только в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

13.1.2 Не допускается транспортирование в негерметизированных отсеках самолетов.

13.1.3 Условия транспортирования приборов в упаковке должны соответствовать условиям хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	последующей поверке
1 Подготовка к поверке	7	+	+
2 Внешний осмотр	8.1	+	+
3 Опробование	8.2	+	+
4 Определение метрологических характеристик приборов	8.3	+	+
4.1 Определение приведённой погрешности $\gamma'_{пр. II}$ в двух нормируемых диапазонах *	8.3.3	+	+
4.2 Определение приведённой погрешности, $\gamma'_{пр. I}$ в нормируемом диапазоне I **	8.3.4	+	+
4.3 Определение относительной погрешности $\sigma'_{отн.}$ в нормируемом диапазоне II **	8.3.5	+	+
5 Оформление результатов поверки	9	+	+

* Для приборов, выпущенных до 30.08.2021.
 ** Для приборов, выпущенных после 30.08.2021.

Примечание – Если при проведении операций 2, 3, 4 получают отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают.

* Для приборов, выпущенных до 30.08.2021.

*** Для приборов, выпущенных после 30.08.2021г.

Примечание – Если при проведении операций 2, 3, 4 получают отрицательный результат, дальнейшую проверку прекращают.

3 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

4 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности согласно ТКП 427, ГОСТ 12.1.005 и (или) технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации:

Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь

ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ «Алконт 01с», «Алконт 01см», «Алконт 01су», «Алконт 01са»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП.367-2021

Настоящая методика поверки (далее – МП) распространяется на приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Алконт 01с", "Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са" (далее – приборы), выпускаемые по [1], производства Общества с ограниченной ответственностью «Брестское техническое агентство» и устанавливает методы и средства поверки.

Приборы предназначены для измерения концентрации паров этанола в воздухе, выдыхаемом человеком.

Обязательные метрологические требования к приборам приведены в приложении А.

1 Нормативные ссылки

В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Примечание – При использовании настоящей МП целесообразно проверить действие ссылок ТНПА на официальном сайте Национального фонда ТНПА в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при использовании настоящей МП следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Операции поверки

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

14 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

[illegible]

15 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

15.1 Техническое обслуживание

15.1.1 Ежедневное техническое обслуживание заключается в осмотре прибора и дезинфекции его поверхностей, а также сенсорного зонда перед началом работы и по мере необходимости.

15.1.2 Дезинфекцию проводить в соответствии с санитарными правилами по осуществлению дезинфекционной деятельности (см. Приложение 1 формуляра, п. 4.4), например: протираям х/б салфеткой, смоченной смесью 3-процентного раствора перекиси водорода и 0,5-процентного раствора моющего средства. Салфетка должна быть отжата и не оставлять на протираемых поверхностях капель раствора. Обработанные поверхности должны быть вытерты насухо чистой сухой х/б салфеткой.

При обработке сенсорного зонда не допускать попадания жидкости на газовый сенсор!

15.1.3 Кондиционирование газового сенсора после хранения прибора (п. 4.1) проводится тренировкой прибора во включенном состоянии в проветренном помещении до 6 часов. Как правило, восстановление эксплуатационных характеристик газового сенсора происходит за более короткое время. Признак готовности к работе — звуковой сигнал и появление сообщения типа:

20:27:33
ГОТОВ

15.1.4 Мундштуки индивидуального пользования могут использоваться повторно только после специальной обработки (дезинфекции) в соответствии с санитарными правилами (кипячение в течение 30 минут в дистиллированной воде с последующей сушкой и т.п.).

15.2 Учет технического обслуживания

[illegible]

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

24

“АЛКОГОЛИЗМ”

ТФАГ 413422.001-01 ФО

45

Приложение 1 Соотношение плотности спирта-ректификата и его массовой концентрации

Концентрация спирта-ректификата, %	96	95	94	93	92	91
Плотность, г/см ³	0,8013	0,8042	0,8070	0,8098	0,8126	0,8153

Приложение 2 Объемы первичного раствора, необходимые для приготовления рабочих растворов, обеспечивающих получение необходимых концентраций этанола в спирто-воздушной смеси (рассчитаны относительно концентрации спирта (ректификата 96%) на генераторе ГС-1

Концентрация этанола в смеси, мг/м ³	90	180	495	540	990
Объём первичного раствора, мл	5,0	10,0	27,6	30,1	55,2

Приложение 3 Объемы первичного раствора (96 % этанола), необходимые для приготовления рабочих растворов, обеспечивающих получение некоторых концентраций этанола в спирто-воздушной смеси (рассчитаны относительно концентрации спирта-ректификата 96%) на генераторе ГСВС-META-02M

$C_0^{\Gamma C}$, мг/м ³	90	180	495	540	990
C_0^P , мг/мл	0,232	0,463	1,274	1,390	2,547
V , мл 96 % этанола в 1 л раствора	0,30	0,60	1,66	1,81	3,31

2.3.9 Генератор готов к работе.

2.3.10 Общее время сохранности раствора в колбе с притертой пробкой и в стакане генератора ГС-1 после приготовления раствора должно быть не более 1 суток.

2.4 Для приготовления водно-спиртовых растворов на генераторе ГВС-МЕТА-02М необходимо:

2.4.1 При наличии – использовать государственные стандартные образцы (ГСО) состава водных растворов этанола ВР-2 (ГСО8789-2006) с паспортами.

2.4.2 При необходимости приготовления на генераторе газовой смеси (ГС) с номинальным значением массовой концентрации этанола C_0 , мг/м³, требуемое содержание этанола в водном растворе рассчитывается по формуле:

$$C_0^P = \frac{C_0^{TC}}{388.66}, \text{ где}$$

C_0^P — номинальное значение массовой концентрации этанола в приготавливаемом (используемом в случае применения ГСО состава водного раствора этанола) растворе, мг/мл.

2.4.3 Используя данные Приложения 1 и рассчитанные значения содержания спирта-ректификата (мл) в 1000 мл рабочего раствора для получения ГС с заданной массовой концентрацией этанола (мг/м^3) (Приложение 3), приготовьте необходимые растворы (см. п. 2.2.5.6).

2.4.4 При использовании готовых ГСО, как и при приготовлении необходимых рабочих растворов, соблюдать все рекомендации руководства по эксплуатации генератора спирто-воздушных смесей ГСВС-META-02M.

16 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

16.1 Технический контроль состояния прибора, в необходимых случаях его калибровка и (или) настройка производится при подготовке прибора к предъявлению в поверку уполномоченной технической службой согласно Приложения 3 формуляра.

16.2 Поверка прибора производится согласно действующих ТНПА и Методики поверки МРБ МП.367-2021 (Приложение 5) – один раз в шесть месяцев.

16.3 Для проверки технического состояния прибора и его настройки используется цифровой вольтметр класса 0,04 %, персональный компьютер любой модели. Для проверки прибора, кроме того, – генератор паров спирта ГСВС-МЕТА-02М (или другие поверочные средства).

16.4 Приготовление спирто-воздушных смесей на используемых генераторах проводить по методике, приведённой в Приложении 4.

16.5 Учет выполнения работ. фиксируются сведения о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей (комплектующих, покупных изделий).

Учет выполнения работ

[illegible]

16.6 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Фиксируются сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

[illegible]

$$C_s = \frac{V_p \times p \times C_E}{V_2 \times 10 \times 100} \quad (4), \text{ где}$$

V_p - объем избранной пипетки;

получаемые размерности C_d и C_S — $[мг/м^3]$ и $[г/л]$ соответственно.

2.2.5.5 Если температура использования спирто-воздушных смесей отличается от температуры их приготовления на генераторе ГС-1, концентрацию этилового спирта в смеси необходимо привести к температуре использования умножением на поправочный коэффициент, вычисленный по формуле (5):

$$f_t = \frac{T_0 + 26}{T_0 + T} \quad (5), \text{ где}$$

f_t – поправочный коэффициент;

 $T_0 = 273 \text{ K};$

T - температура использования газовой смеси, °C.

2.2.5.6 Рабочий раствор готовить в мерной колбе ёмкостью 1000 мл. Заполнить колбу дистиллированной водой на 2/3 объёма. Добавить пипеткой рассчитанный объём первичного раствора (Приложение 2), довести объём жидкости в колбе до марки дистиллированной водой, закрыть пробкой, тщательно перемешать (см. п. 2.3.10 методики).

2.3 Подготовка генератора ГС-1 к работе.

2.3.1 Перед началом работы осмотреть генератор, удостовериться в целостности стаканов, исправности замков и уплотнения. Генератор должен быть предварительно промыт и высушен.

2.3.2 Залить рабочий раствор (850 ± 50) мл в стакан генератора ГС-1.

2.3.3 Включить питание генератора.

2.3.4 Проверить герметичность системы.

2.3.4.1 Заглушить выходной штуцер генератора.

2.3.4.2 Перевести регулятор подачи смеси в положение 2 (см. «Техническое описание и инструкции по эксплуатации генератора ГС-1»):

2.3.4.3 Если система герметична, пробулькивание пузырьков в стакане генератора должно прекратиться через 1-2 минуты.

2.3.5 Удалить заглушку.

2.3.6 Перевести регулятор подачи смеси в положение 1 (работа по замкнутому циклу).

2.3.7 Включить тумблер "Стаб."

2.3.8 Не более чем за 60 минут температура раствора в стакане генератора должна установиться на постоянном значении ($26 \pm 0,2$) °C.

2.2.2 При помощи ареометра определить плотность этилового спирта.

2.2.3 На основании полученного результата, используя приведенный в Техническом описании и инструкции по эксплуатации генератора ГС-1" график или справочные таблицы, определить массовую концентрацию этилового спирта (%).

2.2.4 Приготовить первичный водно-спиртовой раствор.

2.2.4.1 Мерную колбу на 100 мл заполнить на 2/3 дистиллированной водой.

2.2.4.2 Отобрать пипеткой 10 мл этилового спирта и добавить его в кол-бу.

2.2.4.3 Довести объем раствора в колбе дистиллированной водой до марки, закрыть колбу, тщательно перемешать раствор.

2.2.5 Приготовить рабочий водно-спиртовой раствор.

2.2.5.1 Определить массовую концентрацию спирта в водно-спиртовом растворе по формуле:

$C_s = C_g / K$ (1), где

C_s - массовая концентрация спирта в водно-спиртовом растворе, г/л;

C_9 - требуемая концентрация спирта в спирто-воздушной смеси, мг/м³;

K - коэффициент распределения этилового спирта, $K=233\pm 8$.

2.2.5.2 Определить требуемый объём первичного раствора по формуле:

$$V_1 = \frac{V_2 \times C_S \times A \times 100}{p \times C_F} \quad (2), \text{ где}$$

V_1 - требуемый объем первичного раствора, мл;

V_2 - объем рабочего раствора, л;

C_s - аналогично формуле (1);

A - кратность разбавления при получении первичного раствора;

р - плотность спирта-ректификата, измеренная ареометром с точностью до третьего знака после запятой, г /см³ ;

СЕ - концентрация спирта-ректификата, %.

2.2.5.3 При необходимости дозирования спирта и исходного раствора пипетками с одной меткой пипетку подбирать вместимостью, близкой к объёму, рассчитанному по формуле (2):

2.2.5.4 Расчет концентрации спирто-воздушной смеси производить по формулам (3), (4):

$$C_g = K \times C_s \quad (3),$$

[illegible]

16.8 Повторка средств измерений

[illegible]

17 ХРАНЕНИЕ

17.1 Условия транспортирования и хранения приборов в упаковке должны соответствовать условиям хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

17.2 Сведения о хранении.

[illegible]

МЕТОДИКА

приготовления спирто-воздушных смесей
на генераторах ГС-1 и ГСВС-META-02M

1 Назначение

1.1 Методика предназначена для приготовления увлажнённых спирто-воздушных смесей, используемых для поверки приборов "Алконт 01с" ("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са") и калибровки газовых сенсоров на стадии изготовления приборов.

1.2 Методика позволяет получить из одной порции водно-спиртового раствора до 35 литров спирто-воздушной смеси заданного состава с массовыми концентрациями в диапазоне от 45 до 990 мг/м³ при температуре раствора (26 ± 0,2) °С – на генераторе ГС-1, до 40 литров смеси с аналогичными концентрациями при температуре раствора (34 ± 0,2) °С и относительной влажности газовой смеси не менее 95 % – на генераторе ГСВС-META-02M.

2 Подготовка водно-спиртовых растворов

2.1 Для приготовления водно-спиртовых растворов необходимо:

2.1.1 Ареометр без шара АОН-1 Н8 ГОСТ 18481-81 (диапазон измерения 0,790 - 0,810 г/см³)^п.

2.1.2 Пипетка мерная емкостью 1 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.

2.1.3 Пипетка мерная емкостью 5 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.

2.1.4 Пипетка мерная емкостью 10 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.

2.1.5 Колба мерная емкостью 100 мл, 2-100-2, ГОСТ 1770-74.

2.1.6 Колба мерная емкостью 1000 мл, 2-1000-2, ГОСТ 1770-74.

2.1.7 Термометр лабораторный с ценой деления 0,1°С ГОСТ 28498-90.

2.1.8 Генератор ГС-1 ТУ 25-7557.002-86 или генератор ГВС-МЕТА-02М ТУ 4381-043-21298618-2009.

2.1.9 Спирт этиловый (ректификат, высший сорт) ГОСТ 5962-67 или ГОСТ 18300-72.

2.1.10 Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72.

Примечание. Допускается использование других приборов и оборудования, метрологические характеристики которых не отличаются от приведенных.

2.2 Для приготовления водно-спиртовых растворов на генераторе ГС-1 необходимо:

2.2.1 Определить температуру этилового спирта и воды. Температура должна составлять $(20 \pm 0,1)^\circ\text{C}$. При отклонении температуры жидкостей от указанной необходимо их охладить (подогреть).

Непосредственная коррекция значений нужного разряда производится нажатием кнопки <0>.

После перебора всех разрядов (последний разряд – "год") очередным нажатием кнопки <TEST> фиксируется необходимый результат коррекции. Появляется последующее сообщение режима "просмотра состояния системы прибора", сменяющее то, при котором включался режим "коррекция часов-календаря" (см. раздел 9 формуляра). После этого можно выключить прибор и включить его в любом режиме. В дальнейшем будет вестись уже скорректированный отсчет времени.

4 Закрытые режимы работы прибора "Алконт 01см"

4.1 Закрытые (защищенные от несанкционированного доступа) режимы работы позволяют изменять базы данных, на основании которых система прибора производит измерения, пересчет и отображение результатов измерений по всем измерительным каналам, обработку и накопление результатов измерений и значений технологических параметров в энергонезависимой памяти прибора.

4.2 В исполнении "Алконт 01см" работа в закрытых режимах реализуется только с помощью персонального компьютера любой модели (см. Приложение 2 формуляра).

18 РЕМОНТ

18.1 Краткие записи о произведенном ремонте.

«Алконт 01см» наименование изделия	№ заводской номер	предприятие, дата
Наработка с начала эксплуатации параметр, характеризующий ресурс или срок службы		
Наработка после последнего ремонта параметр, характеризующий ресурс или срок службы		
Причина поступления в ремонт		
Сведения о произведенном ремонте вид ремонта и		
краткие сведения о ремонте		

18.2 Данные приемосдаточных испытаний после ремонта.

18.3 Свидетельство о приемке и гарантии.

«Алконт 01см» наименование изделия	№ заводской номер	вид ремонта
наименование предприятия согласно		вид документа

принят в соответствии с обязательными требованиями государственными стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____ в течение срока
параметр определяющий ресурс

службы _____ лет, в том числе срок хранения
при условиях хранения

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

М. П. _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____ год, месяц, число

0 мг/л
U=4099 mV

которое отражает текущие показания падения напряжения на чувствительном элементе газового сенсора в милливольтх и соответствующие им значения измеряемой величины в мг/л. При однократном нажатии кнопки <ТЕСТ> запускается контрольный 10-секундный таймер (с фиксацией на 10-й секунде измеряемой величины в мг/л и соответствующего ей падения напряжения на чувствительном элементе газового сенсора в мВ).

3.1.2 Таблица соответствия (калибровки) газового сенсора считывается из энергонезависимой памяти прибора в "ручном" режиме (см. раздел 9 формуляра) и при работе в режиме связи с персональным компьютером (см. Приложение 2 формуляра). Используя эти данные, производится как контроль их "сохранности" в приборе, так и оценка текущего состояния сенсора:

- после часа работы в проветренном помещении реальные показания прибора должны быть близки к табличному значению падения напряжения для концентрации 0 мг/л ("чистый воздух");
- динамичное уменьшение показаний падения напряжения (рост показаний в мг/л) при поднесении сенсорного зонда к источнику паров этилового спирта и их динамичное восстановление при последующей вентиляции (кондиционировании) – свидетельствуют о сохранении сенсором эксплуатационных свойств;
- восстановление реальных показаний падения напряжения, близких к табличному значению для 0 мг/л может служить критерием оценки восстановления эксплуатационных характеристик газового сенсора при проведении его кондиционирования после длительного хранения прибора.

3.2 Настройка точности хода часов-календаря реального времени в ручном режиме.

Используя рекомендации раздела 9 формуляра, войти в режим "просмотра состояния системы прибора" (включить прибор, удерживая кнопку <☼> (среднюю)). После отпускания кнопки <☼> появится сообщение вида:

ВТА (с)
V 16.1

(начало цикла просмотра)

Затем, в любом месте цикла просмотра, необходимо вместо кнопки <ТЕСТ> нажать кнопку <☼>. Вместе с включением режима коррекции часов-календаря появится сообщение вида

12:32:56
17.10.97

с мигающими показаниями в верхней строке слева (разряд "часы").

Выбор разряда (часы, минуты, секунды, число, месяц, год), который необходимо корректировать, производится нажатиями на кнопку <ТЕСТ>.

21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ приложения	Наименование приложения	Местонахождение приложения
1	Методика освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01см"	стр. 33
2	Памятка пользователю для организации работы комплекса «"Алконт 01см" - персональный компьютер»	стр. 36
3	Методика технического контроля, калибровки и настройки прибора "Алконт 01см"	стр. 38
4	Методика приготовления спирто-воздушных смесей на генераторах ГС-1 и ГСВС-META-02M	стр. 41
5	Методика поверки МРБ МП.367-2021	стр. 46
6	Методические указания по диагностике алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств (специализированных приборов определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с»).	стр. 60
	Информационное приложение	

3 Все режимы работы программы, работающие с принтером, позволяют записать файлы с информацией на диск для последующей корректировки и печати с использованием любого текстового редактора.

4 В режиме работы «Последний результат» можно:

- видеть и читать последний результат (это значение считается из энергонезависимой памяти прибора);
- организовать список тестируемых (список ведётся на компьютере);
- контролировать результаты измерений за текущий день с указанием фамилии, имени и отчества из списка;
- печатать результаты за день;
- печатать один выбранный результат.

5 Программа позволяет ввести и использовать при печати следующую дополнительную информацию:

- название организации;
- номер прибора;
- данные ответственного лица, проводившего тестирование.

ПАМЯТКА

пользователю для организации работы комплекса
«Алконт 01см» – персональный компьютер»

Работа комплекса может быть организована с персональным компьютером (далее ПК) под управлением операционной системы Windows любой версии и печатающим устройством, подключенным к данному ПК.

Подготовка работы комплекса «Алконт 01см» – ПК» требует установки драйвера виртуального COM-порта на основе микросхемы CH340G. Версии указанного драйвера отличаются для различных операционных систем и, по этой причине, не входят в комплект поставки прибора. Установка драйвера производится однократно и должна привести к появлению в составе операционной системы виртуального COM-порта с номером COM3 и выше. Проверка корректности установки и уточнение номера COM-порта производится средствами операционной системы Windows по целочке Компьютер → Свойства → Диспетчер устройств → Порты. Типовое название устройства – USB Serial Port (COM3)

Для подключения прибора к ПК требуется соединительный шнур, имеющий с одной стороны разъём для соединения с USB-портом компьютера, а с другой стороны – разъём mini-USB. Шнур входит в комплект поставки прибора «Алконт 01см». Подключение допускается производить при включенных ПК и приборе.

Последовательность работы следующая:

- 1 Соединить разъём mini-USB шнура связи с разъёмом «ПК» прибора, шнур связи должен быть подключен к USB-порту компьютера.
- 2 Запустить программу Alc_01cm.exe. При необходимости программу можно загрузить с сайта www.alcont.brest.by.
- 3 Необходимые действия можно совершить, используя головное меню программы.

Установки	Результаты	Часы	Последний результат	Выход
-----------	------------	------	---------------------	-------

Основные пункты меню дублируются кнопками в главном окне программы.

1 Используя пункт меню «Установки», можно изменить номер используемого COM-порта. Номер выбранного COM-порта указан в левой части нижней строки основного окна.

2 Все режимы работы программы имеют интуитивно понятный интерфейс.

МЕТОДИКА

освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01см"

1 Физиологические основы выявления факта употребления алкоголя по результатам исследования выдыхаемого воздуха

При употреблении спиртных напитков алкоголь проникает путем диффузии через стенки желудка и кишечника в кровяное русло в практически неизменном виде (этилового спирта). С кровью, оттекающей от желудочно-кишечного тракта, он попадает в печень, далее в правые отделы сердца, сосуды легких, левые отделы сердца и, наконец, с артериальной кровью разносится по всем органам и тканям и распределяется в них пропорционально содержанию в тканях воды.

В выдыхаемый воздух алкоголь проникает по крови, диффундируя через стенки альвеол. Соотношение концентрации алкоголя в крови и альвеолярном воздухе постоянно и определяется разностью плотности сред: крови и воздуха, и составляет при колебаниях от 1:1300 до 1:3000 в среднем 1:2200. Это означает, что в 2200 см³ альвеолярного воздуха содержится такое же количество алкоголя, как и в 1 см³ (миллилитре) крови.

Содержание паров алкоголя (этанола) в выдыхаемом воздухе выражается в миллиграммах на 1 м³ (мг/м³) и с учетом отношения плотностей крови и воздуха может быть оценочно выражено в промиллях по крови, миллиграммах алкоголя в 1 миллилитре крови (‰, мг/мл, ppt) то же, что ‰ BAC (Blood alcohol concentration). При этом 0.1 ‰ алкоголя в крови соответствует примерно 45 мг/м³ (0,045 мг/л) алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как правило, в выдыхаемом воздухе в небольших количествах могут находиться и некоторые органические, так называемые редуцирующие вещества, такие как ацетон, альдегиды и др., которые так же, как и алкоголь, могут влиять на показания прибора.

Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, крови или другой биологической среде организма не позволяет окончательно судить о степени опьянения человека. Это связано с неодинаковой реакцией одного человека на одни и те же дозы алкоголя, а также фазой алкогольной интоксикации. Однако, выявление в биологических средах организма содержания алкоголя, превышающего эндогенный уровень, свидетельствует о факте употребления спиртных напитков.

Заключение о состоянии опьянения в результате употребления алкоголя выносится при положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе при помощи одного из технических средств измерения (приборов).

2 Факторы, влияющие на точность освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01см"

При исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь нередко допускаются ошибки. Чаще всего они обусловлены неточным выполнением методики исследования (см. ниже). Кроме того, имеется ряд обстоятельств объективного характера, способных существенно влиять на конечный результат.

2.1 Ошибочный результат исследования может быть получен за счет небольших количеств алкоголя, адсорбировавшегося на слизистой оболочке рта и глотки при употреблении непосредственно перед исследованием спиртосодержащих лекарств. Так, при употреблении небольших количеств подобных препаратов адсорбированный алкоголь выделяется с выдыхаемым воздухом в течение 10 - 20 минут в значительных количествах. Это же относится к непосредственному употреблению алкогольных напитков. В целях повышения точности измерений, необходимо, чтобы с момента последнего приема алкоголя прошло не менее 20 минут.

2.2 Ошибка может быть обусловлена наличием в полости рта либо в окружающем воздухе примесей редуцирующих веществ. Например, наличие в окружающем воздухе значительных концентраций ацетона, бензина, ряда растворителей, выхлопных газов может воздействовать на чувствительный элемент сенсора и искажать результаты исследования. В течение 3 - 5 минут после курения на результаты пробы могут оказывать влияние выделяющиеся из дыхательных путей летучие соединения углерода.

2.3 Для получения воздуха из глубины легких испытуемый должен выдуть определенное минимальное количество воздуха. Только в этом случае полученные результаты совпадут с результатом анализа крови на алкоголь. На практике установлено, что минимальный объем анализируемого выдыхаемого воздуха должен составлять не менее 1,2 литров. При слишком слабом, коротком или прерывистом поступлении воздуха, исследование должно быть проведено повторно. Следует учитывать, что задержка дыхания на вдохе в течение 20 секунд может давать увеличение показаний до 50% от содержания алкоголя, определяемого на фоне спокойного дыхания. После гипервентиляции и при учащенном поверхностном дыхании показания могут уменьшаться до 12%.

3 Порядок работы с прибором "Алконт 01см" при исследовании выдыхаемого испытуемым воздуха

3.1 Помещение, в котором проводятся исследования, должно быть проветрено, посторонние запахи органических веществ (растворителей и т. п.) должны отсутствовать (см. п. 2.2).

3.2 Оператор включает прибор согласно формуляру изделия и приводит его в режим готовности.

3.3 Испытуемый опрашивается об употреблении перед исследованием спиртосодержащих лекарств, курении. Необходимо, чтобы от момента курения до исследования прошло не менее пяти минут, с момента последнего приема спиртосодержащих жидкостей – не менее двадцати минут.

3.4 В зависимости от конкретных обстоятельств и состояния испытуемого эксперт (оператор) принимает решение по проведению теста, инструктирует обследуемого и устанавливает готовность прибора к выполнению теста.

3.5 Исследование проводить в положении испытуемого сидя, на фоне спокойного дыхания.

3.6 У лиц, страдающих сахарным диабетом, «ацетоновое» дыхание может вызвать ложные показания приборов.

3.7 Это же необходимо учитывать при обследовании лиц, находящихся в состоянии продолжительного голодания (как правило, свыше 7 дней).

4 Порядок проведения теста


4.1 Испытуемый извлекает (получает) стерильный сменный мундштук индивидуального пользования из упаковки, стыкует его короткой частью с сенсорным зондом.

4.2 Получив указание оператора, установившего готовность к тесту, обследуемый, зажав мундштук губами и удерживая зонд любой рукой, делает через него один полный плавный энергичный выдох длительностью не менее трех секунд. После завершения выдоха освободить губы от мундштука и продолжать обычное дыхание. Конечный результат фиксируется на дисплее прибора с выдачей звукового сигнала.

4.3 При неправильных действиях испытуемого – тест следует повторить.

4.4 После окончания теста мундштук отделяется от сенсорного зонда. Снятый сменный мундштук после разового использования подлежит дезинфекции. Дезинфекцию производить кипячением в дистиллированной воде не менее тридцати минут с последующей сушкой или другим способом в соответствии с санитарными правилами по осуществлению дезинфекционной деятельности (Приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 25.11.2002 г. № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждений здравоохранения», приложение 3 (Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения»).

ОК РБ 26.51.43.300

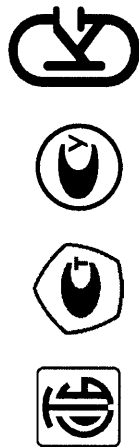

Прибор специализированный
определения концентрации паров этанола
в выдыхаемом воздухе

«Алконт 01са»

ФОРМУЛЯР

ТФАГ 413422.001-03 ФО




Содержание

1 Общие указания	4
2 Основные сведения об изделии	4
3 Основные технические данные	5
4 Индивидуальные особенности изделия	8
5 Комплектность	9
6 Указания мер безопасности	9
7 Подготовка к работе	10
8 Порядок работы при освидетельствовании	12
9 Контроль состояния системы. Возможные неисправности и способы их устранения	14
10 Ресурсы, сроки службы и хранения; гарантии изготовителя	16
11 Свидетельство об упаковывании	17
12 Свидетельство о приемке	18
13 Движение изделия при эксплуатации	19
14 Учет работы изделия	20
15 Учет технического обслуживания	20
16 Работы при эксплуатации	22
17 Хранение	25
18 Ремонт	26
19 Особые отметки	27
20 Контроль состояния изделия и ведения формуляра	28
21 Перечень приложений	29

Литература:

1. Инструкция «О порядке направления водителей транспортных средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования», утв. МВД, Минздравом, Минюстом Республики Беларусь, введ. в действие с 01.07.94 г.
2. Положение о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.
Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 апреля 2011 г. № 497.
3. Методические указания по диагностике алкогольного опьянения. Приложение №3 к приказу по МЗ СССР №523 от 22.11.54 г.
4. Острые отравления. Диагноз. Лечение. Медицинское издательство. Бухарест, 1984 г.
5. Инструкция по применению прибора для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе ППС-1 и генератора контрольных смесей ГС-1 (Ра 2.840.112ДII). Рекомендована комиссией по приборам и аппаратам, приемлемым для исследования газообмена, газоанализа и газов в крови, Комитетом по новой медицинской технике Управления по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники – протокол №5 от 20.12.83 г. Утверждена 12.06.84 г.
6. Рекламные материалы фирмы Figaro Engineering Inc., Япония, префектура Осака, г. Миноо.
7. Если вы за рулем: Медицинские аспекты безопасности дорожного движения. – Мн.: Полимья. 1989.

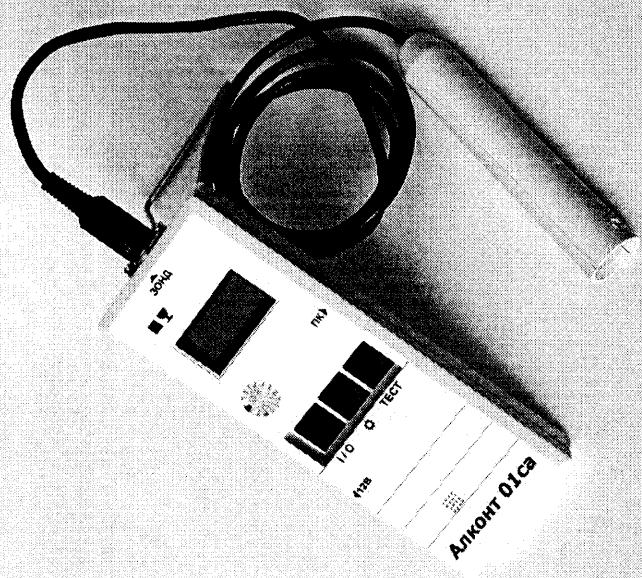

Адрес изготовителя, обслуживание, поверка, ремонт:

ООО «Брестское техническое агентство»

224 022, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Суворова 112

тел./факс: (8-0162) 52-56-58, (8-0162) 93-53-83, (8-017) 270-19-06

e-mail: microt@brest.by, <https://www.alcont-brest.by/>

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий формуляр предназначен для ознакомления обслуживающего персонала (пользователей) с устройством, принципом работы, техническими данными, правилами эксплуатации и технического обслуживания специализированного прибора определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01са» (в дальнейшем прибор).

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с формуляром изделия.

Формуляр должен постоянно находиться с прибором.

При записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смываемыми чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо, после подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче прибора на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01са» изготовлен в _____ 202_ г.

Заводской номер изделия

Сертификат об утверждении типа средств измерений (РБ) № 14513 от 1 ноября 2021 г. зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 25 0559 16 и допущен к применению в Республике Беларусь с 9 декабря 1997 года. Срок действия до 1 ноября 2026 г.

Сертификат об утверждении типа средств измерений (РФ): ВУ.С.31.999.А № 7803 от 22 апреля 2000 г. № Государственного реестра средств измерений: 19513-00

Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники (Украина) № UA-MI/3-649-2012 выдано 29 августа 2012 г.

Сертификат № 1162 о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан). Зарегистрирован в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 09.02.2022 г. за № KZ.02.03.00846-2022/14513. Действителен до 01.11.2026 г.

Декларация о соответствии Евразийского Экономического Союза Рег. № ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 02588 от 29.09.2021. Срок действия до 13 сентября 2026 г. включительно.

- менее 0,3 промилле - влияние алкоголя отсутствует;
- от 0,3 до 0,5 промилле - незначительное влияние алкоголя;
- от 0,5 до 1,5 промилле - легкое опьянение;
- от 1,5 до 2,5 промилле - опьянение средней степени;
- от 2,5 до 3 промилле - сильное опьянение.

По итогам проведения освидетельствования должностным лицом в протоколе процессуального действия, врачом – в акте освидетельствования отражается одно из следующих заключений:

1. Состояние на момент освидетельствования:
 - отсутствует состояние алкогольного опьянения и (или) состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;
 - состояние алкогольного опьянения;
 - состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;
 - состояние алкогольного опьянения и состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.

2. Отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования.

Основным нормативным документом, определяющим отношение водителей к алкоголю, являются Правила дорожного движения, которые "запрещают управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения". Таким образом, ограничению водителя без учета воздействия на способность к вождению малых субклинических доз алкоголя (можно быть "нетрезвым", но "не пьяным"); можно ли быть трезвым в состоянии похмелья?).

Пока же, Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным в состоянии алкогольного опьянения, а нормативные документы органов здравоохранения уточняют и определяют границы опьянения, которое начинается с 0,3 промилле (‰) алкоголя в крови (150 мкг/л в выдыхаемом воздухе) [2].

Водитель, выпивший рюмку водки, стакан вина, бокал пива, может быть официально признан трезвым при условии – концентрация алкоголя в крови не должна составлять и превышать 0,3 ‰ (150 мкг/л).

Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015 зарегистрирован в реестре Национальной Системы подтверждения соответствия Республики Беларусь **11 февраля 2022 г. № BY/112 05.01.003.01 00311**. Действителен до 10 февраля 2025 г.

Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 зарегистрирован в реестре Национальной Системы подтверждения соответствия Республики Беларусь **11 февраля 2022 г. № BY/112 05.06.003.01 00312**. Действителен до 10 февраля 2025 г.

Приложением [2] узаконено в Республике Беларусь состояние алкогольного опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в крови в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.

В европейских и североамериканских странах дело обстоит несколько иначе, что можно проследить по нижеприведенным данным, взятым из журнала "NEWSWEEK".

Спиртные напитки, выпитые в течение одного часа (☞ =1доза)*	Разрешенный предел для водителя, ‰ (мг/мл)	Страна	Вероятное состояние	Вероятность несчастных случаев со смертельным исходом
☞☞	0,2	Швеция	Легкое чувство теплоты и расслабления. Внимание может быть рассеянным.	Повышается в 1,2 раза
☞☞☞	0,5	Бельгия, Финляндия, Франция, Греция, Нидерланды, Норвегия, Португалия	Замедление реакций, затруднения при принятии оптимальных решений	Повышается в 4 раза
☞☞☞☞	0,8	Австрия, Британия, Канада, Дания, Германия, Ирландия, ряд штатов США	Нарушение общей координации. Контроль за скоростью и управление затруднены.	Повышается в 10 раз
☞☞☞☞☞	1,0	Большинство штатов США	Заторможность реакций делает даже нормальные условия дорожного движения опасными.	Повышается в 20 раз

* 1 доза включает в себя либо 1,5 унции ликера (44,4 мл), либо 4 унции вина (118,3 мл), либо 12 унций пива (355 мл).

** Приведено содержание алкоголя в крови для мужчин весом 170 фунтов (77 кг). Содержание алкоголя в крови для лиц с меньшей массой тела может быть выше, а с большей массой тела – ниже, чем приведенные в таблице.

В отечественной медицинской практике при диагностике степени опьянения в зависимости от концентрации алкоголя в крови используются следующие нормативы:

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 3.1 Прибор после включения должен обеспечивать автоматический контроль функционирования системы и подготовку к работе.
Время подготовки к работе – не более 15 мин.
- 3.2 Коэффициент пересчёта входной величины прибора – концентрации паров этанола в паро-газовой смеси (мг/м³) в отображаемую выходную величину – концентрацию этанола в крови (‰) равен 450 (45 мг/м³ (0,045 мг/л) – 0,1 ‰ (промилле)).
- 3.3 Полный диапазон измеряемых значений входной величины – от 0 до 990 мг/м³, отображаемых в выходную величину – от 0 до 0,990 мг/л с дискретностью 0,001 мг/л (от 0,0 до 2,2 ‰, с дискретностью показаний 0,1 ‰).
- 3.4 Дополнительный диапазон экстраполируемых и отображаемых в специальном режиме значений входной величины свыше 990 мг/м³ в значении выходной величины от 0,990 мг/л (от 2,2 ‰) и выше (по верхней границе не лимитируется) – рассчитывается микро-ЭВМ прибора благодаря линейности измеряемой величины выше верхней границы нормируемого диапазона.

3.5 Приведенная погрешность прибора ($\gamma_{\text{пр}}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины I – от 0 до 500 мг/м³, отображаемых в выходные величины от 0 до 0,500 мг/л (от 0,0 до 1,1 ‰), не более (± 10) %.

3.6 Относительная погрешность ($\sigma_{\text{отн}}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины II – свыше 500 мг/м³ до 990 мг/м³, отображаемых в выходные величины > 0,500 до 0,990 мг/л (> 1,1 до 2,2 ‰), не более (± 10) %.

3.7 Продолжительность анализа пробы выдыхаемого воздуха по методике экспресс-теста – не более 15 с.

3.8 Продолжительность подготовки прибора к следующему тесту после пробы с концентрацией паров этанола в воздухе на уровне 450 мг/м³ (эквивалентной 0,450 мг/л, 1,0 ‰) – не более 40 с.

3.9 Максимальная электрическая мощность, потребляемая прибором, – не более 6,0 Вт.

3.10 Масса прибора – не более 0,4 кг.

3.11 Габаритные размеры прибора без разъемов, соединительных шнуров и выносных частей – 191×74×27 мм.

3.12 Средняя наработка прибора на отказ – не менее 6000 ч.

3.13 Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 8 ч в сутки.

3.14 Среднее время восстановления работоспособности прибора путем замены отказавшего газового сенсора – не более 30 мин.

3.15 Средний срок сохраняемости прибора должен быть не менее 6 месяцев.

3.16 Устройство и принцип работы.

Прибор «Алконт 01са» представляет собой (рис. 1) пластмассовый блок, имеющий на лицевой панели (поз. 3) двух-строчный жидкокристаллический дисплей (поз. 2) с организацией 2×8 символов, «окошко» сигнального светодиода (поз. 1) и три кнопки управления: левая (поз. 4) – включения/выключения прибора (I/O); средняя (поз. 5) – включения/выключения подсветки дисплея (☼); правая (поз. 11) – вызова режима «ТЕСТ».

На верхней торцевой части прибор имеет разъем-розетку (поз. 7) для стыковки сенсорного зонда с мундштуком (поз. 12, 9) (маркировка «ЗОНД»). На левой боковой поверхности (вид сверху) ниже кнопочной ниши находится разъем-вилка (поз. 6) для подключения источников питания (маркировка «12 В»). На правой боковой поверхности (вид сверху) ниже кнопочной ниши расположен разъем mini-USB (поз. 10) для подключения прибора к персональному компьютеру (маркировка «ПК»).

Изделие имеет съемную приборную ножку-подставку (поз. 8) для его установки на горизонтальной поверхности при эксплуатации.

Значение диуреза для выведения алкоголя из организма обычно невелико: так, в первые часы выделяется всего 1-2 % введенного алкоголя. Однако, введение, наряду с алкоголем большого количества воды, а также мочегонных средств дает понижение максимальной концентрации алкоголя в крови и вместе с тем ослабление общих явлений опьянения.

Как отмечалось выше, концентрация алкоголя в крови здорового человека оказывается максимальной через 1-2 часа после приема алкоголя, и зависит не только от количества алкоголя, но и от индивидуальных особенностей организма.

Принимая во внимание все сказанное, имеющее отношение не только к крови, но и к другим биологическим средам организма человека, можно, исходя из них, установить ретроспективно не только факт употребления алкоголя, но и его приблизительное количество.

Количество выпитого алкогольного напитка и степень опьянения (для человека весом 60 кг) [6]

Количество алкогольного напитка*				Концентрация алкоголя в крови, мг/мл (‰)	Состояние
сухое вино (9% об. спирта), стакан, 0,1 л	пиво (4% об. спирта), бутылка 0,5 л	саке (19% об. спирта), бокал, 0,18 л	виски (55% об. спирта), стопка, 0,04 л		
1,5 - 3	0,5 - 1	0,5 - 1	1 - 2	0,2 - 0,4	Появление чувства усталости, покраснение лица
3 - 6	2	1 - 2	2 - 5	0,5 - 1	Легкое опьянение, болтливость, замедление действий
6 - 9	3	3	6 - 7	1,1 - 1,5	Отмечается пошатывание, явление неопределенности
15 - 20	5 - 7	5 - 7	10 - 15	> 1,6	Сильное опьянение, нечленораздельная речь, шатающаяся походка, возможны приступы тошноты

Примечание: * Возможны различия в зависимости от емкости посуды и крепости алкогольного напитка.

танные, несвязные; отмечается постепенный переход от чрезмерной говорливости к дизартрии. Притупляется чувствительность вообще, зрение и слух – в частности. Походка качающаяся, атаксическая, проявляется неуверенность в движениях нижних конечностей. В этой фазе отравившийся резко переходит от чрезмерно веселого настроения к приступам ярости, проявляет дезориентацию, спутанность, психические нарушения, ведущие к агрессивному поведению (противоправным действиям, несчастным случаям и т.д.). Нередко у отравившегося появляется рвота в результате острого спиртового гастрита.

Последняя фаза, в клиническом плане, **соответствует спиртовой коме (глубокая степень опьянения)**, концентрация спирта в крови составляет 4,0-5,5 ‰ [3] (превышает 2,5 ‰ [4]). В принципе спиртовая кома протекает спокойно, сопровождается признаками анестезии в связи со снотворным действием алкоголя. Костносухожильные рефлексы выпадают, зрачки нормальные или расширенные. В редких случаях появляются приступы судорог. Кома, вызванная потреблением сублетальной дозы спирта, продолжается 6-12 часов.

Глубокая спиртовая кома, наступающая после потребления летальной дозы спирта, затягивается и протекает со смертельным исходом за счет недостаточности дыхания или кровообращения.

По данным источника [3], концентрация алкоголя в крови выше 8,0 ‰ (10 мл спирта на 1 л крови) почти никогда не наблюдается у человека.

Констатируя в крови живого человека определенную концентрацию алкоголя, можно судить и о количестве выпитого им, принимая во внимание следующие обстоятельства:

1. Время, прошедшее от момента приема алкоголя до момента исследования. При этом надо учесть, что в организме человека перерабатывается за 1 час в среднем 7-10 см³ чистого алкоголя (5,5-8,0 г спирта) или 18-25 см³ 40° водки. Преобразование алкоголя в организме хронического алкоголика происходит обычно быстрее (но не более чем на 1/3). В вечерние часы алкоголь расщепляется в среднем на 25% быстрее, чем в утренние.
2. Концентрацию принятого испытуемым алкогольного напитка. Известно, что более крепкие напитки дают более высокую и быструю максимальную концентрацию алкоголя в организме, и наоборот.
3. Условия приема алкоголя в организм. В одних случаях он может быть введен единовременно (или быстро следующими одна за одной порциями), в других случаях, наоборот, медленно, малыми порциями. Естественно, что в первом случае, имеющем большое судебно-экспертное значение, концентрация алкоголя в крови окажется более высокой и картина опьянения – более резкой. То же произойдет, если алкоголь принят на пустой желудок; прием же пищи до введения алкоголя ведет к более медленному всасыванию последнего и более мягкой картине опьянения (хотя и более длительной).

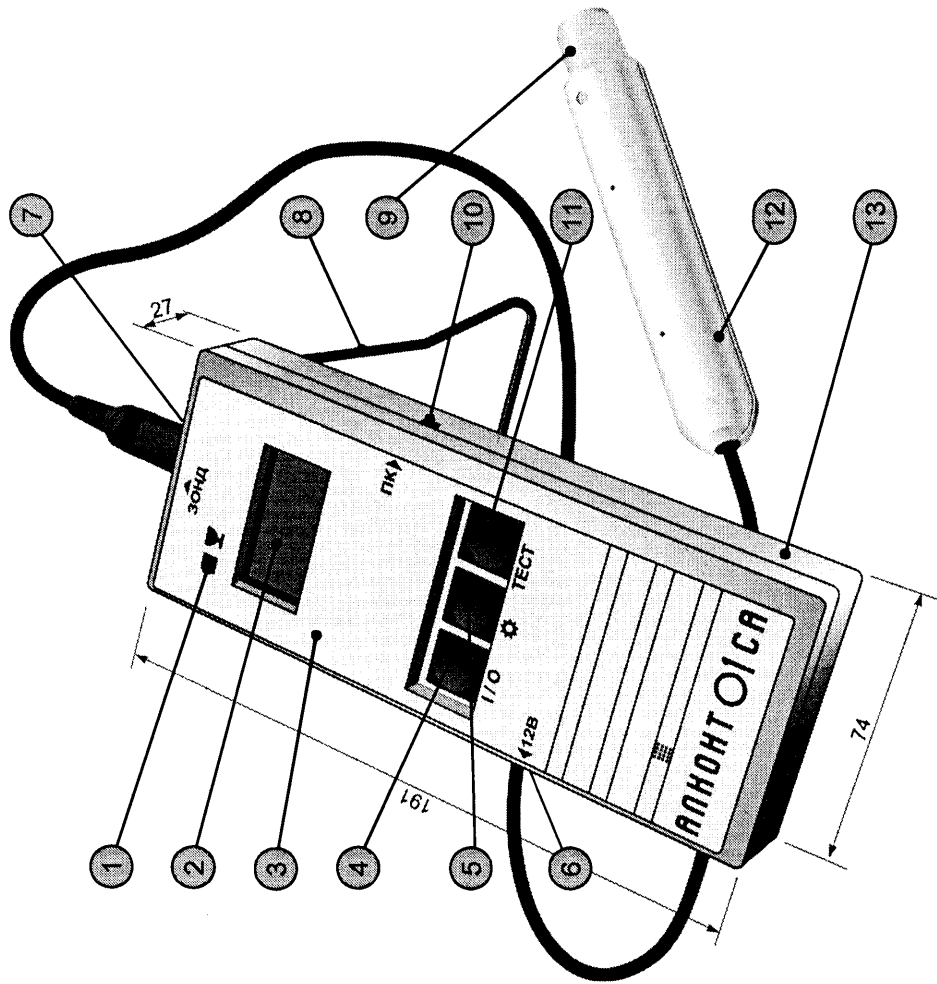


Рис. 1. Внешний вид и габаритные размеры прибора "Алkont 01са".

- | | |
|--|---|
| 1 – сигнальный светодиод; | сенсорный зонд; |
| 2 – дисплей; | 8 – съёмная ножка-подставка; |
| 3 – крышка; | 9 – мундштук индивидуального пользования; |
| 4 – кнопка включения/выключения прибора; | 10 – разъём (розетка) подключения шнура связи с персональным компьютером; |
| 5 – кнопка включения/выключения подсветки дисплея; | 11 – кнопка вызова режима "ТЕСТ"; |
| 6 – разъём (вилка) подключения источника питания 12 В; | 12 – сенсорный зонд; |
| 7 – разъём (розетка) подключения | 13 – корпус. |

На задней поверхности корпуса расположена товарная табличка. Для питания прибора от сети переменного тока используется комплектный адаптер (230/12 В). Питание от бортовой сети автомобиля (12 В) осуществляется через комплектный шнур питания, подключаемый к гнезду прикуривателя. Питание от встроенного аккумулятора с системой контроля «заряд-разряд» осуществляется при автономном включении прибора (без подключения сетевого адаптера или шнура прикуривателя).

Выдыхаемый воздух (проба) поступает в сенсорный зонд через сменный мундштук индивидуального пользования. Мундштук исключает проникновение непосредственно на газовый сенсор капельной влаги или механических частиц. Сенсор вентилируется при извлечении мундштука.

Наличие алкоголя в выдыхаемом испытуемым воздухе определяется изменением электропроводности чувствительного элемента (полупроводникового газового сенсора) пропорционально концентрации этанола в воздухе (мг/м^3). Окончательный результат выводится на жидкокристаллический дисплей в единицах массовой концентрации этанола в выдыхаемом воздухе (мг/л) и единицах промилле (‰), соответствующих содержанию алкоголя в крови (мг/мл).

Установление показаний от 0,150 мг/л (0,3 ‰) (включительно) и выше сопровождается подачей повторяющегося звукового сигнала и красным свечением сигнального светодиода.

Обязательным условием достоверности результатов измерений является соблюдение рекомендаций «Методики освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01са"» (Приложение 1).

4 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

4.1 Оптимальный режим использования – ежедневная эксплуатация прибора, исключающая длительные перерывы в работе. Определяется особенностью осаждения примесей из воздуха на холодный чувствительный элемент первичного электронного преобразователя в нерабочем состоянии прибора. После длительного хранения требуется кондиционирование газового сенсора – тренировка прибора во включенном состоянии для восстановления эксплуатационных кондиций (п. 15.1.3). С этим связаны требования к условиям текущего хранения: хранить сенсорные зонды с приборами в вентилируемых (прветриваемых) помещениях вдали от мест хранения (разлива) растворов, источников дыма.

4.2 Внимание, недопустимо попадание чистых растворов (спирта, ацетона и т. п.) или их растворов на газовый сенсор, части сенсорного зонда и прибор, а также использование указанных жидкостей для обработки (протирки) прибора и его частей.

трация спирта в крови до 1,0 ‰ (промилле) в принципе достигается после потребления 1 грамма чистого спирта на 1 кг веса. Предельная концентрация спирта в крови отмечается спустя 20 - 30 минут после потребления спирта на голодный желудок или спустя 1 - 2 часа после еды. Наибольшая часть поглощаемого спирта концентрируется в головном мозге, остальная часть, в нисходящем порядке, в других органах – легких, селезенке, почках. Скапливающееся в печени количество спирта нелегко определить, поскольку в этом органе происходит его биологическое преобразование.

Этиловый спирт не накапливается в организме, он удаляется быстро, стойким ритмом с момента его появления в тканях. Наибольшая доза поглощаемого спирта (90 - 95%) подлечит метаболизму и лишь незначительная часть (5 - 10 %) удаляется как таковая с мочой (2 - 4 %) и выдыхаемым воздухом (3 - 7 %). Рост мочеотделения или гипервентиляция не ускоряют существенно удаление спирта из организма. Биохимическое преобразование спирта осуществляется микросомами печени под воздействием фермента – алкогольдегидрогеназы.

Симптомология острого алкогольного отравления тесно связана с концентрацией спирта в крови. При этом, ее течение трехфазное: фаза возбуждения (легкая степень опьянения), фаза судебной медицины (выраженное опьянение, средняя степень опьянения), фаза коматозного состояния (глубокая степень опьянения).

В ряде источников, в том числе, использованных [3], [4], данные о содержании алкоголя в крови, сопутствующими каждой из фаз, несколько отличаются, хотя данные источника [4] более современны.

В фазе возбуждения (легкая степень опьянения), когда концентрация спирта в крови составляет 0,8-1,6 ‰ [0,5-1,5 ‰], у отравившегося отмечаются состояние эйфории, экспансивность, несдержанность и невозможность точного определения опасности. Способность наблюдения, острота зрения и слуха, быстрота рефлекторной реакции и вообще, как психическая, так и физическая способность снижены. Вот поэтому эта фаза неправильно названа "возбуждением", поскольку она является результатом угнетающего действия этилового спирта на высшие нервные центры, выполняющие контрольную и управляющую функции в отношении низших центров. В связи с этим развивается чрезмерная необузданная активность низших центров, ускользающих из под контроля высших центров, находящихся в угнетенном состоянии. Это объясняет причину, по которой, на этой стадии, у отравившегося проявляется необузданность инстинктов и бесконтрольное – самопроизвольное и менее критическое поведение. В этой же фазе происходит расширение периферических сосудов, создающее ощущение тепла.

В следующей фазе, названной судебно-медицинской (средняя степень опьянения, или выраженное опьянение), которая соответствует концентрации спирта в крови 1,6-3,2 ‰ [1,5-2,5 ‰], у отравившегося наблюдаются хорошо известные проявления алкогольного опьянения. Мысли сплыва-

Испытуемый должен быть опрошен на предмет употребления накануне измерения алкогольных напитков, лекарств, а также курения. В последнем случае измерение проводится не раньше, чем через 3 минуты после курения; в случае применения терапевтической дозы спиртосодержащих лекарств измерение проводится не раньше, чем через 15-20 минут после их приема.

При освидетельствовании водитель должен знать (и указывать на это проверяющему), что любой прибор имеет установленную погрешность, которая обязательно отражена в его эксплуатационной документации.

Важно учитывать и то, что ошибки измерения при освидетельствовании могут быть вызваны присутствием в окружающем воздухе низкомолекулярных летучих углеводородов – например, ацетона, метанола или этанола.

II. При широком практическом применении методов диагностики алкогольного опьянения следует иметь в виду следующие обстоятельства:

- 1 Методы диагностики должны быть по возможности просты, быстры, не требовать сложной аппаратуры.
2. Методы не должны быть тягостны для испытуемого (что имеет место при взятии проб крови, содержимого желудка и т.д.).
3. Необходимо строго учитывать разнообразие реакций на алкоголь отдельных лиц, обстоятельства, при которых был принят алкоголь, наличие клинических синдромов опьянения; помня, что проба на алкоголь в биологических средах (выдыхаемом воздухе, крови, моче, слюне и т.д.) является подобным методом, помогающим врачу ориентироваться в состоянии испытуемого. Это изображение всегда надо иметь в виду во избежание возможных диагностических ошибок.
- 4 При любом из биохимических и физико-химических методов возможны отдельные ошибочные показания как в силу недостаточной концентрации алкоголя в исследуемой среде, так и вследствие неполной специфичности того или иного метода определения алкоголя.

Поэтому отрицательная реакция на алкоголь еще не исключает наличия опьянения и, наоборот, положительная (особенно слабо положительная, сомнительная) не является сама по себе доказательством опьянения.

Несмотря на довольно значительные индивидуальные различия в реакции на алкоголь, все же многие исследования концентрации алкоголя в крови указывают на известную последовательность и закономерность распространения алкоголя в организме и фаз алкогольного опьянения.

В организме человека содержится небольшое количество этилового (винного) спирта, образующегося при промежуточном метаболизме или брожении в пищеварительном тракте. Концентрация этого спирта в крови обычно не превышает 0,03 мг/мл (‰).

Винный спирт быстро поглощается пищеварительным трактом посредством слизистых оболочек рта, желудка и кишечника, и также быстро распространяется в тканях, где подвергается процессам метаболизма. Концен-

4.3 Прибор имеет стеклянный экран дисплея на жидких кристаллах, требующий мер предосторожности при эксплуатации, упаковке, погрузке, выгрузке, транспортировании, извлечении из упаковки.

4.4 При переключении режимов работы прибора из-за специфики системы опроса измерительных каналов, иногда, на время до 1 секунды, на дисплее могут появляться переходные сообщения.

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер	Примечание
ТФАГ 413422.001-03	Прибор "Алконт 01са"	1		
Комплект принадлежностей:				
ТФАГ 713423.001	мундштук	100		
AC-DC adapter 230V/12V	блок питания 12 В / 500 мА	1		
ТФАГ 465139.001-01	шнур питания от бортовой сети	1		
шнур mini USB – USB	шнур связи с ПК	1		
ТФАГ 304274.001	опора	1		
www.alcont.brest.by (AlcSA_v7_03.exe)	программа поддержки для ПК	—		сайт
ТФАГ 413422.001-03ФО	формуляр	1		
МРБ МП.367-2021	методика поверки	1		
СТБ 1015-97	упаковка	1		

6 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 К обслуживанию прибора допускаются лица только после инструктажа по технике безопасности и ознакомления с настоящим формуляром.

6.2 При эксплуатации прибора с использованием сетевого адаптера от электросети 230 В / 50 Гц использовать только исправные розетки.

6.3 Во избежание выхода прибора из строя не допускать попадания конденсированной влаги на корпус изделия, выносные части, сетевой адаптер; оберегать приборы от механических ударов, термических воздействий; не разбирать изделие, сетевой адаптер, шнуры связи, а также сенсорный зонд.

6.4 Запекание изделия и его частей устранять протиранием х/б салфеткой.

6.5 Запрещается использовать не входящие в комплект поставки адаптеры, шнуры связи, мундштуки для работы с прибором, а также прибор и комплектные изделия не по назначению.

6.6 Приборы должны применяться и эксплуатироваться только в режимах и условиях, установленных ТУ РБ 28801552.004-99 и отраженных в формуляре ТФАГ 413422.001-03 ФО.

6.7 Приборы укомплектованы литий-ионными аккумуляторными батареями, требующими дополнительных мер безопасности при эксплуатации и хранении:

- Избегать воздействия на изделия источников тепловой и лучистой энергии.
- Не оставлять изделия без контроля во время зарядки аккумулятора (признак процесса зарядки – зелёное свечение сигнального светодиода).
- Желательно автономно работать полными циклами: «полный заряд» – «полный разряд».

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Распаковать прибор и проверить его комплектность.

7.2 Произвести внешний осмотр прибора, определить его целостность.

7.3 Присоединить сенсорный зонд к разъему "ЗОНД" прибора.

7.4 При работе от сети переменного тока, соединить комплектный сетевой адаптер с разъемом "12 В" прибора, подключить вилку адаптера в сетевую розетку (230 В / 50 Гц).

7.5 При работе от бортовой сети, соединить комплектный шнур питания от бортовой сети с разъемом "12 В" прибора, подключить вилку шнура в розетку прикуривателя.

Примечание: Потребитель по желанию может использовать ножку подставку.

7.6 При автономной работе от встроенного аккумулятора с системой контроля «заряд-разряд» включить прибор согласно п. 7.7.

7.7 Включить прибор. Включение (выключение) производится нажатием кнопки $<1 / 0>$ с удержанием её 2–3 секунды (включение) до появления звукового сигнала и названия прибора на дисплее

Освидетельствование в медицинских учреждениях для установления состояния опьянения проводится в любое время суток специально подготовленными врачами в:

- специальных кабинетах наркологических диспансеров;
- определенных органами здравоохранения лечебно-профилактических учреждений;
- передвижных специализированных медицинских автолабораториях.

Если проведение освидетельствования в полном объеме не представляется возможным из-за тяжести или характера полученных травм, то в лечебном учреждении в обязательном порядке должны проводиться исследования для установления наличия алкоголя в биологических средах (выдыхаемый воздух, моча, кровь, слюна).

Любому водителю, проходящему освидетельствование, необходимо знать, что при проведении освидетельствования врачом медучреждения заполняется в двух экземплярах акт освидетельствования физического лица на предмет выявления состояния опьянения, удостоверенный подписью и печатью врача. Первый экземпляр акта освидетельствования выдаётся должностному лицу, доставившему физическое лицо в организацию здравоохранения, второй – хранится в организации здравоохранения.

Не стоит, что часто бывает, пытаться скрыть от правоохранительных органов свои паспортные данные. Лицо, направляющее на освидетельствование, обязано принять меры к установлению личности водителя, а врач – удостовериться в личности водителя путем ознакомления с соответствующим документом. **Отсутствие личных документов не служит основанием к тому, чтобы не проводить освидетельствование водителя.** При отсутствии таких документов в протоколе фиксируются приметы обследуемого, указывается, что данные о его личности записаны со слов освидетельствуемого.

Организация здравоохранения при обращении физического лица, в отношении которого проводилось освидетельствование, за получением информации о его результатах выдаёт ему медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую заключение, вынесенное по результатам освидетельствования, в порядке, установленном законодательством.

При подозрении на наличие у обследуемого лица травматических повреждений или заболевания, внешние проявления которого сходны с признаками алкогольного опьянения, такой водитель после оказания первой медицинской помощи (если она требуется) должен быть доставлен в лечебное учреждение для оказания основной помощи и освидетельствования на предмет опьянения.

В специальных приборах концентрация алкоголя в крови определяется косвенным методом, путем регистрации паров спирта в выдыхаемом воздухе. Данные приборы могут эксплуатироваться в строгом соответствии с их эксплуатационной документацией.

Методические указания
по диагностике алкогольного опьянения
с использованием специальных технических средств
(специализированных приборов определения
концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе
«Алконт 01с»)

Освидетельствование физических лиц с целью установления состояния алкогольного опьянения имеет два взаимосвязанных аспекта: юридический и медицинский (клинико-диагностический). Незнание основ содержания этих двух составляющих приводит к конфликтам, жалобам, судебным разбирательствам.

В Республике Беларусь порядок освидетельствования был юридически закреплён в Инструкции «О порядке направления водителей транспортных средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования», утвержденной МВД, Минздравом и Минюстом РБ, и введенной в действие с 01.07.1994 года [1]. С 12.08.2011 года вступило в действие «Положение о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 апреля 2011 г. № 497 [2]. Это говорит о значимости сохранения и защиты прав граждан, подвергающихся подобной процедуре, а также о необходимости знания и соблюдения указанного порядка самими водителями.

1. Освидетельствование водителей транспортных средств, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения (перечень действий и признаков, наличие которых является достаточным основанием полагать, что физическое лицо, в отношении которого ведётся административный процесс, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения – согласно Приложению 1 к Положению [2]), проводится лицами, средствами, в местах и в порядке, установленных Положением [2].

При уклонении лица от освидетельствования составляется протокол, в котором указываются признаки опьянения и действия нарушения по уклонению от освидетельствования.

Уклонение водителя от освидетельствования ни к чему хорошему не приведет: факт опьянения будет установлен инспектором Госавтоинспекции лично и зафиксирован в протоколе, что уже никак не опровергнешь.

Сразу же после включения, одновременно со звуковым сигналом, на дисплее появится сообщение

АЛКОНТ
01са

7.8 Система прибора после включения обеспечивает постоянный автоматический контроль функционального состояния в процессе работы. В случае обнаружения нарушений в работе частей системы выдается одно из сообщений:

ГАЗ.СЕН.
ОБРЫВ

обрыв в цепи газового сенсора.

В случае появления соответствующих сообщений обратитесь к рекомендациям Приложения 3 формуляра («Методика технического контроля, калибровки и настройки прибора "Алконт 01са"»).

Появление контрольного сообщения вида:

КОНТРОЛЬ
СИСТЕМЫ

свидетельствует, что произошло несанкционированное нарушение в хранении базы данных (мощные электропомехи и/или радиопомехи, некомпетентный доступ к защищенным режимам коррекции). В действующих версиях программного обеспечения приборов (v.6.3; v.7.0) работает система защиты информации в энергонезависимой памяти.

В случае появления на дисплее данного сообщения – выключите прибор. Выждав паузу (порядка 20-30 сек.), включите прибор повторно. Если сообщение «Контроль системы» появится вновь, нажмите кнопку <ТЕСТ>. Если сообщение остается на дисплее – обратитесь к рекомендациям Приложения 3 формуляра («Методика технического контроля, калибровки и настройки прибора «Алконт 01са») по просмотру и восстановлению рабочей информации прибора.

7.9 В случае отсутствия неисправностей автоматически включается режим подготовки прибора к работе. Название изделия на дисплее сменяется на показания часов-календаря вида:

13.15:31
14.05.05

(Тринадцать часов пятнадцать минут тридцать одна секунда четырнадцатого мая две тысячи пятого года).

На шестой-десятой секунде режима подготовки проводится тестирование звукоизлучателя с выдачей звукового сигнала.

В случае определения системой состояния готовности к проведению теста (завершение прогрева и "очистки" газового сенсора) – появляется сообщение вида:

13.16.42
ГОТОВ

7.10 Режим "готовности" сопровождается постоянным контролем системы за состоянием газового сенсора. В случае его "загрязнения" в рабочем порядке запускается режим контроля текущей готовности с выдачей соответствующих сообщений часов-календаря вида:

13.32.18
14.10.97

В таком состоянии прибор **НЕ ГОТОВ** к тестированию!

7.11 Вызов из состояния "готовности" режима тестирования осуществляется нажатием кнопки <TEST> с появлением сообщения вида:

00*TEST*
Алк: 0.0 ‰

Отказ от него – однократное нажатие кнопки <TEST> с выходом в текущее состояние ожидания.

7.12 Связь с персональным компьютером обеспечивается в любом режиме работы прибора. Единственное условие обеспечения связи – прибор должен быть включен (в любом режиме)!

7.13 Однократное нажатие кнопки <☀> в любом режиме работы прибора включает подсветку дисплея. Последующее нажатие включает подсветку.

8 ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ

8.1 Для проведения определения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом испытуемым воздухе, следует, руководствуясь рекомендациями Приложения 1, плотно (до упора) вставить в сенсорный зонд, соблюдая требования санитарной гигиены, ответной короткой частью мундштук индивидуального пользования.

8.2 Пользователь инструктирует испытуемого и однократным нажатием кнопки <TEST> выводит прибор из режима ожидания ("ГОТОВ") в состояние готовности к проведению теста, при этом на дисплее устанавливается сообщение вида:

ОЖИДАНИЕ
ВЫДОХА

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{1,9 - 2,0}{2,0} \cdot 100 = -5\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\%);$$

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,1 - 0,1}{0,5} \cdot 100 = 0\% \text{ (норма по [1] } \pm 20\%);$$

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,2 - 0,2}{0,5} \cdot 100 = 0\% \text{ (норма по [1] } \pm 20\%);$$

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,7 - 0,5}{0,5} \cdot 100 = +40\% \text{ (норма по [1] } \pm 20\%);$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{\text{пр}}^I$) для данного диапазона. Результаты поверки отрицательные.

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,5 - 0,6}{2,0} \cdot 100 = -5\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\%);$$

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,9 - 1,0}{2,0} \cdot 100 = -5\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\%);$$

$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{1,6 - 2,0}{2,0} \cdot 100 = -20\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\%);$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{\text{пр}}^{\text{II}}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

Библиография:

- [1] ТУ РБ 28801552.004-99. Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алкотон 01с», «Алкотон 01см», «Алкотон 01су», «Алкотон 01са». Технические условия. Формуляры
- [2] ТУ 4381-043-21298618-2009. Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-META-02М. Технические условия
- [3] Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений, утвержденные постановлением Госстандарта от 21 апреля 2021 г. № 40

8.3 Обследуемый сидит, на фоне спокойного дыхания, зажав мундштук губами и, удерживая зонд любой рукой, делает один плавный продолжительный выдох, – до появления на дисплее прибора справа от времени выдоха в секундах, одновременно со звуковым сигналом – значения объёма выдыхаемого воздуха **1,5 л** (минимального для анализа количество воздуха).

После окончания выдоха испытуемый освобождает губы от мундштука и кладет сенсорный зонд, не извлекая мундштук из зонда до окончания теста.

8.4 Если испытуемый выполнил все действия правильно, то после подачи звукового сигнала включается таймер. Следующим подтверждением состоятельности теста является сопровождаемое звуковым сигналом появление сообщения вида:

04с 2,5л
ВЫДОХ

Это значит, что через измерительную ячейку прошло необходимое для проведения теста количество выдыхаемого воздуха.

Окончательный результат фиксируется на дисплее с подачей звукового сигнала и имеет вид:

0,150 мг/л
Алк 0,3‰

Если показания прибора достигли значения 0,150 мг/л (0,3 ‰) или выше, то после остановки теста с выдачей окончательного результата раздается повторяющийся через равные промежутки времени звуковой сигнал, который дублируется красным свечением сигнального светодиода.

8.5 После завершения теста необходимо извлечь мундштук из зонда для вентиляции газового сенсора и неоднократно нажать кнопку <ТЕСТ> для продолжения работы. Прибор автоматически готовится к работе. Признак готовности к продолжению работы – появление сообщения вида:

13:59:15
ГОТОВ

8.6 Если испытуемый дует в мундштук недостаточно сильно или не дует вообще – тест не запускается и сохраняется сообщение:

ОЖИДАНИЕ
ВЫДОХА

8.7 Если испытуемый делает выдох необходимой силы, но недостаточной продолжительности, или прерывистый выдох – после подачи звукового сигнала запускается таймер, но в момент установления прибором несоот-

смесь 5 (II):

$$\sigma^{\text{II}}_{\text{отн. X}} = \frac{1,125 - 0,990}{0,990} \cdot 100 = 14 \, \%,$$

$$\sigma^{\text{II}}_{\text{отн. Y}} = \frac{2,5 - 2,2}{2,2} \cdot 100 = 14 \, \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \, \%).$$

Значение относительной погрешности превышает предельное значение ($\sigma_{\text{отн.}}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

Таблица В.2 – Примеры расчётов для приборов, выпущенных до 30.08.2021

Воздействующая парогазовая смесь, номер диапазона	Номинальное значение концентрации паров этанола в воздействующей смеси X ₀ , мг/м ³	Номинальное значение выходной характеристики прибора Y ₀ , ‰	Фактические показания прибора при воздействии смесей Y, ‰
1	45	0,1	0,1
2 (I)	90	0,2	0,2
3	225	0,5	0,6
4	270	0,6	0,7
5 (II)	450	1,0	1,1
6	900	2,0	1,9
1	45	0,1	0,1
2 (I)	90	0,2	0,2
3	225	0,5	0,7
4	270	0,6	0,5
5 (II)	450	1,0	0,9
6	900	2,0	1,6

Определение приведенной погрешности прибора:

смесь 1 (I)
(таблица 4)

$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,2 - 0,2}{0,5} \cdot 100 = 0 \, \% \text{ (норма по [1] } \pm 20 \, \%);$$

смесь 2 (I)

$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,1 - 0,1}{0,5} \cdot 100 = 0 \, \% \text{ (норма по [1] } \pm 20 \, \%);$$

смесь 3 (I)

$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,6 - 0,5}{0,5} \cdot 100 = + 20 \, \% \text{ (норма по [1] } \pm 20 \, \%);$$

смесь 4 (II)

$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,7 - 0,6}{2,0} \cdot 100 = + 5 \, \% \text{ (норма по [1] } + 15 / - 5 \, \%);$$

смесь 5 (II)

$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{1,1 - 1,0}{2,0} \cdot 100 = + 5 \, \% \text{ (норма по [1] } \pm 15 \, \%);$$

ветствия характеристики пробоотбора норме, тест прерывается с выводом на дисплей сообщения вида:

ЛОЖНЫЙ
ВЫХОД

которое сопровождается периодической подачей звукового сигнала. Для выхода в режим продолжения дальнейшей работы необходимо однократно нажать кнопку <TEST>.

8.8 При любом варианте неправильных действий испытуемого тест необходимо повторить.

9 КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Система прибора позволяет контролировать возможные неисправности с помощью ряда контрольных сообщений (см. п. 7.8). Кроме этого, существует возможность "просмотра" состояния системы как с помощью персонального компьютера (см. Приложение 2 формуляра), так и с помощью дисплея прибора. Для этого необходимо после включения прибора удерживать кнопку <⚙> более двух секунд. Появится сообщение вида:

ТЕСТЫ
БЛОКА

Начало меню просмотра.

Выбор разделов – нажатие кнопки <TEST>, просмотр пунктов раздела – нажатие кнопки <⚙>.

Возможные неисправности и способы их устранения

Характеристика неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1 Отсутствуют любые сообщения после включения прибора и тестовый звуковой сигнал в течение первых 10 секунд после включения прибора.	Отсутствие напряжения питания, неисправности источников питания, повреждение подводящих проводов.	Проверить исправность сетевого адаптера, гнезда и вилки прикуривателя, целостность соединительных проводов, а также наличие напряжения в питающих сетях.
Есть звуковой сигнал, отсутствуют сообщения на дисплее.	Неисправен дисплей, либо отсутствует его контакт с платой.	Неисправность устраняет изготовитель или уполномоченная ремонтная служба.
Есть сообщения на дисплее, нет тестового звукового сигнала.	Неисправность звукоизлучателя или цепей управления им.	Неисправность устраняет изготовитель или уполномоченная ремонтная служба.

$$\gamma^I_{пр.у} = \frac{1,2 - 1,1}{1,1} \cdot 100 = 9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%)).$$

В.2 Определение относительной погрешности $\sigma^I_{отн.}$:

$$\sigma^I_{отн.х} = \frac{0,495 - 0,540}{0,540} \cdot 100 = -8 \%,$$

$$\sigma^I_{отн.у} = \frac{1,1 - 1,2}{1,2} \cdot 100 = -8 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\sigma^I_{отн.х} = \frac{1,035 - 0,990}{0,990} \cdot 100 = 5 \%,$$

$$\sigma^I_{отн.у} = \frac{2,3 - 2,2}{2,2} \cdot 100 = 5 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%)).$$

В.3 Определение приведенной погрешности прибора, $\gamma^I_{пр.}$:

$$\gamma^I_{пр.х} = \frac{0,045 - 0,090}{0,5} \cdot 100 = -9 \%,$$

$$\gamma^I_{пр.у} = \frac{0,1 - 0,2}{1,1} \cdot 100 = -9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\gamma^I_{пр.х} = \frac{0,180 - 0,180}{0,5} \cdot 100 = 0 \%,$$

$$\gamma^I_{пр.у} = \frac{0,4 - 0,4}{1,1} \cdot 100 = 0 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\gamma^I_{пр.х} = \frac{0,360 - 0,495}{0,5} \cdot 100 = -27 \%,$$

$$\gamma^I_{пр.у} = \frac{0,8 - 1,1}{1,1} \cdot 100 = -27 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{пр.}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

В.4 Определение относительной погрешности $\sigma^I_{отн.}$:

$$\sigma^I_{отн.х} = \frac{0,585 - 0,540}{0,540} \cdot 100 = 8 \%,$$

$$\sigma^I_{отн.у} = \frac{1,3 - 1,2}{1,2} \cdot 100 = 8 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

Примеры расчетов по обработке результатов измерений
при определении метрологических характеристик приборов

Таблица В.1 – Примеры расчётов для приборов, выпущенных после 30.08.2021

Воздействующая парогазовая смесь, номер диапазона	Номинальное значение массовой концентрации паров этанола в воздействующей смеси X_0 , мг/м ³ (мг/л)	Номинальное значение выходной характеристики приборов Y_0 , мг/л / ‰	Фактические показания прибора при воздействии смесей X , мг/л, / Y , ‰
1	90 (0,090)	0,090 / 0,2	0,090 / 0,2
2 (I)	180 (0,180)	0,180 / 0,4	0,225 / 0,5
3	495 (0,495)	0,495 / 1,1	0,540 / 1,2
4 (II)	540 (0,540)	0,540 / 1,2	0,495 / 1,1
5	990 (0,990)	0,990 / 2,2	1,035 / 2,3
1	90 (0,090)	0,090 / 0,2	0,045 / 0,1
2 (I)	180 (0,180)	0,180 / 0,4	0,180 / 0,4
3	495 (0,495)	0,495 / 1,1	0,360 / 0,8
4 (II)	540 (0,540)	0,540 / 1,2	0,585 / 1,3
5	990 (0,990)	0,990 / 2,2	1,125 / 2,5

В.1 Определение приведенной погрешности прибора, $\gamma_{пр}^I$, %

смесь 1 (I)
(таблица 3): $\gamma_{пр, X}^I = \frac{0,09 - 0,09}{0,5} \cdot 100 = 0 \%$,
 $\gamma_{пр, Y}^I = \frac{0,2 - 0,2}{1,1} \cdot 100 = 0 \%$ (норма по [1] ($\pm 10 \%$));

смесь 2 (I): $\gamma_{пр, X}^I = \frac{0,225 - 0,180}{0,5} \cdot 100 = 9 \%$,
 $\gamma_{пр, Y}^I = \frac{0,5 - 0,4}{1,1} \cdot 100 = 9 \%$ (норма по [1] ($\pm 10 \%$));

смесь 3 (I): $\gamma_{пр, X}^I = \frac{0,540 - 0,495}{0,5} \cdot 100 = 9 \%$,

2 Сообщение ГАЗ.СЕН. ОБРЫВ	Не подключен сенсорный зонд.	Включить сенсорный зонд в соответствующий разъем прибора. Выдержать прибор включенным хотя бы 1 минуту, выключить и включить прибор повторно.
	Нарушение целостности пайки соединительных проводов шнура сенсора с выводами разъема, проводов шнура. Плохой контакт сенсора с разъемом сенсорного зонда.	Проверить состояние и целостность пайки соединений, проводов, контактов. После устранения видимых причин неисправности включить прибор и убедиться в их устранении по соответствующим сообщениям на дисплее.
	Вышел из строя газовый сенсор.	Дополнительные указания на неисправность: Устойчивые показания прибора в режиме "контроль газового сенсора" вида: Алк:0.0‰ 4955mB (т.е. $5,0 \pm 0,2$ В)
3 Длительное сохранение сообщения вида: 17:58:21 25:06:05 (показания часов-календаря) после включения прибора в нормальных условиях работы (проветренное помещение).	Вышел из строя газовый сенсор.	Провести контроль состояния газового сенсора и его кондиционирование согласно Приложения 3 формуляра. В случае установления факта выхода его из строя, произвести замену. Замену производит уполномоченная ремонтная служба.

4 Постоянная по- теря точности хо- да часов- календаря реаль- ного времени.	Неправильная установ- ка хода часов	Руководствуясь Приложением 2 формуляра, установить необ- ходимые характеристики хода часов с помощью персонально- го компьютера или в ручном режиме (без компьютера) (см. Приложение 3 формуляра).
	Отказы элементов схе- мы корректировки хода часов.	Для устранения неисправности обратиться в уполномоченную ремонтную службу.
	Отказ или выработка ресурса источника пи- тания часов-календаря.	

10 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ;
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

10.1.1 Средняя наработка прибора на отказ должна составлять не менее 6000 часов.

10.1.2 Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней ин-
тенсивности эксплуатации 8 часов в сутки.

10.1.3 Среднее время восстановления работоспособности прибора пу-
тем замены отказавшего газового сенсора (мелкий ремонт) – не более 30
минут.

10.1.4 Средний срок сохраняемости прибора – не менее 6 месяцев (см.
п. 4.1).

10.2 Гарантии изготовителя

10.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ
РБ 28801552.004-99 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, и
хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и
эксплуатационной документацией.

10.2.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня
продажи (поставки прибора потребителю).
Гарантийный срок эксплуатации литий-ионного аккумулятора (комплек-
тующее изделие) – 6 месяцев со дня продажи (поставки потребителю).

Форма протокола поверки

наименование организации, проводившей поверку

ПРОТОКОЛ № _____

поверки прибора специализированного определения концентрации паров этанола в
выдыхаемом воздухе «Алконт 01с »

наименование средства измерений

тип _____ № _____ дата выпуска _____

принадлежащего _____

наименование организации

Изготовитель ООО «Брестское техническое агентство»

наименование изготовителя

Дата проведения поверки _____

с ... по ...

Поверка проводится по _____
обозначение документа, по которому проводят поверку

Средства поверки _____

Таблица Б.1

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер

Условия поверки

- температура окружающего воздуха _____ °С или от 15 °С до 25 °С;
- относительная влажность воздуха _____ % или от 45 % до 75 %.

Результаты поверки

Б.1 Внешний осмотр _____

соответствует/не соответствует

Б.2 Опробование _____

соответствует/не соответствует

Б.3 Определение метрологических характеристик

Б.3.1 Определение _____

наименование метрологической характеристики

Результаты измерений и оценка метрологической характеристики _____

Б.3.2

Заключение _____

соответствует/не соответствует

Свидетельство (заключение о непригодности) № _____

Поверитель _____

подпись

расшифровка подписи

10.2.3 В течение срока гарантии предприятие-изготовитель безвозмездно производит ремонт прибора или его замену при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

10.2.4 За повреждение прибора вследствие его неправильной эксплуатации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

10.2.5 Кондиционирование газового сенсора продолжительностью до 6 часов после длительного хранения прибора с целью восстановления эксплуатационных характеристик (см. п.4.1) представляет собой один из режимов технического обслуживания (п.15.1 и Приложение 3 формуляра) и также не является причиной признания факта брака.

10.2.6 Гарантийный срок хранения приборов – 6 месяцев.

10.2.7 После истечения гарантийного срока ремонт приборов осуществляется изготовителем по отдельной договоренности или специализированными ремонтными службами в соответствии с эксплуатационной документацией.

10.2.8 Изготовитель может поставлять по заказу необходимые для ремонта комплектующие.

10.2.9 В случае отказа газовых сенсоров, изготовитель может поставить их по заказу с таблицей калибровки.

10.2.10 При проведении гарантийного ремонта изготовитель обязуется вернуть потребителю изделие "Алконт 01са" (средство измерения) после проведения проверки.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе

наименование изделия

«Алконт 01са»

обозначение

завод. номер

Упакован ООО «Брестское техническое агентство» (28801552)

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным ТУ РБ 28801552.004-99.

УПАКОВЩИК N 2

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Обязательные метрологические требования к характеристикам приборов, выпущенных в разные периоды

Таблица А.1 – Обязательные требования к характеристикам приборов, выпущенных до 30.08.2021

Нормируемый диапазон измерения, ‰	Фактически определяемая величина	Допустимая (предельная) величина отклонения, ‰
I 0 – 0,5	Приведённая погрешность $\gamma_{пр}^I$	± 20
II 0,6 – 2,0	Приведённая погрешность $\gamma_{пр}^{II}$	± 15

Таблица А.2 – Обязательные требования к характеристикам приборов, выпущенных после 30.08.2021

Нормируемый диапазон измерения, мг/л (‰)	Фактически определяемая величина	Допустимая (предельная) величина отклонения, ‰
I 0 – 0,5 (0 – 1,1)	Приведённая погрешность $\gamma_{пр}^I$	± 10
II свыше 0,5 – 0,990 (свыше 1,1 – 2,2)	Относительная погрешность $\sigma_{отн}^{II}$	± 10

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01са» № _____

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации ТФАГ 413422.001-03 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01са» № _____

заводской номер

прошел первичную поверку и допущен к применению в качестве средства измерения.

Государственный поверитель:

М. П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Свидетельство о поверке № _____

Межповерочный интервал прибора – 6 месяцев.

9.3 Если по результатам первичной поверки прибор признан непригодным к применению, выдадут заключение о непригодности по форме согласно приложению 3 [3] и (или) техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений.

Если по результатам последующей поверки прибор признан непригодным к применению, выдадут заключение о непригодности по форме согласно приложению 3 [3], свидетельство о предыдущей поверке прекращает своё действие, и знак поверки подлежит уничтожению путём приведения его в состояние, не пригодное для дальнейшего применения.

Прибор к применению не допускается.

$$Y - Y_0 = \frac{Y - Y_0}{Y_k} \cdot 100, \quad (2)$$

де Y – отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_0 -- отображаемое прибором для данной действующей парогазовой смеси номинальное значение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_k – верхнее значение (граница) нормируемого диапазона отображаемых прибором значений концентрации этанола в воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰).

Значения приведённой погрешности $\gamma'_{пр}$ для нормируемого диапазона I не должны превышать $\pm 10\%$.

8.3.5 Для приборов, выпущенных после 30.08.2021, относительную погрешность в нормируемом диапазоне II $\sigma_{\text{отн}}$, %, определяют по формуле

$$\sigma_{\text{отн}}^{\text{II}} = \frac{Y - Y_0}{Y_0} \cdot 100, \quad (3)$$

где Y – отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_0 – отображаемое прибором для данной воздействующей парогазовой смеси номинальное значение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰).

Значения относительной погрешности $\sigma_{\text{отн.}}$ для нормируемого диапазона $\parallel$ не должны превышать $\pm 10 \%$.

Примеры расчетов при обработке результатов измерений, полученных при определении метрологических характеристик приборов, выпущенных в разные периоды, приведены в приложении В.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки заносят в протокол, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б.

9.2 Если по результатам поверки прибор признан пригодным к применению, то на него и (или) в формуляр наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке по форме, установленной в приложении 2 [3] и (или) техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений.

[illegible]

13.1 Ограничения по транспортированию

13.1.1 Приборы в упаковке следует транспортировать только в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

13.1.2 Не допускается транспортирование в негерметизированных отсеках самолетов.

13.1.3 Условия транспортирования приборов в упаковке должны соответствовать условиям хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

При обработке сенсорного зонда не допускать попадания жидкости на газовый сенсор !

15.1.3 Кондиционирование газового сенсора после хранения прибора проводится тренировкой прибора во включенном состоянии в проветренном помещении до 6 часов. Как правило, восстановление эксплуатационных характеристик газового сенсора происходит за более короткое время. Признак готовности к работе – звуковой сигнал и появление сообщения типа:

20:27:33
ГОТОВ

15.1.4 Мундштуки индивидуального пользования могут использоваться повторно только после специальной обработки (дезинфекции) в соответствии с санитарными правилами (кипячение в течение 30 минут в дистиллированной воде с последующей сушкой и т. п.).

15.2 Учет технического обслуживания

[illegible]

Каждое последующее измерение (воздействие новой смеси) проводят только после полного восстановления газового сенсора в процессе работы в воздухе с установлением на индикаторе показаний 0,0 %.

Сравнивают соответствие показаний приборов в % и номинальных значений концентрации воздействующих паргазовых смесей с учётом погрешности приборов и коэффициента пересчёта (воздух – кровь) [1]

Прибор считают прошедшим опробование при соответствии всех показаний для указанных воздействующих смесей значениям, приведенным в таблице А.1 приложения А.

8.2.4 При опробовании приборов, выпущенных после 30.08.2021, для установления правильности их калибровки подают на газовый сенсор следующие паргазовые смеси: 0,090 мг/л паров этанола в воздухе (0,2 ‰); 0,180 мг/л (0,4 ‰); 0,540 мг/л (1,2 ‰); 0,990 мг/л (2,2 ‰). Фиксируют максимальные установившиеся в результате воздействия показания приборов в мг/л (‰).

Порядок действий – аналогичный изложенному в п.8.2.3.

Прибор считают прошедшим опробование при соответствии всех показаний для указанных воздействующих смесей значениям, приведенным в таблице А.2 приложения А.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Для приборов, выпущенных до 30.08.2021, определение приведенной погрешности $\gamma_{пр.}$ в диапазоне I и приведенной погрешности $\gamma_{пр.}^{II}$ в диапазоне II проводят последовательным воздействием на газовый сенсор прибора паргазовыми смесями. Концентрации смесей должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3 – Номинальные значения концентраций воздействующих парогазовых смесей для приборов, выпущенных до 30.08.2021

Нормируемый диапазон концентраций воздействующих смесей, мг/м ³ (‰)	Номер воздействующей смеси	Номинальное значение концентрации воздействующей смеси X ₀ , мг/м ³ , (номинальное значение, отображаемое прибором, Y ₀ , ‰)
I 0 – 225 (0,0 – 0,5)	1	45 (0,1)
	2	90 (0,2)
	3	225 (0,5)
II 270 – 900 (0,6 – 2,0)	4	270 (0,6)
	5	450 (1,0)
	6	900 (2,0)

Пропускание смесей осуществляют в следующей последовательности:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6.$$

Порядок выполняемых действий – согласно 8.2.3.

16 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

16.1 Технический контроль состояния прибора, в необходимых случаях его калибровка и (или) настройка производится при подготовке к предъявлению прибора в поверку уполномоченной технической службой согласно Приложения 3 формуляра.

16.2 Поверка прибора производится согласно действующих ТНПА и Методики поверки МРБ МП.367-2021 (Приложение 5) – один раз в шесть месяцев.

16.3 Для проверки технического состояния прибора и его настройки используется цифровой вольтметр класса 0,04 %, персональный компьютер любой модели. Для проверки прибора, кроме того, – генератор паров спирта GCBC-META-02M (или другие поверочные средства).

16.4 Приготовление спирто-воздушных смесей на используемых генераторах проводить по методике, приведённой в Приложении 4.

16.5 Учет выполнения работ. Фиксируются сведения о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей (комплектующих, покупных изделий).

Учет выполнения работ

[illegible]

16.6 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Фиксируются сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

7 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

7.1 Проверяют техническое состояние и выполняют подготовку к приговлению спирто-воздушных смесей используемого генератора спирто-воздушных смесей согласно его эксплуатационной документации [2].

7.2 Размещают у места поверки гигрометр психрометрический ВИТ-1.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемых приборов следующим требованиям:

8.1.1 Внешний вид должен соответствовать рисунку 1 [1].

8.1.2 Комплектность должна соответствовать разделу 5 [1].

8.2 Опробование

8.2.1 Включают приборы и проводят контроль функционирования согласно разделу 7 [1].

8.2.2 Выходят в режим "Поверка" согласно [1].

8.2.3 Для опробования приборов, выпущенных до 30.08.2021, используют парогазовые смеси: 225 мг/м³ паров этанола в воздухе (0,5 %); 450 мг/м³ (1,0 %); 900 мг/м³ (2,0 %).

Время воздействия (подачи) парогазовой смеси на чувствительный элемент прибора – 5 с.

Время фиксации показаний прибора:

- переводом правого переключателя прибора «Алкотон 01су» в положение СБРОС одновременно с началом подачи парогазовой смеси – 10 с;

– нажатием кнопки **ТЕСТ** прибора «Алкотон 01cm» одновременно с началом подачи парогазовой смеси – 10 с;

– нажатием кнопки ТЕСТ прибора «Алкотест 01са» одновременно с прекращением подачи парогазовой смеси – 10 с;

Смеси подаются на сенсорный зонд со вставленным мундштуком, который погружают рабочей частью в ячейку газовой магистральной (воздух, спирто-воздушные смеси) или в выходной патрубок используемого генератора спирто-воздушных смесей.

Подают смесь из генератора, показания поверяемого прибора фиксируют в протоколе, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б

Извлекают сенсорный зонд прибора из выходного патрубка генератора (ячейки газовой магистралли).

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие правила электробезопасности, инструкцию по технике безопасности при работе с легко воспламеняющимися жидкостями и ознакомившиеся с эксплуатационной документацией используемых средств поверки и поверяемых приборов.

4.2 Все работы необходимо проводить в проветриваемых (вентилируемых) помещениях. Наличие запахов не допускается.

4.3 Использование смеси утилизировать посредством вытяжки.

4.4 Место поверки должно быть удалено (защищено) от прямого воздействия источников теплового излучения и прямых потоков воздуха (сквозняки, вентиляторы).

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики
7	Гигрометр психрометрический ВИТ-1, скорость аспирации от 0,5 до 1,0 м/с
8.1	Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05
8.2, 8.3	Генератор ГСВС-META-02M [2]
Примечания	
1 Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью. 2 Все средства измерений должны иметь действующие клейма и (или) свидетельства о поверке.	

5 Требования к квалификации поверителей

К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих необходимую квалификацию в области обеспечения единства измерений.

6 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха (60 ± 15) %;
- атмосферное давление ($101,3 \pm 4$) кПа.

[illegible]

[illegible]

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	последующей поверке
1 Подготовка к поверке	7	+	+
2 Внешний осмотр	8.1	+	+
3 Опробование	8.2	+	+
4 Определение метрологических характеристик приборов	8.3	+	+
4.1 Определение приведённой погрешности $\gamma_{пр. II}$ в двух нормируемых диапазонах *	8.3.3	+	+
4.2 Определение приведённой погрешности, $\gamma_{пр}$ в нормируемом диапазоне I **	8.3.4	+	+
4.3 Определение относительной погрешности $\sigma_{отн. II}$ в нормируемом диапазоне II **	8.3.5	+	+
5 Оформление результатов поверки	9	+	+

* Для приборов, выпущенных до 30.08.2021.
 ** Для приборов, выпущенных после 30.08.2021.

Примечание – Если при проведении операций 2, 3, 4 получают отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают.

3 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

4 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности согласно ТКП 427, ГОСТ 12.1.005 и (или) технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации:

Методика поверки МРБ МП.367-2021

Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь

ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ
ВОЗДУХЕ «Алконт 01с», «Алконт 01см», «Алконт 01су», «Алконт 01са»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП.367-2021

Настоящая методика поверки (далее – МП) распространяется на приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Алконт 01с", "Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са" (далее – приборы), выпускаемые по [1], производства Общества с ограниченной ответственностью «Брестское техническое агентство» и устанавливает методы и средства поверки.

Приборы предназначены для измерения концентрации паров этанола в воздухе, выдыхаемом человеком.

Обязательные метрологические требования к приборам приведены в приложении А.

1 Нормативные ссылки

В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Примечание – При использовании настоящей МП целесообразно проверить действие ссылочных ТНПА на официальном сайте Национального фонда ТНПА в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при применении настоящей МП следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Операции поверки

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

16.9 Сведения о рекламациях.

Внешнее проявление неисправности	Дата и номер рекламационного акта	Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации	Примечание

17 ХРАНЕНИЕ

17.1 Условия транспортирования и хранения приборов в упаковке должны соответствовать условиям хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

17.2 Сведения о хранении.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
приемки на хранение	снятия с хранения			

18 РЕМОНТ

18.1 Краткие записи о произведенном ремонте.

«Алконт 01са»
наименование изделия

№
заводской номер

предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта
параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

Сведения о произведенном ремонте

вид ремонта и

краткие сведения о ремонте

18.2 Данные приемо-сдаточных испытаний после ремонта.

18.3 Свидетельство о приемке и гарантии.

«Алконт 01са»
наименование изделия

№
заводской номер

вид ремонта

согласно

наименование предприятия

вид документа

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____ в течение срока
параметр определяющий ресурс
службы _____ лет, в том числе срок хранения _____
при условиях хранения

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

М. П. _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____ год, месяц, число

Приложение 1 Соотношение плотности спирта-ректификата и его массовой концентрации.

Концентрация спир-та-ректификата, %	96	95	94	93	92	91
Плотность, г/см ³	0,8013	0,8042	0,8070	0,8098	0,8126	0,8153

Приложение 2 Объемы первичного раствора, необходимые для пригото-вления рабочих растворов, обеспечивающих получение не-которых концентраций этанола в спирто-воздушной смеси (рассчитаны относительно концентрации спирта-ректификата 96%) на генераторе ГС-1.

Концентрация этанола в смеси, мг/м ³	90	180	495	540	990
Объём первичного рас-твора, мл	5,0	10,0	27,6	30,1	55,2

Приложение 3 Объемы первичного раствора (96 % этанола), необходимые для приготовления рабочих растворов, обеспечивающих получение некоторых концентраций этанола в спирто-воздушной смеси (рассчитаны относительно concentra-ции спирта-ректификата 96%) на генераторе ГСВС-МЕТА-02М.

C ₀ ^{ГС} , мг/м ³	90	180	495	540	990
C ₀ ^Р , мг/мл	0,232	0,463	1,274	1,390	2,547
V, мл 96 % этанола в 1 л рас-твора	0,30	0,60	1,66	1,81	3,31

2.3.9 Генератор готов к работе.

2.3.10 Общее время сохранности раствора в колбе с притертой пробкой и в стакане генератора ГС-1 после приготовления раствора должно быть не более 1 суток.

2.4 Для приготовления водно-спиртовых растворов на генераторе ГСВС-META-02M необходимо:

2.4.1 При наличии – использовать государственные стандартные образцы (ГСО) состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГС08789-2006) с паспортами.

2.4.2 При необходимости приготовления на генераторе газовой смеси (ГС) с номинальным значением массовой концентрации этанола $C_0^{ГС}$, мг/м³, требуемое содержание этанола в водном растворе рассчитывается по формуле:

$$C_0^P = \frac{C_0^{ГС}}{388,66}, \text{ где}$$

C_0^P – номинальное значение массовой концентрации этанола в приготавливаемом (используемом в случае применения ГСО состава водного раствора этанола) растворе, мг/мл.

2.4.3 Используя данные Приложения 1 и рассчитанные значения содержания спирта-ректификата (мл) в 1000 мл рабочего раствора для получения ГС с заданной массовой концентрацией этанола (мг/м³) (Приложение 3), приготовить необходимые растворы (см. п. 2.2.5.6).

2.4.4 При использовании готовых ГСО, как и при приготовлении необходимых рабочих растворов, соблюдать все рекомендации руководства по эксплуатации генератора спирто-воздушных смесей ГСВС-META-02M.

2.2.2 При помощи ареометра определить плотность этилового спирта.

2.2.3 На основании полученного результата, используя приведенный в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации генератора ГС-1" график или справочные таблицы, определить массовую концентрацию этилового спирта (%).

2.2.4 Приготовить первичный водно-спиртовой раствор.

2.2.4.1 Мерную колбу на 100 мл заполнить на 2/3 дистиллированной водой.

2.2.4.2 Отобрать пипеткой 10 мл этилового спирта и добавить его в колбу.

2.2.4.3 Довести объем раствора в колбе дистиллированной водой до марки, закрыть колбу, тщательно перемешать раствор.

2.2.5 Приготовить рабочий водно-спиртовой раствор.

2.2.5.1 Определить массовую концентрацию спирта в водно-спиртовом растворе по формуле:

$$C_S = C_g / K \quad (1), \text{ где}$$

C_S - массовая концентрация спирта в водно-спиртовом растворе, г/л;

C_g - требуемая концентрация спирта в спирто-воздушной смеси, мг/м³;

K - коэффициент распределения этилового спирта, $K=233\pm 8$.

2.2.5.2 Определить требуемый объем первичного раствора по формуле:

$$V_1 = \frac{V_2 \times C_S \times A \times 100}{\rho \times C_E} \quad (2), \text{ где}$$

V_1 - требуемый объем первичного раствора, мл;

V_2 - объем рабочего раствора, л;

C_S - аналогично формуле (1);

A - кратность разбавления при получении первичного раствора;

ρ - плотность спирта-ректификата, измеренная ареометром с точностью до третьего знака после запятой, г/см³;

C_E - концентрация спирта-ректификата, %.

2.2.5.3 При необходимости дозирования спирта и исходного раствора пипетки с одной меткой пипетку подбирать вместимостью, близкой к объему, рассчитанному по формуле (2).

2.2.5.4 Расчет концентрации спирто-воздушной смеси производить по формулам (3), (4):

$$C_g = K \times C_S \quad (3),$$

№ приложения	Наименование приложения	Местонахождение приложения
1	Методика освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01са"	стр. 30
2	Памятка пользователю для организации работы комплекса «"Алконт 01са" – персональный компьютер»	стр. 33
3	Методика технического контроля, калибровки и настройки прибора "Алконт 01са"	стр. 36
4	Методика приготовления спирто-воздушных смесей на генераторах ГС-1 и ГСВС-META-02M	стр. 39
5	Методика поверки МРБ МП.367-2021	стр. 44
6	Методические указания по диагностике алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств (специализированных приборов определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с»)	стр. 58

МЕТОДИКА

освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01са"

1 Физиологические основы выявления факта употребления алкоголя по результатам исследования выдыхаемого воздуха.

При употреблении спиртных напитков алкоголь проникает путем диффузии через стенки желудка и кишечника в кровяное русло в практически неизменном виде (этилового спирта). С кровью, оттекающей от желудочно-кишечного тракта, он попадает в печень, далее в правые отделы сердца, сосуды легких, левые отделы сердца и, наконец, с артериальной кровью разносится по всем органам и тканям и распределяется в них пропорционально содержанию в тканях воды.

В выдыхаемый воздух алкоголь проникает по крови, диффундируя через стенки альвеол. Соотношение концентрации алкоголя в крови и альвеолярном воздухе постоянно и определяется разностью плотностей сред: крови и воздуха, и составляет при колебаниях от 1:1300 до 1:3000 в среднем 1:2200. Это означает, что в 2200 см³ альвеолярного воздуха содержится такое же количество алкоголя, как и в 1 см³ (миллилитре) крови.*

Содержание паров алкоголя (этанола) в выдыхаемом воздухе выражается в миллиграммах на 1 м³ (мг/м³) и с учетом отношения плотностей крови и воздуха может быть оценочно выражено в промиллях по крови, миллиграммах алкоголя в 1 миллилитре крови (‰, мг/мл, ppt) то же, что ‰ BAC (Blood alcohol concentration). При этом 0,1 ‰ алкоголя в крови соответствует примерно 45 мг/м³ (0,045 мг/л) алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как правило, в выдыхаемом воздухе в небольших количествах могут находиться и некоторые органические, так называемые редуцирующие вещества, такие как ацетон, альдегиды и др., которые так же, как и алкоголь, могут влиять на показания прибора.

Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, крови или другой биологической среде организма не позволяет окончательно судить о степени опьянения человека. Это связано с неодинаковой реакцией одного человека на одни и те же дозы алкоголя, а также фазой алкогольной интоксикации. Однако, выявление в биологических средах организма содержания алкоголя, превышающего эндогенный уровень, свидетельствует о факте употребления спиртных напитков.

Факт употребления алкогольных напитков (состояние алкогольного опьянения) фиксируется с помощью прибора "Алконт 01са" при установлении показаний прибора от 0,4 ‰ (включительно) и выше с учетом его погрешности (см. метрологические характеристики прибора).

При использовании данного прибора, как и всех прочих технических средств контроля, следует помнить:

- показания технических средств контроля на факт употребления алкогольных напитков являются дополнительным методом, помогающим специа-

МЕТОДИКА

приготовления спирто-воздушных смесей на генераторах ГС-1 и ГСВС-META-02M

1 Назначение

1.1 Методика предназначена для приготовления увлажнённых спирто-воздушных смесей, используемых для поверки приборов "Алконт 01с" ("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са") и калибровки газовых сенсоров на стадии изготовления приборов.

1.2 Методика позволяет получить из одной порции водно-спиртового раствора до 35 литров спирто-воздушной смеси заданного состава с массовыми концентрациями в диапазоне от 45 до 990 мг/м³ при температуре раствора (26 ± 0,2) °С – на генераторе ГС-1, до 40 литров смеси с аналогичными концентрациями при температуре раствора (34 ± 0,2) °С и относительной влажности газовой смеси не менее 95 % – на генераторе ГСВС-META-02M.

2 Подготовка водно-спиртовых растворов

2.1 Для приготовления водно-спиртовых растворов необходимы:

- 2.1.1 Ареометр без шара АОН-1 N8 ГОСТ 18481-81 (диапазон измерения 0,790 - 0,810 г/см³).
- 2.1.2 Пипетка мерная емкостью 1 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.
- 2.1.3 Пипетка мерная емкостью 5 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.
- 2.1.4 Пипетка мерная емкостью 10 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.
- 2.1.5 Колба мерная емкостью 100 мл, 2-100-2, ГОСТ 1770-74.
- 2.1.6 Колба мерная емкостью 1000 мл, 2-1000-2, ГОСТ 1770-74.
- 2.1.7 Термометр лабораторный с ценой деления 0,1°С ГОСТ 28498-90.
- 2.1.8 Генератор ГС-1 ТУ 25-7557.002-86 или генератор ГСВС-META-02M ТУ 4381-043-21298618-2009.
- 2.1.9 Спирт этиловый (ректификат, высший сорт) ГОСТ 5962-67 или ГОСТ 18300-72.
- 2.1.10 Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72.

Примечание. Допускается использование других приборов и оборудования, метрологические характеристики которых не отличаются от приведенных.

2.2 Для приготовления водно-спиртовых растворов на генераторе ГС-1 необходимо:

2.2.1 Определить температуру этилового спирта и воды. Температура должна составлять (20±0,1) °С. При отклонении температуры жидкостей от указанной необходимо их охладить (подогреть).

4 Закрытые режимы работы прибора "Алконт 01са"

4.1 Закрытые (защищенные от несанкционированного доступа) режимы работы позволяют изменять базы данных, на основании которых система прибора производит измерения, пересчет и отображение результатов измерений по всем измерительным каналам, обработку и накопление результатов измерений и значений технологических параметров в энергонезависимой памяти прибора.

4.2 В исполнении "Алконт 01са" работа в закрытых режимах реализуется только с помощью персонального компьютера любой модели (см. Приложение 2 формуляра).

4.3 Вход в соответствующий режим работы программы "Alsa.exe" защищен от несанкционированного доступа шестизначным паролем и доступен только уполномоченным ремонтным службам.

листу ориентироваться в состоянии испытуемого;

- окончательное заключение о степени алкогольного опьянения принимает только эксперт-нарколог, учитывающий разнообразие реакций на алкоголь у отдельных лиц, наличие клинических синдромов опьянения.

2 Факторы, влияющие на точность освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01са".

При исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь нередко допускаются ошибки. Чаще всего они обусловлены неточным выполнением методики исследования (см. ниже). Кроме того, имеется ряд обстоятельств объективного характера, способных существенно влиять на конечный результат.

2.1 Ошибочный результат исследования может быть получен за счет небольших количеств алкоголя, адсорбированного на слизистой оболочке рта и глотки при употреблении непосредственно перед исследованием спиртосодержащих лекарств. Так, при употреблении небольших количеств подобных препаратов адсорбированный алкоголь выделяется с выдыхаемым воздухом в течение 10 - 20 минут в значительных количествах. Это же относится к непосредственному употреблению алкогольных напитков. В целях повышения точности измерений, необходимо, чтобы с момента последнего приема алкоголя прошло не менее 20 минут.

2.2 Ошибка может быть обусловлена наличием в полости рта либо в окружающем воздухе примесей редуцирующих веществ. Например, наличие в окружающем воздухе значительных концентраций ацетона, бензина, ряда растворителей, выхлопных газов может воздействовать на чувствительный элемент сенсора и искажать результаты исследования. В течение 3 - 5 минут после курения на результаты пробы могут оказывать влияние выделяющиеся из дыхательных путей летучие соединения углерода.

2.3 Для получения воздуха из глубины легких испытуемый должен выдуть определенное минимальное количество воздуха. Только в этом случае полученные результаты совпадут с результатом анализа крови на алкоголь. На практике установлено, что минимальный объем анализируемого выдыхаемого воздуха должен составлять не менее 1,2 литров. При слишком слабом, коротком или прерывистом поступлении воздуха, исследование должно быть проведено повторно. Следует учитывать, что задержка дыхания на входе в течение 20 секунд может давать увеличение показаний до 50% от содержания алкоголя, определяемого на фоне спокойного дыхания. После гипервентиляции и при учащенном поверхностном дыхании показания могут уменьшаться до 12%.

3 Порядок работы с прибором "Алконт 01са" при исследовании выдыхаемого испытуемым воздуха

3.1 Помещение, в котором проводятся исследования, должно быть проветрено, посторонние запахи органических веществ (растворителей и т.п.)

должны отсутствовать (см. п. 2.2).

3.2 Оператор включает прибор согласно формуляру изделия и приводит его в режим готовности.

3.3 Испытуемый опрашивается об употреблении перед исследованием спиртосодержащих лекарств, курении. Необходимо, чтобы от момента курения до исследования прошло не менее пяти минут, с момента последнего приема спиртосодержащих жидкостей – не менее двадцати минут.

3.4 В зависимости от конкретных обстоятельств и состояния испытуемого эксперт (оператор) принимает решение по проведению теста, инструктирует обследуемого и устанавливает готовность прибора к выполнению теста.

3.5 Исследование проводить в положении испытуемого сидя, на фоне спокойного дыхания.

3.6 У лиц, страдающих сахарным диабетом, «ацетоновое» дыхание может вызвать ложные показания приборов.

3.7 Это же необходимо учитывать при обследовании лиц, находящихся в состоянии продолжительного голодания (как правило, свыше 7 дней).

4 Порядок проведения теста

4.1 Испытуемый извлекает (получает) стерильный сменный мундштук индивидуального пользования из упаковки, стыкует его короткой частью с сенсорным зондом.

4.2 Получив указание оператора, установившего готовность к тесту, обследуемый, зажав мундштук губами и удерживая зонд любой рукой, делает через него один полный плавный продолжительный выдох (см. п. 8.3). После завершения выдоха освободить губы от мундштука и продолжать обычное дыхание. Конечный результат фиксируется на дисплее прибора с выдачей звукового сигнала.

4.3 При неправильных действиях испытуемого тест следует повторить.

4.4 После окончания теста мундштук отделяется от сенсорного зонда. Снятый сменный мундштук после разового использования подлежит дезинфекции. Дезинфекцию производить кипячением в дистиллированной воде не менее тридцати минут с последующей сушкой или другим способом в соответствии с санитарными правилами по осуществлению дезинфекционной деятельности (Приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 25.11.2002 г. № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждений здравоохранения», приложение 3 (Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения»).

Ещё одно кратковременное нажатие кнопки <TEST> вызывает сообщение вида:

КОНТРОЛЬ
ГАЗ.СЕН.

0 мг/л
4955 мВ

Кратковременное нажатие кнопки <↔> вызовет сообщение типа:

которое отражает текущие показания падения напряжения на чувствительном элементе газового сенсора в милливольтх и соответствующие им значения измеряемой величины в мг/л.

3.1.2 Критерии контроля:

– после часа работы в проветренном помещении реальные показания прибора должны быть близки к табличному значению падения напряжения для концентрации 0 мг/л ("чистый воздух");

– динамичное уменьшение показаний падения напряжения (рост показаний в %) при поднесении сенсорного зонда к источнику паров этилового спирта и их динамичное восстановление при последующей вентиляции (кондиционировании) – свидетельствуют о сохранении сенсором эксплуатационных свойств;

– восстановление реальных показаний падения напряжения, близких к табличному значению для 0 мг/л может служить критерием оценки восстановления эксплуатационных характеристик газового сенсора при проведении его кондиционирования после длительного хранения прибора.

3.2 Настройка точности хода часов-календаря реального времени в ручном режиме.

Включить прибор аналогично п. 3.1.1. Перебрав меню нажатиями кнопки <↔>, выбрать пункт «установ. часов» и нажать кнопку <TEST>.

Появится возможность выбора в меню из шести пунктов: «установ. часы», «установ. мин», «установ. сек», «установ. дата», «установ. месяц», «установ. год».

Перебор в меню осуществляется нажатием кнопки <↔>, выбор нужного пункта – кнопкой <TEST>.

Каждый из пунктов позволяет изменить двузначное значение. Доступная изменению десятичная цифра мигает. Изменение цифры производится нажатием на кнопку <TEST>; переход к следующей цифре – нажатием на кнопку <↔>. Нажатие на кнопку <↔> при мигании младшей цифры приводит к завершению редактирования и выходу в меню.

МЕТОДИКА

технического контроля, калибровки и настройки прибора «Алконт 01са»

1 Условия проведения *технического контроля, калибровки и настройки.*

Технический контроль, калибровку и настройку производить при следующих нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность (60 ± 15) %;
- атмосферное давление ($101,3 \pm 4$) кПа;
- напряжение питания:
- переменного тока - 230 В (+6 % -10%), (50 ± 1) Гц;
- постоянного тока - ($12,6 \pm 2$) В.

Работы должны проводиться в проветренном (вентилируемом) помещении.

2 Подготовка к проведению работ.

- 2.1 Перед проведением работ ознакомиться с настоящим ФОРМУЛЯРОМ.
- 2.2 Перед началом работ рекомендуется включить прибор и выдержать его в рабочем состоянии не менее 1 часа.
- 2.3 Для достижения полноты диагностической картины, расширения функций контроля подключить прибор к персональному компьютеру, используя рекомендацию Приложения 2 формуляра.

3 Технический контроль состояния системы прибора "Алконт 01са".

Контроль состояния системы, возможные неисправности и способы их устранения достаточно подробно освещены в разделе 9 настоящего формуляра. Ниже пойдет речь о специальных режимах работы прибора, о которых в разделе 9 упоминалось в сжатом виде.

3.1 Контроль состояния газового сенсора.

3.1.1 Включить прибор. Нажать и удерживать кнопку  более двух секунд. Появится сообщение

ТЕСТЫ
БЛОКА

ПАМЯТКА

пользователю для организации работы комплекса «Алконт 01са» – персональный компьютер»

Работа комплекса может быть организована с персональным компьютером (далее – ПК) любой модели и, соответственно, печатающим устройством, работающим с избранным компьютером. Инициировать связь между прибором и персональным компьютером можно в любой момент, находясь в основном режиме работы изделия во включенном состоянии.

Подготовка работы (коммутация) комплекса «Алконт 01са» – персональный компьютер» должна проводиться только с включенными прибором и персональным компьютером (печатающим устройством).

- 1 Соединить шнур связи мини-USB с разъемом "ПК" прибора, шнур подключить к разьему USB компьютера.
- 2 Подключение принтера к компьютеру провести в соответствии с руководством по эксплуатации печатающего устройства.
- 3 Включить ПК и загрузить рабочую операционную систему MS Windows, руководствуясь соответствующими эксплуатационными документами.
- 4 Загрузить программу "Alsa.exe" на сайте www.alcont.brest.by, используя средства рабочей операционной системы. Использовать подсказки на дисплее компьютера.
- 5 Включить прибор "Алконт 01са".
- 6 Пользуясь меню программы «Alsa.exe», выбрать на мониторе компьютера необходимый пункт и нажать клавишу <Enter> для его выполнения.
- 7 Программа "Alsa.exe" после загрузки пытается работать с последовательным портом номер 3 (COM3), поэтому, может появиться сообщение "Ошибка инициализации" и предложено меню из двух пунктов: "COM1" и "COM2". Необходимо указать номер того порта, к которому реально подключен прибор.
- 8 Режим работы №6 «Наладка» программы "Alsa.exe", который дает доступ к изменению базы данных (калибровки прибора), защищен от несанкционированного доступа шестизначным паролем (см. Приложение 3 формуляра).
- 9 Все режимы работы программы "Alsa.exe", работающие с принтером, позволяют записать файлы с информацией на диск для последующей корректировки и печати с использованием любого текстового редактора.

10 Установка характеристик хода часов-календаря осуществляется с помощью компьютера в режиме работы №1 «Контроль хода часов» программы "Alca.exe".

11 Отключение шнура связи с ПК (раскоммутацию) производить только от выключенных устройств!

12 Работа комплекса позволяет реализовать списочный контроль персонала с запоминанием сведений: «Ф. И. О. – результат измерения – дата измерения». Память прибора поддерживает занесение с помощью компьютера до восьми списков из (до) шестидесяти четырёх фамилий (т. е. контроль до 512 человек персонала), с последующим контролем и сохранением в памяти 9000 результатов последних измерений.

13 Организация персонализированного учёта.

Прибор "Алконт 01са" позволяет вести персонализированный учет результатов тестирования. Для этого в энергонезависимой памяти прибора хранятся 8 списков по 64 строки. Каждая из строк и название списка не должны превышать 16 символов.

По умолчанию названия списков следующие: «1 список фамилий» ... «8 список фамилий», а в каждом из списков строки: «01 номер в списке» ... «64 номер в списке».

Списки можно редактировать на персональном компьютере. Для этого в программе поддержки прибора следует выбрать кнопку «списки тестируемых». Во встроенном редакторе можно ввести любые текстовые строки (до 16 символов длиной) в качестве названий списков или позиций в списке. Рекомендуются в качестве названий списков ввести сокращения (до 16 символов) от наименований подразделений, а каждый из списков заполнить фамилиями и именами сотрудников. Подготовленные данные сохраняются на диске персонального компьютера и могут быть перенесены в память прибора (для этого служит кнопка «передать»). Существует возможность считывания из памяти прибора упомянутых списков (для этого служит кнопка «принять»).


Использование персонализированного учета требует следующих действий:

- при переводе прибора из режима ожидания в режим готовности необходимо удерживать кнопку <TEST> не менее секунды в нажатом состоянии;
- появится возможность выбора в меню, состоящего из следующих пунктов: «Анонимный тест», «1 список фамилий» и т. д.; переход между пунктами меню производится нажатием на кнопку включения подсветки, а выбор – нажатием на кнопку <TEST>;
- после выбора нужного списка необходимо аналогично произвести выбор в списке;
- после завершения выбора появится сообщение «ожидание выдоха».

Считывание результатов тестирования производится при помощи программы поддержки выбором кнопки «результаты тестов». Каждый тест снабжается названием списка и фамилией из списка (или надписью «аноним»), если не использовался персонализированный учет).

Литература:

- Инструкция «О порядке направления водителей транспортных средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования», утв. МВД, Минздравом, Минюстом Республики Беларусь, введ. в действие с 01.07.94 г.
- Положение о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.
Утверждено Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 апреля 2011 г. № 497.
3. Методические указания по диагностике алкогольного опьянения. Приложение №3 к приказу по МЗ СССР №523 от 22.11.54 г.
4. Острые отравления. Диагноз. Лечение. Медицинское издательство. Бухарест, 1984 г.
5. Инструкция по применению прибора для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе ППС-1 и генератора контрольных смесей ГС-1 (Ра 2.840.112ДII). Рекомендована комиссией по приборам и аппаратам, применяемым для исследования газообмена, газоанализа и газов в крови, Комитетом по новой медицинской технике Управления по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники – протокол №5 от 20.12.83 г. Утверждена 12.06.84 г.
6. Рекламные материалы фирмы Figaro Engineering Inc., Япония, префектура Осака, г. Миноо.
7. Если вы за рулем: Медицинские аспекты безопасности дорожного движения. – Мн.: Полымя. 1989.

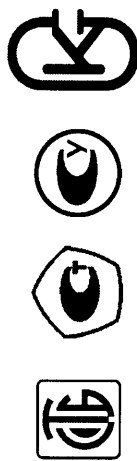

Прибор специализированный определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе

«АЛКОНТ 01су»

ФОРМУЛЯР

ТФАГ 413422.001-02 ФО



Содержание

1 Общие указания.....	3
2 Основные сведения об изделии.....	4
3 Основные технические данные.....	5
4 Индивидуальные особенности изделия.....	8
5 Комплектность.....	9
6 Указания мер безопасности.....	9
7 Подготовка к работе.....	10
8 Порядки работы при освидетельствовании.....	11
9 Контроль состояния системы. Возможные неисправности и способы их устранения.....	13
10 Ресурсы, сроки службы и хранения; гарантии изготовителя.....	15
11 Свидетельство об упаковке.....	16
12 Свидетельство о приемке.....	17
13 Движение изделия при эксплуатации.....	18
14 Учет работы изделия.....	19
15 Учет технического обслуживания.....	19
16 Работы при эксплуатации.....	21
17 Хранение.....	24
18 Ремонт.....	25
19 Особые отметки.....	26
20 Контроль состояния изделия и ведения формуляра.....	26
21 Перечень приложений.....	27

Адрес изготовителя, обслуживание, поверка, ремонт:

ООО «Брестское техническое агентство»

224022, Республика Беларусь, г. Брест, ул. Суворова, 112

тел./ факс: (8-0162) 52-56-58, (8-0162) 93-53-83, (8-017) 270-19-06

e-mail: microt@brest.by, <https://www.alcont.brest.by/>

По итогам проведения освидетельствования должностным лицом в протоколе процессуального действия, врачом – в акте освидетельствования отражается одно из следующих заключений:

1. Состояние на момент освидетельствования:
 - отсутствует состояние алкогольного опьянения и (или) состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;
 - состояние алкогольного опьянения;
 - состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ;
 - состояние алкогольного опьянения и состояние, вызванное потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ.
2. Отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования.

Основным нормативным документом, определяющим отношение водителей к алкоголю, являются Правила дорожного движения, которые "запрещают управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения". Таким образом, ограничено трактуется важнейшее требование к психофизиологическому состоянию водителя, т. е. без учета воздействия на способность к вождению малых субклинических доз алкоголя (можно быть "нетрезвым", но "не пьяным"!; можно ли быть трезвым в состоянии похмелья?).

Пока же, Правила дорожного движения запрещают управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а нормативные документы органов здравоохранения уточняют и определяют границы опьянения, которое начнется с 0,3 промилле (‰) алкоголя в крови (150 мкг/л в выдыхаемом воздухе) [2].

Водитель, выпивший рюмку водки, стакан вина, бокал пива, может быть официально признан трезвым при условии – концентрация алкоголя в крови не должна составлять и превышать 0,3 ‰ (150 мкг/л).


В европейских и североамериканских странах дело обстоит несколько иначе, что можно проследить по нижеприведенным данным, взятым из журнала "NEWSWEEK".

Спиртные напитки, выпитые в течение одного часа (1 доза)*	Разрешенный предел для водителя, ‰ (мг/мл)	Страна	Вероятное состояние	Вероятность несчастных случаев со смертельным исходом
☹☹	0,2	Швеция	Легкое чувство теплоты и расслабления. Внимание может быть рассеянным.	Повышается в 1,2 раза
☹☹☹	0,5	Бельгия, Финляндия, Франция, Греция, Нидерланды, Норвегия, Португалия	Замедление реакций, затруднения при принятии оптимальных решений	Повышается в 4 раза
☹☹☹☹	0,8	Австрия, Британия, Канада, Дания, Германия, Ирландия, ряд штатов США	Нарушение общей координации. Контроль за скоростью и управление затруднены.	Повышается в 10 раз
☹☹☹☹☹	1,0	Большинство штатов США	Заторможенность реакций делает даже нормальные условия дорожного движения опасными.	Повышается в 20 раз

* 1 доза включает в себя либо 1,5 унции ликера (44,4 мл), либо 4 унции вина (118,3 мл), либо 12 унций пива (355 мл).
** Приведено содержание алкоголя в крови для мужчины весом 170 фунтов (77 кг). Содержание алкоголя в крови для лиц с меньшей массой тела может быть выше, а с большей массой тела – ниже, чем приведенные в таблице.

В отечественной медицинской практике при диагностике степени опьянения в зависимости от концентрации алкоголя в крови используются следующие нормативы:

- менее 0,3 промилле - влияние алкоголя отсутствует;
- от 0,3 до 0,5 промилле - незначительное влияние алкоголя;
- от 0,5 до 1,5 промилле - легкое опьянение;
- от 1,5 до 2,5 промилле - опьянение средней степени;
- от 2,5 до 3 промилле - сильное опьянение.

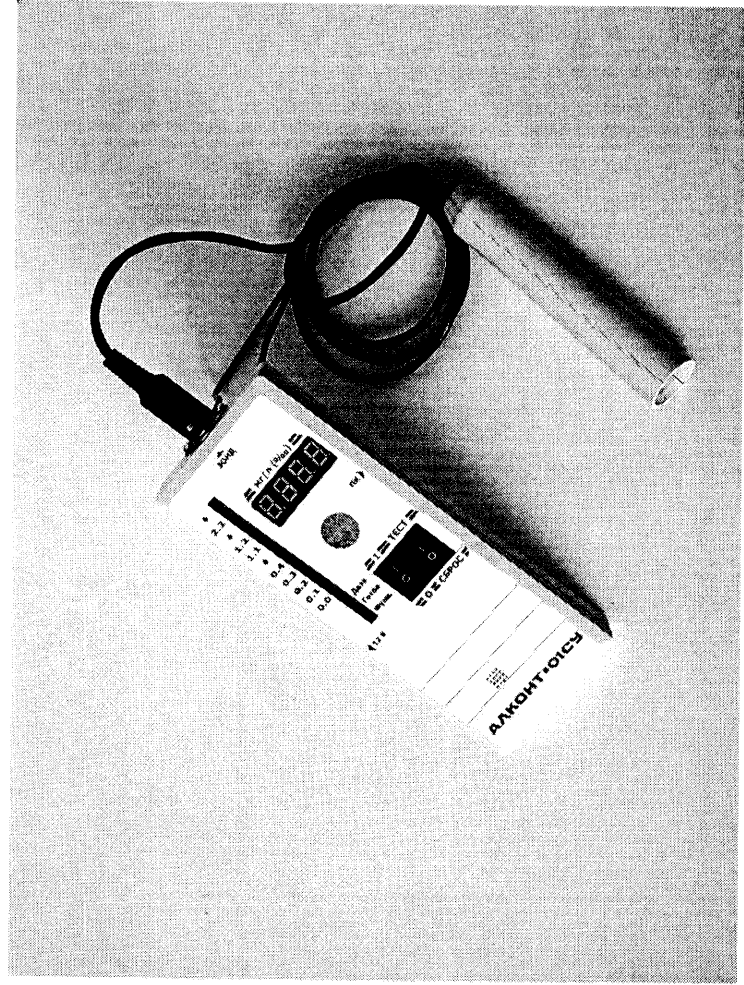

1 Общие указания

Настоящий формуляр предназначен для ознакомления обслуживающего персонала (пользователей) с устройством, принципом работы, техническими данными, правилами эксплуатации и технического обслуживания специализированного прибора определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01су» (в дальнейшем – прибор).

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с формуляром изделия.

Формуляр должен постоянно находиться с прибором.

При записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо, после подписи проставляются фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

При передаче прибора на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

2 Основные сведения об изделии

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01су» изготовлен в _____ 202_ г.

Заводской номер изделия _____

Сертификат об утверждении типа средств измерений (РБ) № 14513 от 1 ноября 2021 г. зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 25 0559 16 и допущен к применению в Республике Беларусь с 9 декабря 1997 года. Срок действия до 1 ноября 2026 г.

Сертификат об утверждении типа средств измерений (РФ): ВУ.С.31.999.А № 7803 от 22 апреля 2000 г. № Государственного реестра средств измерений: 19513-00

Свидетельство о признании утверждения типа средств измерительной техники (Украина) № UA-MI/3-649-2012 выдано 29 августа 2012 г.

Сертификат № 1162 о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан). Зарегистрирован в Реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 09.02.2022 г. за № KZ.02.03.00846-2022/14513. Действителен до 01.11.2026 г.

Декларация о соответствии Евразийского Экономического Союза Рег. № ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 02588 от 29.09.2021. Срок действия до 13 сентября 2026 г. включительно.

Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015 зарегистрирован в реестре Национальной Системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 11 февраля 2022 г. № ВУ/112 05.01.003.01 00311. Действителен до 10 февраля 2025 г.

Сертификат соответствия менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 зарегистрирован в реестре Национальной Системы подтверждения соответствия Республики Беларусь 11 февраля 2022 г. № ВУ/112 05.06.003.01 00312. Действителен до 10 февраля 2025 г.

2.1 Прибор предназначен для определения концентрации паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

Как правило, используется в качестве детектора присутствия алкоголя в выдыхаемом воздухе.

2.2 Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, с верхним значением рабочей температуры 35 °С, с нижним значением рабочей температуры 10 °С.

2.3 Прибор соответствует группе 2 по ГОСТ 20790-93 с возможностью работы вне печебных учреждений в служебных помещениях, в салонах ав-

человека оказывается максимальной через 1-2 часа после приема алкоголя, и зависит не только от количества алкоголя, но и от индивидуальных особенностей организма.

Количество выпитого алкогольного напитка и степень опьянения (для человека весом 60 кг) [6]

Количество алкогольного напитка*				Концентрация алкоголя в крови, мг/мл (%)	Состояние
сухое вино (9% об. спирта) стакан, 0,1 л	пиво (4% об. спирта) бутылка 0,5 л	саке (19% об. спирта) бокал, 0,18 л	виски (55% об. спирта) стопка, 0,04 л		
1,5 - 3	0,5 - 1	0,5 - 1	1 - 2	0,2 - 0,4	Появление чувства усталости, покраснение лица
3 - 6	2	1 - 2	2 - 5	0,5 - 1	Легкое опьянение, болтливость, замедление действий
6 - 9	3	3	6 - 7	1,1 - 1,5	Отмечается пошатывание, явление непонимания конечностей
15 - 20	5 - 7	5 - 7	10 - 15	> 1,6	Сильное опьянение, нечленораздельная речь, шатающаяся походка, возможны приступы тошноты

Примечание: * Возможны различия в зависимости от емкости посуды и крепости алкогольного напитка.

Принимая во внимание все сказанное, имеющее отношение не только к крови, но и к другим биологическим средам организма человека, можно, исходя из них, установить ретроспективно не только факт употребления алкоголя, но и его приблизительное количество.

Приложением [2] узаконено в Республике Беларусь состояние алкогольного опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в крови в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха.

переходит от чрезмерно веселого настроения к приступам ярости, проявляет дезориентацию, спутанность, психические нарушения, ведущие к агрессивному поведению (противоправным действиям, несчастным случаям и т.д.). Нередко у отравившегося появляется рвота в результате острого спиртового гастрита.

Последняя фаза, в клиническом плане, **соответствует спиртовой коме (глубокая степень опьянения)**, концентрация спирта в крови составляет 4,0-5,5 ‰ [3] (**превышает 2,5 ‰** [4]). В принципе спиртовая кома протекает спокойно, сопровождается признаками анестезии в связи со снотворным действием алкоголя. Костносухожильные рефлексы выпадают, зрачки нормальные или расширенные. В редких случаях появляются приступы судорог. Кома, вызванная потреблением сублетальной дозы спирта, продолжается 6-12 часов.

Глубокая спиртовая кома, наступающая после потребления летальной дозы спирта, затягивается и протекает со смертельным исходом за счет недостаточности дыхания или кровообращения.

По данным источника [3], концентрация алкоголя в крови выше 8,0 ‰ (10 мл спирта на 1 л крови) почти никогда не наблюдается у человека.

Констатируя в крови живого человека определенную концентрацию алкоголя, можно судить и о количестве выпитого им, принимая во внимание следующие обстоятельства:

1. Время, прошедшее от момента приема алкоголя до момента исследования. При этом надо учесть, что в организме человека перерабатывается за 1 час в среднем 7-10 см³ чистого алкоголя (5,5-8,0 г спирта) или 18-25 см³ 40° водки. Преобразование алкоголя в организме хронического алкоголика происходит обычно быстрее (но не более чем на 1/3). В вечерние часы алкоголь расщепляется в среднем на 25% быстрее, чем в утренние.
2. Концентрацию принятого испытуемым алкогольного напитка. Известно, что более крепкие напитки дают более высокую и быструю максимальную концентрацию алкоголя в организме, и наоборот.
3. Условия приема алкоголя. В одних случаях он может быть введен едино- временно (или быстро следующими одна за одной порциями), в других случаях, наоборот, медленно, малыми порциями. Естественно, что в первом случае, имеющем большое судебно-экспертное значение, концентрация алкоголя в крови окажется более высокой и картина опьянения - более резкой. То же произойдет, если алкоголь принят на пустой желудок; прием же пищи до введения алкоголя ведет к более медленному всасыванию последнего и более мягкой картине опьянения (хотя и более длительного).

Значение диуреза для выведения алкоголя из организма обычно невелико: так, в первые часы выделяется всего 1-2 % введенного алкоголя. Однако, введение, наряду с алкоголем большого количества воды, а также мочегонных средств дает понижение максимальной концентрации алкоголя в крови и вместе с тем ослабление общих явлений опьянения.

Как отмечалось выше, концентрация алкоголя в крови здорового

томобилей, а также на открытом воздухе без прямого воздействия осадков и солнечных лучей.

2.4 Питание прибора – (12,6 ± 2) В, 230 В (+6 % -10 %) (посредством сетевого адаптера).

3 Основные технические данные

3.1 Прибор после включения должен обеспечивать автоматический контроль функционирования системы и подготовку к работе.
Время подготовки к работе – не более 15 мин.

3.2 Коэффициент пересчёта входной величины прибора – концентрации паров этанола в паро-газовой смеси (мг/м³) в отображаемую выходную величину – концентрацию этанола в крови (‰) равен 450 (45 мг/м³ (0,045 мг/л) – 0,1 ‰ (промилле)).

3.3 Полный диапазон измеряемых значений входной величины – от 0 до 990 мг/м³, отображаемых в выходную величину – от 0 до 0,990 мг/л с дискретностью 0,001 мг/л (от 0,0 до 2,2 ‰, с дискретностью показаний 0,1 ‰).

3.4 Дополнительный диапазон экстраполируемых и отображаемых в специальном режиме значений входной величины свыше 990 мг/м³ в значения выходной величины от 0,990 мг/л (от 2,2 ‰) и выше (по верхней границе не лимитируется) – рассчитывается микро-ЭВМ прибора благодаря линейности измеряемой величины выше верхней границы нормируемого диапазона.

3.5 Приведенная погрешность прибора ($\gamma_{пр}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины I – от 0 до 500 мг/м³, отображаемых в выходную величину от 0 до 0,500 мг/л (от 0,0 до 1,1 ‰), не более (± 10) %.

3.6 Относительная погрешность ($\sigma_{отн}$) в диапазоне измеряемых значений входной величины II – свыше 500 мг/м³ до 990 мг/м³, отображаемых в выходную величину > 0,500 до 0,990 мг/л (> 1,1 до 2,2 ‰), не более (± 10) %.

3.7 Продолжительность анализа пробы выдыхаемого воздуха по методике экспресс-теста – не более 15 с.

3.8 Продолжительность подготовки прибора к следующему тесту после пробы с концентрацией паров этанола в воздухе на уровне 450 мг/м³ (эквивалентной 1,0 ‰) – не более 40 с.

3.9 Максимальная электрическая мощность, потребляемая прибором, – не более 6,0 Вт.

3.10 Масса прибора – не более 0,3 кг.

3.11 Габаритные размеры прибора без разъемов, соединительных шнуров и выносных частей – 191×74×27 мм.

3.12 Средняя наработка прибора на отказ – не менее 6000 ч.

3.13 Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 8 ч в сутки.

3.14 Среднее время восстановления работоспособности прибора путем замены отказавшего газового сенсора – не более 30 мин.

3.15 Средний срок сохраняемости прибора должен быть не менее 6 месяцев.

3.16 Устройство и принцип работы.

Прибор «Алконт 01су» представляет собой (рис. 1) пластмассовый блок, имеющий на лицевой панели (поз. 7) счетверённый семисегментный индикатор (поз. 8), вертикальную линейку светодиодов (поз. 10) и два переключателя управления: левый (поз. 12) – включения/выключения прибора (I/O); правый (поз. 11) – включения/выключения режима "ТЕСТ".

На боковой поверхности прибора имеется разъём-вилка (поз. 4) для подключения источника питания (маркировка "12 В"). На противоположной боковой поверхности имеется разъём mini-USB (поз. 9) для подключения прибора к персональному компьютеру (маркировка "ПК"). На верхней торцевой части прибор имеет гнездо (поз. 6) для стыковки сенсорного зонда с мундштуком (поз. 2, 3) (маркировка "ЗОНД").

Изделие имеет съёмную приборную ножку-подставку (поз. 5) для его установки на горизонтальной поверхности при эксплуатации.

На задней поверхности корпуса расположена товарная табличка.

Для питания прибора от сети переменного тока используется комплектный сетевой адаптер (230 / 12 В). Питание от бортовой сети автомобиля (12 В) осуществляется через комплектный шнур питания, подключаемый к гнезду прикуривателя.

Выдыхаемый воздух (проба) поступает в сенсорный зонд через сменный мундштук индивидуального пользования. Мундштук исключает проникновение непосредственно на газовый сенсор капельной влаги или механических частиц. Сенсор вентилируется при извлечении мундштука.

Наличие алкоголя в крови испытываемого определяется косвенным методом: измерением концентрации паров спирта в выдыхаемом воздухе. Увеличение электропроводности чувствительного элемента первичного электронного преобразователя (полупроводникового газового сенсора) пропорционально концентрации этилового спирта в воздухе (мг/м^3) фиксируется микро-ЭВМ, производящей обработку электрических сигналов и выдающей результаты в цифровом виде в (мг/л) содержания этанола в выдыхаемом воздухе, или в единицах промилле (‰), соответствующих содержанию алкоголя в крови (мг/мл) – по выбору пользователя. Окончательный результат выводится на индикатор и дублируется свечением соответствующего светодиода вертикальной линейки.

Факт употребления алкогольных напитков (состояние алкогольного опьянения) фиксируется при установлении показаний прибора от 0,4 ‰ (включительно) и выше, с учётом его погрешности.

ция спирта в крови отмечается спустя 20 - 30 минут после потребления спирта на голодный желудок или спустя 1 - 2 часа после еды. Наибольшая часть поглощаемого спирта концентрируется в головном мозге, остальная часть, в нисходящем порядке, в других органах – легких, селезенке, почках. Скапливающееся в печени количество спирта нелегко определить, поскольку в этом органе происходит его биологическое преобразование.

Этиловый спирт не накапливается в организме, он удаляется быстро, стойким ритмом с момента его появления в тканях. Наибольшая доза поглощаемого спирта (90 - 95%) подлечит метаболизму и лишь незначительная часть (5 - 10 %) удаляется как таковая с мочой (2 - 4 %) и выдыхаемым воздухом (3 - 7 %). Рост мочеотделения или гипервентиляция не ускоряют существенно удаление спирта из организма. Биохимическое преобразование спирта осуществляется микросомами печени под воздействием фермента – алкогольдегидрогеназы.

Симптомология острого алкогольного отравления тесно связана с концентрацией спирта в крови. При этом, ее течение трехфазное: фаза возбуждения (легкая степень опьянения), фаза судебной медицины (выраженное опьянение, средняя степень опьянения), фаза коматозного состояния (глубокая степень опьянения).

В ряде источников, в том числе, использованных [3], [4], данные о состоянии алкоголя в крови, сопутствующими каждой из фаз, несколько отличаются, хотя данные источника [4] более современны.

В фазе возбуждения (легкая степень опьянения), когда концентрация спирта в крови составляет 0,8-1,6 ‰ [0,5-1,5 ‰], у отравившегося отмечаются состояние эйфории, экспансивность, несдержанность и невозможность точного определения опасности. Способность наблюдения, острота зрения и слуха, быстрота рефлекторной реакции и вообще, как психическая, так и физическая способность снижены. Вот поэтому эта фаза неправильно названа "возбуждением", поскольку она является результатом угнетающего действия этилового спирта на высшие нервные центры, выполняющие контрольную и управляющую функции в отношении низших центров. В связи с этим развивается чрезмерная необузданная активность низших центров, ускользающих из под контроля высших центров, находящихся в угнетенном состоянии. Это объясняет причину, по которой, на этой стадии, у отравившегося проявляется необузданное инстинктов и бесконтрольное – самопроизвольное и менее критическое поведение. В этой же фазе происходит расширение периферических сосудов, создающее ощущение тепла.

В следующей фазе, названной судебно-медицинской (средняя степень опьянения, или выраженное опьянение), которая соответствует концентрации спирта в крови 1,6-3,2 ‰ [1,5-2,5 ‰], у отравившегося наблюдаются хорошо известные проявления алкогольного опьянения. Мысли спутанные, несвязные; отмечается постепенный переход от чрезмерной говорливости к дизартрии. Притупляется чувствительность вообще, зрение и слух – в частности. Походка качающаяся, атаксическая, проявляется неуверенность в движениях нижних конечностей. В этой фазе отравившийся резко

случае измерение проводится не раньше, чем через 3 минуты после курения; в случае применения терапевтической дозы спиртосодержащих лекарств измерение проводится не раньше, чем через 15-20 минут после их приема.

При освидетельствовании водитель должен знать (и указывать на это проверяющему), что любой прибор имеет установленную погрешность, которая обязательно отражена в его эксплуатационной документации.

Важно учитывать и то, что ошибки измерения при освидетельствовании могут быть вызваны присутствием в окружающем воздухе низкомолекулярных летучих углеводородов – например, ацетона, метанола или этанола.

II. При широком практическом применении методов диагностики алкогольного опьянения следует иметь в виду следующие обстоятельства:

1. Методы диагностики должны быть по возможности просты, быстры, не требовать сложной аппаратуры.
 2. Методы не должны быть тягостны для испытуемого (что имеет место при взятии проб крови, содержимого желудка и т.д.).
 3. Необходимо строго учитывать разнообразие реакций на алкоголь отдельных лиц, обстоятельства, при которых был принят алкоголь, наличие клинических синдромов опьянения; помня, что проба на алкоголь в биологических средах (выдыхаемом воздухе, крови, моче, слюне и т.д.) является подсобным методом, помогающим врачу ориентироваться в состоянии испытуемого. Это соображение всегда надо иметь в виду во избежание возможных диагностических ошибок.
 4. При любом из биохимических и физико-химических методов возможны отдельные ошибочные показания как в силу недостаточной концентрации алкоголя в исследуемой среде, так и вследствие неполной специфичности того или иного метода определения алкоголя.
- Поэтому отрицательная реакция на алкоголь еще не исключает наличия опьянения и, наоборот, положительная (особенно слабо положительная, сомнительная) не является сама по себе доказательством опьянения.

Несмотря на довольно значительные индивидуальные различия в реакции на алкоголь, все же многие исследования концентрации алкоголя в крови указывают на известную последовательность и закономерность распространения алкоголя в организме и фаз алкогольного опьянения.

В организме человека содержится небольшое количество этилового (винного) спирта, образующегося при промежуточном метаболизме или брожении в пищеварительном тракте. Концентрация этого спирта в крови обычно не превышает 0,03 мг/мл (‰).

Винный спирт быстро поглощается пищеварительным трактом посредством слизистых оболочек рта, желудка и кишечника, и также быстро распространяется в тканях, где подвергается процессам метаболизма. Концентрация спирта в крови до 1,0 ‰ (промилле) в принципе достигается после потребления 1 грамма чистого спирта на 1 кг веса. Предельная концентра-

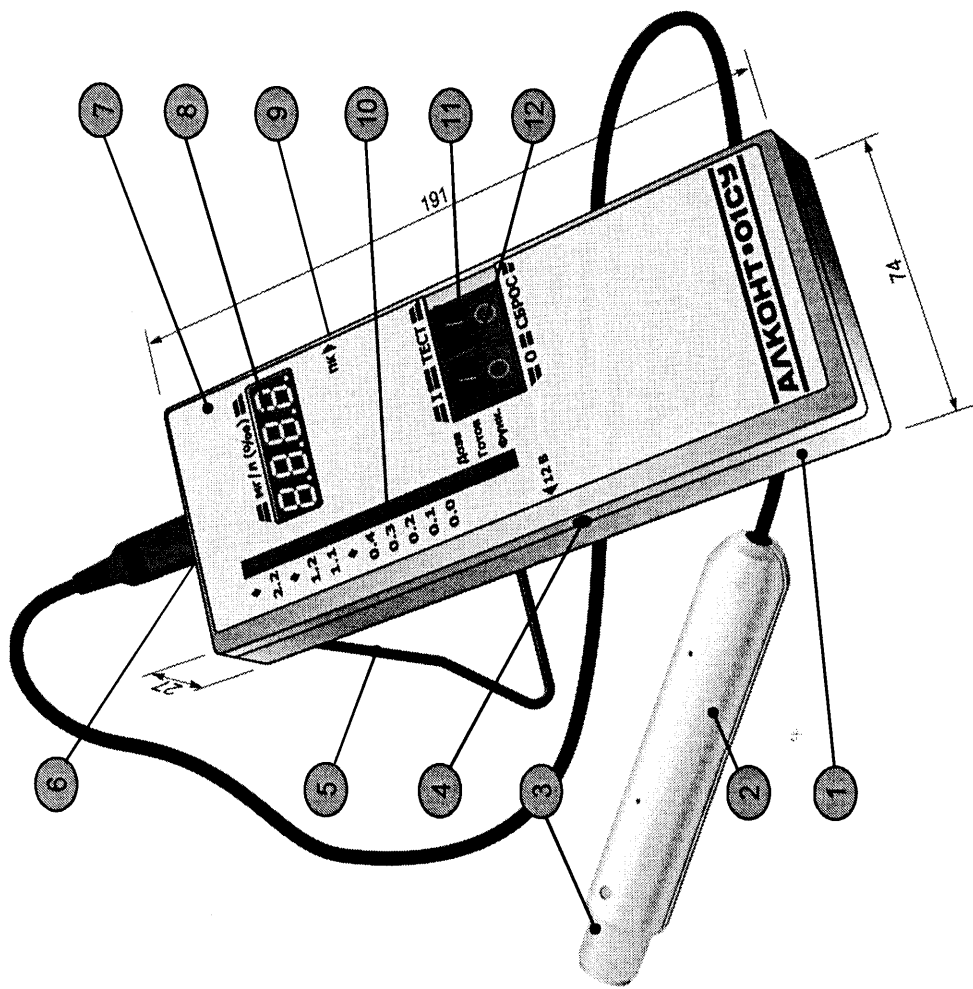


Рис.1. Внешний вид и габаритные размеры прибора «Алkont 01су».

- | | |
|--|--|
| 1 - корпус; | 8 - счетверенный семисегментный индикатор; |
| 2 - сенсорный зонд; | 9 - разъем подключения шнура связи с персональным компьютером; |
| 3 - мундштук индивидуального пользования; | 10 - линейка светодиодов; |
| 4 - разъем (вилка) подключения источника питания 12 В; | 11 - переключатель включения / выключения режима "ТЕСТ"; |
| 5 - съёмная ножка – подставка; | 12 - переключатель включения / выключения прибора. |
| 6 - разъем (розетка) подключения сенсорного зонда; | |
| 7 - крышка; | |

Установление показаний ст 0,150 мг/л (от 0,3 %) (включительно) и выше сопровождается подачей повторяющегося звукового сигнала и свечением соответствующего светодиода линейки.

Обязательным условием достоверности результатов измерений является соблюдение рекомендаций «Методики освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01су"» (Приложение 1).

4 Индивидуальные особенности изделия

4.1 Оптимальный режим использования – ежедневная эксплуатация прибора, исключающая длительные перерывы в работе. Определяется особенностью осаждения примесей из воздуха на холодный чувствительный элемент первичного электронного преобразователя в нерабочем состоянии прибора. После длительного хранения требуется кондиционирование газового сенсора – тренировка прибора во включенном состоянии для восстановления эксплуатационных кондиций (п. 15.1.3). С этим связаны требования к условиям текущего хранения: хранить сенсорные зонды с приборами в вентилируемых (прветриваемых) помещениях вдали от мест хранения (разлива) растворов, источников дыма.

4.2 **ВНИМАНИЕ, НЕДОПУСТИМО ПОПАДАНИЕ ЧИСТЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ (СПИРТА, АЦЕТОНА И Т.П.) ИЛИ ИХ РАСТВОРОВ НА ГАЗОВЫЙ СЕНСОР, ЧАСТИ СЕНСОРНОГО ЗОНДА И ПРИБОР. А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКАЗАННЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ (ПРОТИРКИ) ПРИБОРА И ЕГО ЧАСТЕЙ.**

4.3 Прибор имеет средства отображения, требующие мер предосторожности при эксплуатации, упаковывании, погрузке, выгрузке, транспортировании, извлечении из упаковки.

Освидетельствование в медицинских учреждениях для установления состояния опьянения проводится в любое время суток специально подготовленными врачами в:

- специальных кабинетах наркологических диспансеров;
- определенных органами здравоохранения лечебно-профилактических учреждений;
- передвижных специализированных медицинских автолабораториях.

Если проведение освидетельствования в полном объеме не представляется возможным из-за тяжести или характера полученных травм, то в лечебном учреждении в обязательном порядке должны проводиться исследования для установления наличия алкоголя в биологических средах (выдыхаемый воздух, моча, кровь, слюна).

Любому водителю, проходящему освидетельствование, необходимо знать, что при проведении освидетельствования врачом медучреждения заполняется в двух экземплярах акт освидетельствования физического лица на предмет выявления состояния опьянения, удостоверенный подписью и печатью врача. Первый экземпляр акта освидетельствования выдается должностному лицу, доставившему физическое лицо в организацию здравоохранения, второй – хранится в организации здравоохранения.

Не стоит, что часто бывает, пытаться скрыть от правоохранительных органов свои паспортные данные. Лицо, направляющее на освидетельствование, обязано принять меры к установлению личности водителя, а врач – удостовериться в личности водителя путем ознакомления с соответствующим документом. **Отсутствие личных документов не служит основанием к тому, чтобы не проводить освидетельствование водителя.** При отсутствии таких документов в протоколе фиксируются приметы обследуемого, указывается, что данные о его личности записаны со слов освидетельствуемого.

Организация здравоохранения при обращении физического лица, в отношении которого проводилось освидетельствование, за получением информации о его результатах выдаёт ему медицинскую справку о состоянии здоровья, содержащую заключение, вынесенное по результатам освидетельствования, в порядке, установленном законодательством.

При подозрении на наличие у обследуемого лица травматических повреждений или заболевания, внешние проявления которого сходны с признаками алкогольного опьянения, такой водитель после оказания первой медицинской помощи (если она требуется) должен быть доставлен в лечебное учреждение для оказания основной помощи и освидетельствования на предмет опьянения.

В специальных приборах концентрация алкоголя в крови определяется косвенным методом, путем регистрации паров спирта в выдыхаемом воздухе. Данные приборы могут эксплуатироваться в строгом соответствии с их эксплуатационной документацией.

Испытуемый должен быть опрошен на предмет употребления накануне измерения алкогольных напитков, лекарств, а также курения. В последнем

Методические указания по диагностике алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств (специализированных приборов определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с»)

Освидетельствование физических лиц с целью установления состояния алкогольного опьянения имеет два взаимосвязанных аспекта: юридический и медицинский (клинико-диагностический). Незнание основ содержания этих двух составляющих приводит к конфликтам, жалобам, судебным разбирательствам.

В Республике Беларусь порядок освидетельствования был юридически закреплён в Инструкции «О порядке направления водителей транспортных средств на освидетельствование для установления состояния опьянения и проведения освидетельствования», утвержденной МВД, Минздравом и Минюстом РБ, и введенной в действие с 01.07.1994 года [1]. С 12.08.2011 года вступило в действие «Положение о порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ», утвержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 апреля 2011 г. № 497 [2]. Это говорит о значимости сохранения и защиты прав граждан, подвергающихся подобной процедуре, а также о необходимости знания и соблюдения указанного порядка самими водителями.

1. Освидетельствование водителей транспортных средств, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения (перечень действий и признаков, наличие которых является достаточным основанием полагать, что физическое лицо, в отношении которого ведётся административный процесс, подозреваемый, обвиняемый, потерпевший находится в состоянии алкогольного опьянения – согласно Приложению 1 к Положению [2]), проводится лицами, средствами, в местах и в порядке, установленных Положением [2].

При уклонении лица от освидетельствования составляется протокол, в котором указываются признаки опьянения и действия нарушителя по уклонению от освидетельствования.

Уклонение водителя от освидетельствования ни к чему хорошему не приведет: факт опьянения будет установлен инспектором Госавтоинспекции лично и зафиксирован в протоколе, что уже никак не опровергнешь.

5 Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер	Примечание
ТФАГ 413422.001-02	Прибор «Алконт 01су»	1		
Комплект принадлежностей:				
ТФАГ 713423.001	мундштук	100		
AC-DC ADAPTER 230V/12V	блок питания 12В / 500mA	1		
ТФАГ 465139.001-01	шнур питания от бортовой сети	1		
ТФАГ 304274.001	опора	1		
ТФАГ 413422.001-02 ФО	формуляр	1		
www.alcont.brest.by (Alcont.exe)	программа поддержки для ПК	—		сайт
МРБ МП.367-2021	методика поверки	1		
СТБ 1015-97	упаковка	1		

6 Указания мер безопасности

6.1 К обслуживанию прибора допускаются лица только после инструктажа по технике безопасности и ознакомления с настоящим формуляром.

6.2 При эксплуатации прибора с использованием сетевого адаптера от электросети 230 В / 50 Гц использовать только исправные розетки.

6.3 Во избежание выхода прибора из строя не допускать попадания конденсированной влаги на корпус изделия, выносные части, сетевой адаптер; оберегать приборы от механических ударов, термических воздействий; не разбирать изделие, сетевой адаптер, шнуры связи, а также сенсорный зонд.

6.4 Запотевание изделия и его частей устранять протиранием х/б салфеткой.

6.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АДАПТЕРЫ, ШНУРЫ СВЯЗИ, МУНДШТУКИ ДЛЯ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ, А ТАКЖЕ ПРИБОР И КОМПЛЕКТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

6.6 Приборы должны применяться и эксплуатироваться только в режимах и условиях, установленных ТУ РБ 28801552.004-99 и отраженных в формуляре ТФАГ 413422.001-02 ФО.

7 Подготовка к работе

7.1 Распаковать прибор и проверить его комплектность.

7.2 Произвести внешний осмотр прибора, определить его целостность.

7.3 Присоединить сенсорный зонд к разъему "ЗОНД" прибора.

7.4 При работе от сети переменного тока, соединить комплектный сетевой адаптер с разъемом "12 В" прибора, подключить вилку адаптера в сетевую розетку (230 В / 50 Гц).

7.5 При работе от бортовой сети, соединить комплектный шнур питания от бортовой сети с разъемом "12 В" прибора, включить вилку шнура в розетку прикуривателя.

Примечание: потребитель может по желанию использовать съёмную ножку-подставку.

7.6 Включить прибор. Включение (выключение) производится переключателем "I / 0" (левым).

Включение переводом левого переключателя в положение "I" при положении правого переключателя "0" ("СБРОС") – инициирует подготовку прибора к работе с отображением измеряемых величин в (мг/л) (0.000) содержания этанола в выдыхаемом воздухе (прямая измеряемая величина).

По желанию пользователь может включить прибор с отображением измеряемых величин в единицах содержания алкоголя в крови (%). Для этого необходимо до включения прибора перевести правый переключатель в положение "I" ("ТЕСТ"). Включение реализовать переводом левого переключателя в положение "I". Одновременно с протяжённым звуковым сигналом на индикаторе появится сообщение "OFF". Для осуществления Вашего выбора (%) необходимо за время до пяти секунд перевести правый переключатель в положение "0" ("СБРОС").

Сразу же после включения (правый переключатель в положении "0" ("СБРОС")), одновременно с прерывистым звуковым сигналом на индикаторе производится отсчет шести тестовых секунд контроля функционирования, светится только нижний светодиод линейки (маркировка "ФУНК").

7.7 Система прибора после включения обеспечивает постоянный автоматический контроль функционального состояния в процессе работы.

В случае обнаружения (не обнаружения) нарушений в работе частей системы после истечения тестовых секунд на индикатор вместе со звуковым сигналом выдается одно из сообщений:

0.С

"обрыв сенсора"

Р.П

"режим подготовки"

обрыв в цепи газового сенсора, либо

смесь 6 (II)
$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{1,9 - 2,0}{2,0} \cdot 100 = -5\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\% \text{);}$$

смесь 1 (I)
$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,1 - 0,1}{0,5} \cdot 100 = 0\% \text{ (норма по [1] } \pm 20\% \text{);}$$

смесь 2 (I)
$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,2 - 0,2}{0,5} \cdot 100 = 0\% \text{ (норма по [1] } \pm 20\% \text{);}$$

смесь 3 (I)
$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,7 - 0,5}{0,5} \cdot 100 = +40\% \text{ (норма по [1] } \pm 20\% \text{);}$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{\text{пр.}}^I$) для данного диапазона. Результаты поверки отрицательные.

смесь 4 (II)
$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,5 - 0,6}{2,0} \cdot 100 = -5\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\% \text{);}$$

смесь 5 (II)
$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{0,9 - 1,0}{2,0} \cdot 100 = -5\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\% \text{);}$$

смесь 6 (II)
$$\gamma_{\text{пр.}} = \frac{1,6 - 2,0}{2,0} \cdot 100 = -20\% \text{ (норма по [1] } \pm 15\% \text{);}$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{\text{пр.}}^{\text{II}}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

Библиография:

- [1] ТУ РБ 28801552.004-99. Приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с», «Алконт 01см», «Алконт 01су», «Алконт 01са». Технические условия. Формуляры
- [2] ТУ 4381-043-21298618-2009. Генератор спирто-воздушных смесей ГСВС-META-02М. Технические условия
- [3] Правила осуществления метрологической оценки в виде работ по государственной поверке средств измерений, утверждённые постановлением Госстандарта от 21 апреля 2021 г. № 40

смесь 5 (II):
$$\sigma_{\text{отн. X}}^{\text{II}} = \frac{1,125 - 0,990}{0,990} \cdot 100 = 14 \%,$$

смесь 5 (II):
$$\sigma_{\text{отн. Y}}^{\text{II}} = \frac{2,5 - 2,2}{2,2} \cdot 100 = 14 \%$$
 (норма по [1] ($\pm 10 \%$)).

Значение относительной погрешности превышает предельное значение ($\sigma_{\text{отн.}}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

Таблица В.2 – Примеры расчётов для приборов, выпущенных до 30.08.2021

Воздействующая парогазовая смесь, номер диапазона	Номинальное значение концентрации паров этанола в воздействующей смеси X ₀ , мг/м ³	Номинальное значение выходной характеристики прибора Y ₀ , %	Фактические показания прибора при воздействии смесей Y, %
1	45	0,1	0,1
2 (I)	90	0,2	0,2
3	225	0,5	0,6
4	270	0,6	0,7
5 (II)	450	1,0	1,1
6	900	2,0	1,9
1	45	0,1	0,1
2 (I)	90	0,2	0,2
3	225	0,5	0,7
4	270	0,6	0,5
5 (II)	450	1,0	0,9
6	900	2,0	1,6

Определение приведенной погрешности прибора:

смесь 1 (I) (таблица 4)
$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,2 - 0,2}{0,5} \cdot 100 = 0 \%$$
 (норма по [1] $\pm 20 \%$);

смесь 2 (I)
$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,1 - 0,1}{0,5} \cdot 100 = 0 \%$$
 (норма по [1] $\pm 20 \%$);

смесь 3 (I)
$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,6 - 0,5}{0,5} \cdot 100 = + 20 \%$$
 (норма по [1] $\pm 20 \%$);

смесь 4 (II)
$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{0,7 - 0,6}{2,0} \cdot 100 = + 5 \%$$
 (норма по [1] + 15 / - 5 %);

смесь 5 (II)
$$\gamma_{\text{пр}} = \frac{1,1 - 1,0}{2,0} \cdot 100 = + 5 \%$$
 (норма по [1] $\pm 15 \%$);

определение системой "неготовности" газового сенсора к проведению измерений (газовый сенсор загрязнен). О степени загрязненности газового сенсора можно судить по свечению светодиодов линейки.

При определении системой состояния "готовности" сенсора вместе со свечением 3-х зеленых светодиодов (маркировка: "ФУНК", "ГОТОВ", "0.0") появляется сообщение:

Р.Г режим "готовности".

7.8 Режим "готовности" сопровождается постоянным контролем системы за состоянием газового сенсора. В случае его "загрязнения" в рабочем порядке появится сообщение

Р.П режим "подготовки"

со свечением соответствующих светодиодов.

В таком состоянии прибор **НЕ ГОТОВ** к тестированию!

7.9 Вызов из режима "готовности" режима "ТЕСТ" осуществляется переводом переключателя "ТЕСТ/СБРОС" в положение "ТЕСТ". На индикаторе появится сообщение

0.000 "0.000 мг/л"

Отказ от работы в этом режиме – перевод переключателя в положение "СБРОС" с выходом в текущее состояние ожидания (режим "готовности").

8 Порядок работы при освидетельствовании

8.1 Для проведения определения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом испытуемым воздухе, следует, руководствуясь рекомендациями Приложения 1, плотно (до упора) вставить в сенсорный зонд, соблюдая требования санитарной гигиены, ответной короткой частью мундштук индивидуального пользования.

8.2 Пользователь инструктирует испытуемого и переводом правого переключателя в положение "ТЕСТ" выводит прибор из режима ожидания ("Р.Г") в состояние готовности к проведению теста, при этом на индикаторе устанавливается сообщение вида:

0.0

8.3 Обследуемый сидит, на фоне спокойного дыхания, зажав мундштук губами и, удерживая зонд любой рукой, делает один полный энергичный выдох длительностью не менее 3 секунд.

После окончания выдоха испытуемый освобождает губы от мундштука и кладет сенсорный зонд, не извлекая мундштук из зонда до окончания теста.

8.4 Если испытуемый выполнил все действия правильно, то после подачи звукового сигнала включается таймер. Гаснет светодиод "ГОТОВ" и начинает мигать светодиод "ДОЗА" (на индикаторе и светодиодной линейке отображаются текущие результаты контроля пробы воздуха). Если тест состоялся (через измерительную ячейку прошло необходимое количество испытуемого воздуха), то на 13-й секунде мигание светодиода "ДОЗА" прекращается и вместе со звуковым сигналом фиксируется результат теста на индикаторе и светодиодной линейке.

Если показания прибора достигли значения 0,3 % или выше, то после остановки теста с выдачей окончательного результата раздается повторяющийся через равные промежутки времени звуковой сигнал.

8.5 После завершения теста необходимо извлечь мундштук из зонда для вентиляции газового сенсора и перевести правый переключатель в положение "СБРОС" для продолжения работы. Прибор автоматически готовится к работе. Признак готовности к продолжению работы – появление сообщения вида:

Р.Г

8.6 Если испытуемый дует в мундштук недостаточно сильно или не дует вообще – тест не запускается и сохраняется сообщение:

0.0

8.7 Если испытуемый делает выдох необходимой силы, но недостаточной продолжительности, или прерывистый выдох – после подачи звукового сигнала запускается таймер, но в момент установления прибором несоответствия характеристики пробоотбора норме, тест прерывается с выводом на индикатор сообщения вида:

П.П

"повторение пробы",

сопровожаемое повторяющимся звуковым сигналом и миганием светодиода "ДОЗА".

Для выхода в режим продолжения дальнейшей работы необходимо произвести "СБРОС" правым переключателем.

8.8 При любом варианте неправильных действий испытуемого тест необходимо повторить.

$$\gamma^I_{пр. Y} = \frac{1,2 - 1,1}{1,1} \cdot 100 = 9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%)).$$

В.2 Определение относительной погрешности $\sigma^{II}_{отн.}$:

$$\text{смесь 4 (II): } \sigma^{II}_{отн. X} = \frac{0,495 - 0,540}{0,540} \cdot 100 = -8 \%,$$

$$\sigma^{II}_{отн. Y} = \frac{1,1 - 1,2}{1,2} \cdot 100 = -8 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\text{смесь 5 (II): } \sigma^{II}_{отн. X} = \frac{1,035 - 0,990}{0,990} \cdot 100 = 5 \%,$$

$$\sigma^{II}_{отн. Y} = \frac{2,3 - 2,2}{2,2} \cdot 100 = 5 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%)).$$

В.3 Определение приведенной погрешности прибора, $\gamma_{пр.}$:

$$\text{смесь 1 (I): } \gamma^I_{пр. X} = \frac{0,045 - 0,090}{0,5} \cdot 100 = -9 \%,$$

$$\gamma^I_{пр. Y} = \frac{0,1 - 0,2}{1,1} \cdot 100 = -9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\text{смесь 2 (I): } \gamma^I_{пр. X} = \frac{0,180 - 0,180}{0,5} \cdot 100 = 0 \%,$$

$$\gamma^I_{пр. Y} = \frac{0,4 - 0,4}{1,1} \cdot 100 = 0 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

$$\text{смесь 3 (I): } \gamma^I_{пр. X} = \frac{0,360 - 0,495}{0,5} \cdot 100 = -27 \%,$$

$$\gamma^I_{пр. Y} = \frac{0,8 - 1,1}{1,1} \cdot 100 = -27 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

Значение приведенной погрешности превышает предельное значение ($\gamma_{пр.}$) для данного диапазона. Результаты поверки прибора отрицательные.

В.4 Определение относительной погрешности $\sigma^{II}_{отн.}$:

$$\text{смесь 4 (II): } \sigma^{II}_{отн. X} = \frac{0,585 - 0,540}{0,540} \cdot 100 = 8 \%,$$

$$\sigma^{II}_{отн. Y} = \frac{1,3 - 1,2}{1,2} \cdot 100 = 8 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%));$$

9 Контроль состояния системы. Возможные неисправности и способы их устранения

Система прибора позволяет контролировать возможные неисправности с помощью ряда сообщений.

Углубленный контроль состояния системы прибора осуществляется с помощью персонального компьютера. Данный режим реализуется с помощью специальной программы поддержки (см. Приложение 2 формуляра «Методика технического контроля, калибровки и настройки прибора "Алконт 01су"»). Это позволяет потребителю самостоятельно проводить кроме текущего технического контроля и ремонт изделия, в том числе замену отказавших сенсоров, а также настройку и калибровку изделия в закрытых (защищенных от несанкционированного доступа) режимах.

Возможные неисправности и способы их устранения

Характеристика неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
1 Отсутствуют любые сообщения на индикаторе, свечение светодиода "ФУНК", звуковые сигналы после включения прибора.	Отсутствие напряжения питания, неисправности источников питания, повреждения подводных проводов.	Проверить исправность сетевого адаптера, гнезда и вилки прикуривателя, целостность соединительных проводов, а также наличие напряжения в питающих сетях.
Есть звуковой сигнал, отсутствуют свечение светодиода "ФУНК" и (или) нет сообщений на индикаторе.	Выход из строя элементов питания собственно прибора.	Обратиться к изготовителю или в уполномоченную ремонтную службу.
Есть сообщения на индикаторе, светятся соответствующие светодиоды, нет звуковых сигналов.	Неисправен индикатор и (или) соответствующие светодиоды.	Неисправность устраняет изготовитель или уполномоченная ремонтная служба.
2 Сообщение "обрыв сенсора"	Неисправность звукоизлучателя или цепей управления им.	Неисправность устраняет изготовитель или уполномоченная ремонтная служба.
3 Сообщение "обрыв сенсора"	Не подключен сенсорный зонд.	Включить сенсорный зонд в соответствующий разъем выключенного прибора. Включить прибор, убедиться в исчезновении сообщения.

Примеры расчетов по обработке результатов измерений при определении метрологических характеристик приборов

Таблица В.1 – Примеры расчетов для приборов, выпущенных после 30.08.2021

Воздействующая парогазовая смесь, номер диапазона	Номинальное значение массовой концентрации паров этанола в воздействующей смеси X_0 , мг/м ³ (мг/л)	Номинальное значение выходной характеристики прибора Y_0 , мг/л / ‰	Фактические показания прибора при воздействии смесей X , мг/л, / ‰
1	90 (0,090)	0,090 / 0,2	0,090 / 0,2
2 (I)	180 (0,180)	0,180 / 0,4	0,225 / 0,5
3	495 (0,495)	0,495 / 1,1	0,540 / 1,2
4 (II)	540 (0,540)	0,540 / 1,2	0,495 / 1,1
5	990 (0,990)	0,990 / 2,2	1,035 / 2,3
1	90 (0,090)	0,090 / 0,2	0,045 / 0,1
2 (I)	180 (0,180)	0,180 / 0,4	0,180 / 0,4
3	495 (0,495)	0,495 / 1,1	0,360 / 0,8
4 (II)	540 (0,540)	0,540 / 1,2	0,585 / 1,3
5	990 (0,990)	0,990 / 2,2	1,125 / 2,5

В.1 Определение приведенной погрешности прибора, $\gamma_{пр}$, %

смесь 1 (I)

(таблица 3):

$$\gamma_{пр.X}^I = \frac{0,09 - 0,09}{0,5} \cdot 100 = 0 \%,$$

$$\gamma_{пр.Y}^I = \frac{0,2 - 0,2}{1,1} \cdot 100 = 0 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%) \text{);}$$

смесь 2 (I):

$$\gamma_{пр.X}^I = \frac{0,225 - 0,180}{0,5} \cdot 100 = 9 \%,$$

$$\gamma_{пр.Y}^I = \frac{0,5 - 0,4}{1,1} \cdot 100 = 9 \% \text{ (норма по [1] } (\pm 10 \%) \text{);}$$

смесь 3 (I):

$$\gamma_{пр.X}^I = \frac{0,540 - 0,495}{0,5} \cdot 100 = 9 \%,$$

Приложение Б
(рекомендуемое)
Форма протокола поверки

_____ наименование организации, проводившей поверку

ПРОТОКОЛ № _____

поверки прибора специализированного определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01с »

_____ наименование средства измерений

тип _____ № _____ дата выпуска _____

принадлежащего _____ наименование организации

Изготовитель ООО «Брестское техническое агентство»

_____ наименование изготовителя

Дата проведения поверки _____ с ... по ...

Поверка проводится по _____ обозначение документа, по которому проводят поверку

Средства поверки _____

Таблица Б.1

Наименование и тип средства измерений	Заводской номер

Условия поверки

- температура окружающего воздуха _____ °С или от 15 °С до 25 °С;
 - относительная влажность воздуха _____ % или от 45 % до 75 %.

Результаты поверки

Б.1 Внешний осмотр _____

соответствует/не соответствует

Б.2 Опробование _____

соответствует/не соответствует

Б.3 Определение метрологических характеристик

Б.3.1 Определение _____

наименование метрологической характеристики

Результаты измерений и оценка метрологической характеристики _____

Б.3.2 ...

Заключение _____

соответствует/не соответствует

Свидетельство (заключение о непригодности) № _____

Поверитель _____

подпись

расшифровка подписи _____

	нии данного сообщения по истечении шести часовых секунд после включения.
Нарушение целостности пайки соединительных проводов шнура сенсорного зонда с выводами разъема, проводов шнура. Плохой контакт сенсора с разъемом сенсорного зонда.	Проверить состояние и целостность пайки соединений, проводников, контактов. После устранения видимых причин неисправности включить прибор и убедиться в их устранении по соответствующим сообщениям на индикаторе.
Вышел из строя газовый сенсор.	Дополнительные указания на неисправность: Включить прибор в режиме "Поверка", т.е. включить его, переводя предварительно правый переключатель в положение "ТЕСТ". Появится сообщение 0.0 светятся светодиоды "ФУНК" и "0.0". Поднести к сенсорному зонду тампон, смоченный в этиловом спирте, не прикасаясь к нему и, тем более, к сенсору! Если сенсор исправен, на индикаторе и светодиодной шкале будет виден быстрый рост показаний. Если реакция отсутствует – сенсор вышел из строя. Заменить газовый сенсор.

Обязательные метрологические требования к характеристикам приборов, выпущенных в разные периоды

Таблица А.1 – Обязательные требования к характеристикам приборов, выпущенных до 30.08.2021

Нормируемый диапазон измерения, ‰	Фактически определяемая величина	Допустимая (предельная) величина отклонения, ‰
I 0 – 0,5	Приведённая погрешность $\gamma'_{пр}$	± 20
II 0,6 – 2,0	Приведённая погрешность $\gamma''_{пр}$	± 15

Таблица А.2 – Обязательные требования к характеристикам приборов, выпущенных после 30.08.2021

Нормируемый диапазон измерения, мг/л (‰)	Фактически определяемая величина	Допустимая (предельная) величина отклонения, ‰
I 0 – 0,5 (0 – 1,1)	Приведённая погрешность $\gamma'_{пр}$	± 10
II свыше 0,5 – 0,990 (свыше 1,1 – 2,2)	Относительная погрешность $\sigma''_{отн}$	± 10

3 Длительное сохранение сообщения вида: Р.П	Вышел из строя газовый сенсор.	Провести контроль состояния газового сенсора и его кондиционирование согласно Приложения 2 формуляра. В случае установления факта выхода его из строя, произвести замену, обратившись к изготовителю или в уполномоченную мастерскую.
---	--------------------------------	---

Примечание: после операции замены газового сенсора необходимо провести проверку и настройку прибора согласно приложению 2 формуляра.

10 Ресурсы, сроки службы и хранения; гарантии изготовителя

10.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

10.1.1 Средняя наработка прибора на отказ должна составлять не менее 6000 часов.

10.1.2 Средний срок службы прибора – не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 8 часов в сутки.

10.1.3 Среднее время восстановления работоспособности прибора путем замены отказавшего газового сенсора (мелкий ремонт) – не более 30 минут.

10.1.4 Средний срок сохраняемости прибора – не менее 6 месяцев (см. п. 4.1).

10.2 Гарантии изготовителя

10.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ РБ 28801552.004-99 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.

10.2.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора – 12 месяцев со дня продажи (поставки прибора потребителю).

10.2.3 В течение срока гарантии предприятие-изготовитель безвозмездно производит ремонт прибора или его замену при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

10.2.4 За повреждение прибора вследствие его неправильной эксплуатации предприятия-изготовитель ответственности не несет.

10.2.5 Кондиционирование газового сенсора продолжительностью до 6 часов после длительного хранения прибора с целью восстановления эксплуатационных характеристик (см. п. 4.1) представляет собой один из режимов технического обслуживания (п. 15.1 и Приложение 2 формуляра) и также не является причиной признания факта брака.

10.2.6 Гарантийный срок хранения приборов – 6 месяцев.

10.2.7 После истечения гарантийного срока ремонт приборов осуществляется изготовителем по отдельной договоренности или специализированными ремонтными службами в соответствии с эксплуатационной документацией.

10.2.8 Изготовитель может поставлять по заказу необходимые для ремонта комплектующие.

10.2.9 В случае отказа газовых сенсоров, изготовитель может поставить их по заказу с таблицей калибровки.

10.2.10 При проведении гарантийного ремонта изготовитель обязуется вернуть потребителю изделие «Алконт 01су» (средство измерения) после проведения поверки.

11 Свидетельство об упаковкевании

Специализированный прибор
определения концентрации паров
этаноло в выдыхаемом воздухе «Алконт 01су» № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован ООО «Брестское техническое агентство»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным ТУ РБ 28801552.004-99.

УПАКОВЩИК N 2

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

9.3 Если по результатам первичной поверки прибор признан непригодным к применению, выдают заключение о непригодности по форме согласно приложению 3 [3] и (или) техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений.

Если по результатам последующей поверки прибор признан непригодным к применению, выдают заключение о непригодности по форме согласно приложению 3 [3], свидетельство о предыдущей поверке прекращает своё действие, и знак поверки подлежит уничтожению путём приведения его в состояние, не пригодное для дальнейшего применения.

Прибор к применению не допускается.

$$\gamma_{\text{пр}}^I = \frac{Y - Y_0}{Y_k} \cdot 100, \quad (2)$$

где Y – отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_0 – отображаемое прибором для данной воздействующей парогазовой смеси номинальное значение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_k – верхнее значение (граница) нормируемого диапазона отображаемых прибором значений концентрации этанола в воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰).

Значения приведённой погрешности $\gamma_{\text{пр}}^I$ для нормируемого диапазона I не должны превышать $\pm 10\%$.

8.3.5 Для приборов, выпущенных после 30.08.2021, относительную погрешность в нормируемом диапазоне II $\sigma_{\text{отн}}^{II}\%$, определяют по формуле

$$\sigma_{\text{отн}}^{II} = \frac{Y - Y_0}{Y_0} \cdot 100, \quad (3)$$

где Y – отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰);

Y_0 – отображаемое прибором для данной воздействующей парогазовой смеси номинальное значение концентрации этанола в выдыхаемом воздухе, мг/л (концентрации этанола в крови, ‰).

Значения относительной погрешности $\sigma_{\text{отн}}^{II}$ для нормируемого диапазона II не должны превышать $\pm 10\%$.

Примеры расчетов при обработке результатов измерений, полученных при определении метрологических характеристик приборов, выпущенных в разные периоды, приведены в приложении Б.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки заносят в протокол, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б.

9.2 Если по результатам поверки прибор признан пригодным к применению, то на него и (или) в формуляр наносят знак поверки и (или) выдают свидетельство о поверке по форме, установленной в приложении 2 [3] и (или) техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации по вопросам обеспечения единства измерений.

12 Свидетельство о приеме

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01су» № _____ заводской номер _____

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации ТФАГ 413422.001-02 и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М. П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Специализированный прибор определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01су» № _____ заводской номер _____

прошел первичную поверку и допущен к применению в качестве средства измерения.

Государственный поверитель:

М. П.

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Свидетельство о поверке № _____

Межповерочный интервал прибора – 6 месяцев.

13 Движение изделия при эксплуатации

[illegible]

13.1 Ограничения по транспортированию

13.1.1 Приборы в упаковке следует транспортировать только в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

13.1.2 Не допускается транспортирование в негерметизированных отсеках самолетов.

13.1.3 Условия транспортирования приборов в упаковке должны соответствовать условиям хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

8.3.2 Для приборов, выпущенных после 30.08.2021, определение приведенной погрешности $\gamma_{пр}$ в диапазоне I и относительной погрешности $\sigma_{отн.}$ в диапазоне II проводят последовательным воздействием на газовый сенсор прибора паргазовыми смесями. Концентрации смесей должны соответствовать таблице 4.

Таблица 4 – Номинальные значения концентраций воздействующих парогазовых смесей для приборов, выпущенных после 30.08.2021

Нормируемый диапазон концентраций воздействующих смесей, мг/м ³ (%)	Номер воздействующей смеси	Номинальное значение концентрации воздействующей смеси X ₀ , мг/м ³ , (номинальное значение, отобранное прибором Y ₀ , мг/л / ‰)
I 0 – 500 (0,0 – 1,1)	1	90 (0,090 / 0,2)
	2	180 (0,180 / 0,4)
	3	495 (0,495 / 1,1)
II свыше 500 – 990 (свыше 1,1 – 2,2)	4	540 (0,540 / 1,2)
	5	990 (0,990 / 2,2)

Пропускание смесей осуществляют в следующей последовательности:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5.

Порядок выполняемых действий – согласно 8.2.3.

8.3.3 Для приборов, выпущенных до 30.08.2021, приведённую погрешность в нормируемом диапазоне $\gamma_{\text{пр}}^I$, %, приведённую погрешность в нормируемом диапазоне $\gamma_{\text{пр}}^{II}$, %, определяют по формуле

$$\gamma_{\text{np.}}^{\text{I,II}} = \frac{Y - Y_0}{Y_k} \cdot 100, \quad (1)$$

где Y — отображаемые прибором фактические показания концентрации этанола в крови, %;

Y_0 — отображаемое прибором для данной воздействующей паразитной смеси номинальное значение концентрации этанола в крови, %;

Y_k – верхнее значение (граница) нормируемого диапазона отображаемых прибором значений концентрации этанола в крови, %.

Значения приведённой погрешности в нормируемом диапазоне $\gamma_{гр}^I$ не должны превышать $\pm 20\%$.

Значения приведённой погрешности в нормируемом диапазоне $\Pi \gamma_{\text{пр}}^{\text{II}}$ не должны превышать $\pm 15\%$ (для смеси № 4 ($X_0 = 270 \text{ мг/м}^3$, $Y_0 = 0,6\%$) $\gamma_{\text{пр}} = +15 / -5\%$).

8.3.4 Для приборов, выпущенных после 30.08.2021, приведенную погрешность в нормируемом диапазоне $\gamma_{пр.} \%$, определяют по формуле

Каждое последующее измерение (воздействие новой смеси) проводят только после полного восстановления газового сенсора в процессе работы в воздухе с установлением на индикаторе показаний 0,0 %.

[illegible]

15 Учет технического обслуживания

15.1 Техническое обслуживание

15.1.1 Ежедневное техническое обслуживание заключается в осмотре прибора и дезинфекции его поверхностей, а также сенсорного зонда перед началом работы и по мере необходимости.

15.1.2 Дезинфекцию проводить в соответствии с санитарными правилами по осуществлению дезинфекционной деятельности (см. Приложение 1 формуляра, п. 4.4), например – протираанием х/б салфеткой, смоченной смесью 3-процентного раствора перекиси водорода и 0,5-процентного раствора моющего средства. Салфетка должна быть отжата и не оставлять на проти-

Каждое последующее измерение (воздействие новой смеси) проводят только после полного восстановления газового сенсора в процессе работы в воздухе с установлением на индикаторе показаний 0,0 %.

Сравнивают соответствие показаний приборов в ‰ и номинальных значений концентрации действующих паргазовых смесей с учётом погрешности приборов и коэффициента пересчёта (воздух – кровь) [1].

Прибор считают прошедшим опробование при соответствии всех показаний для указанных воздействующих смесей значениям, приведенным в таблице А.1 приложения А.

8.2.4 При опробовании приборов, выпущенных после 30.08.2021, для установления правильности их калибровки подают на газовый сенсор следующие паргазовые смеси: 0,090 мг/л паров этанола в воздухе (0,2 ‰); 0,180 мг/л (0,4 ‰); 0,540 мг/л (1,2 ‰); 0,990 мг/л (2,2 ‰). Фиксируют максимальные установившиеся в результате воздействия показания приборов в мг/л (‰).

Порядок действий – аналогичный изложенному в п.8.2.3.

Прибор считают прошедшим опробование при соответствии всех показаний для указанных воздействующих смесей значениям, приведенным в таблице А.2 приложения А.

8.3 Определение метрологических характеристик

8.3.1 Для приборов, выпущенных до 30.08.2021, определение приведенной погрешности $\gamma'_{пр}$ в диапазоне I и приведенной погрешности $\gamma''_{пр}$ в диапазоне II проводят последовательным воздействием на газовый сенсор прибора паргазовыми смесями. Концентрации смесей должны соответствовать таблице 3.

Таблица 3 – Номинальные значения концентраций воздействующих парогазовых смесей для приборов, выпущенных до 30.08.2021

Нормируемый диапазон концентраций воздействующих смесей, мг/м ³ (‰)	Номер воздействующей смеси	Номинальное значение концентрации воздействующей смеси X ₀ , мг/м ³ , (номинальное значение, отображаемое прибором, Y ₀ , ‰)
I 0 – 225 (0,0 – 0,5)	1	45 (0,1)
	2	90 (0,2)
	3	225 (0,5)
II 270 – 900 (0,6 – 2,0)	4	270 (0,6)
	5	450 (1,0)
	6	900 (2,0)

Пропускание смесей осуществляют в следующей последовательности:

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6.$$

Порядок выполняемых действий – согласно 8.2.3.

раемых поверхностях каплеь раствора. Обработанные поверхности должны быть вытерты насухо чистой сухой х/б салфеткой.

При обработке сенсорного зонда не допускать попадания жидкостей на газовый сенсор!

15.1.3 Кондиционирование газового сенсора после хранения прибора (п. 4.1) проводится тренировкой прибора во включенном состоянии в проветренном помещении до 6 часов. Как правило, восстановление эксплуатационных характеристик газового сенсора происходит за более короткое время. Признаком готовности к работе – появление сообщения типа:

18

и свечение светодиодов "ФУНК", "ГОТОВ" и "0.0".

15.1.4 Мундштуки индивидуального пользования могут использоваться повторно только после специальной обработки (дезинфекции) в соответствии с санитарными правилами (кипячение в течение 30 минут в дистиллированной воде с последующей сушкой и т. п.).

15.2 Учет технического обслуживания

[illegible]

7 Подготовка к поверке

Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

7.1 Проверка технического состояния и выполнение работ по подготовке спирто-воздушных смесей для использования в спирто-воздушном генераторе спирто-воздушных смесей согласно его эксплуатационной документации [2].

7.2 Размещают у места поверки гигрометр психрометрический ВИТ-1.

8 Проведение поверки

8.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемых приборов следующим требованиям:

8.1.1 Внешний вид должен соответствовать рисунку 1 [1].

8.1.2 Комплектность должна соответствовать разделу 5 [1].

8.2 Опробование

8.2.1 Включают приборы и проводят контроль функционирования согласно разделу 7 [1].

8.2.2 Выходят в режим "Проверка" согласно [1].

8.2.3 Для опробования приборов, выпущенных до 30.08.2021, используют парогазовые смеси: 225 мг/м³ паров этанола в воздухе (0,5 ‰); 450 мг/м³ (1,0 ‰); 900 мг/м³ (2,0 ‰).

Время воздействия (подачи) парогазовой смеси на чувствительный элемент прибора – 5 с.

Время фиксации показаний прибора:

– переводом правого переключателя прибора «Алконт 01су» в положение СБРОС одновременно с началом подачи парогазовой смеси – 10 с;

– нажатием кнопки **ТЕСТ** прибора «Алкотест 01cm» одновременно с началом подачи парогазовой смеси – 10 с;

– нажатием кнопки ТЕСТ прибора «Алконт 01са» одновременно с прекращением подачи парогазовой смеси – 10 с;

Смеси подают на сенсорный зонд со вставленным мундштуком, который погружают рабочей частью в ячейку газовой магистральной (воздух, спирто-воздушные смеси) или в выходной патрубок используемого генератора спирто-воздушных смесей.

Используются следующие методы:

- Подают смесь из генератора, показания поверяемого прибора фиксируют в протоколе, рекомендуемая форма которого приведена в приложении Б.
- Извлекают сенсорный зонд прибора из выходного патрубка генератора (ячейки газовой магистральной).

4.1 К проведению поверки допускаются лица, изучившие правила электробезопасности, инструкцию по технике безопасности при работе с легко воспламеняющимися жидкостями и ознакомившиеся с эксплуатационной документацией используемых средств поверки и поверяемых приборов.

4.2 Все работы необходимо проводить в проветриваемых (вентилируемых) помещениях. Наличие запахов не допускается.

4.3 Использованные парогазовые смеси утилизировать посредством вытязки.

4.4 Место поверки должно быть удалено (защищено) от прямого воздействия источников теплового излучения и прямых потоков воздуха (сквозняки, вентиляторы).

Таблица 2 – Средства поверки

Номер пункта методики поверки	Наименование и тип (условное обозначение) эталонов и вспомогательных средств поверки, их метрологические и основные технические характеристики
7	Гигрометр психрометрический ВИТ-1, скорость аспирации от 0,5 до 1,0 м/с
8.1	Штангенциркуль ШЦ-11-250-0,05
8.2, 8.3	Генератор ГСВС-META-02М [2]
Примечания	
1	Допускается применять другие средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик поверяемых приборов с требуемой точностью.
2	Все средства измерений должны иметь действующие клейма и (или) свидетельства о поверке.

5 Требования к квалификации поверителей

К проведению измерений при поверке и (или) обработке результатов измерений допускают лиц, имеющих необходимую квалификацию в области обеспечения единства измерений.

6 Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие нормальные условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха (60 ± 15) %;
- атмосферное давление ($101,3 \pm 4$) кПа.

16 Работы при эксплуатации

16.1 Технический контроль состояния прибора, в необходимых случаях его калибровка и (или) настройка производится при подготовке к предъявлению прибора в поверку уполномоченной технической службой согласно Приложению 2 формуляра.

16.2 Поверка прибора производится согласно действующих ТНПА и Методики поверки МРБ МП.367-2021 (Приложение 4) – один раз в шесть месяцев.

16.3 Для проверки технического состояния прибора и его настройки используется цифровой вольтметр класса 0,04 %, персональный компьютер любой модели. Для проверки прибора, кроме того, – генератор паров спирта ГСВС-META-02М (или другие поверочные средства).

16.4 Приготовление спирто-воздушных смесей на используемых генераторах проводить по методике, приведённой в Приложении 3.

16.5 Учет выполнения работ. Фиксируются сведения о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его эксплуатации, включая замену отдельных составных частей (комплектующих, покупных изделий).

Учет выполнения работ

Дата	Причина ее выполнения	Должность, фамилия и подпись		Примечание
		выполнившего работу	проверившего работу	

16.6 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям. Фиксируются сведения об основных замечаниях по эксплуатации и данные по аварийным случаям, возникшим из-за неисправности изделия, а также о принятых мерах по их устранению.

Таблица 1 – Операции поверки

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при	
		первичной поверке	последующей поверке
1 Подготовка к поверке	7	+	+
2 Внешний осмотр	8.1	+	+
3 Опробование	8.2	+	+
4 Определение метрологических характеристик приборов	8.3	+	+
4.1 Определение приведённой погрешности $\gamma_{пр. II}$ в двух нормируемых диапазонах *	8.3.3	+	+
4.2 Определение приведённой погрешности, $\gamma_{пр}$ в нормируемом диапазоне I **	8.3.4	+	+
4.3 Определение относительной погрешности $\sigma_{отн. II}$ в нормируемом диапазоне II **	8.3.5	+	+
5 Оформление результатов поверки	9	+	+

* Для приборов, выпущенных до 30.08.2021.
 ** Для приборов, выпущенных после 30.08.2021.

Примечание – Если при проведении операций 2, 3, 4 получают отрицательный результат, дальнейшую поверку прекращают.

3 Средства поверки

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

4 Требования безопасности

При проведении поверки должны быть соблюдены следующие требования безопасности согласно ТКП 427, ГОСТ 12.1.005 и (или) технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации:

Методика поверки МРБ МП.367-2021

Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь

ПРИБОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ «Алконт 01с», «Алконт 01см», «Алконт 01су», «Алконт 01са»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МРБ МП.367-2021

Настоящая методика поверки (далее – МП) распространяется на приборы специализированные определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе "Алконт 01с", "Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са" (далее – приборы), выпускаемые по [1], производства Общества с ограниченной ответственностью «Брестское техническое агентство» и устанавливает методы и средства поверки.

Приборы предназначены для измерения концентрации паров этанола в воздухе, выдыхаемом человеком.

Обязательные метрологические требования к приборам приведены в приложении А.

1 Нормативные ссылки

В настоящей МП использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

ТКП 427-2012 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Примечание – При использовании настоящей МП целесообразно проверить действие ссылочных ТНПА на официальном сайте Национального фонда ТНПА в глобальной компьютерной сети Интернет.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при применении настоящей МП следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Операции поверки

При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

Примечание															
	Срок очередной поверки														
Поверка	Дата														
	Срок очередной поверки														
	Дата														
	Срок очередной поверки														
	Дата														
Периодичность поверки	Дата														
	Срок очередной поверки														
Дата изготовления	Срок очередной поверки														
	Срок очередной поверки														
Заводской номер	Срок очередной поверки														
	Срок очередной поверки														
Наименование и обозначение средства измерения	Срок очередной поверки														
	Срок очередной поверки														

16.8 Поверка средств измерений.

Внешнее про- явление неис- правности	Дата и но- мер рекла- мационного акта	Краткое содер- жание реклама- ции	Отметка об удовлетво- рении ре- кламации	Примеча- ние

17 Хранение

17.1 Условия транспортирования и хранения приборов в упаковке должны соответствовать условиям хранения 2С по ГОСТ 15150-69.

17.2 Сведения о хранении.

приемки на хранение	Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
	снятия с хранения				

Концентрация спир- та-ректификата, %	96	95	94	93	92	91
Плотность, г/см ³	0,8013	0,8042	0,8070	0,8098	0,8126	0,8153

Приложение 2 Объемы первичного раствора, необходимые для пригото-
вления рабочих растворов, обеспечивающих получение не-
которых концентраций этанола в спирто-воздушной смеси
(рассчитаны относительно концентрации спирта-
ректификата 96%) на генераторе ГС-1.

Концентрация этанола в смеси, мг/м ³	90	180	495	540	990
Объём первичного рас- твора, мл	5,0	10,0	27,6	30,1	55,2

Приложение 3 Объемы первичного раствора (96 % этанола), необходимые
для приготовления рабочих растворов, обеспечивающих
получение некоторых концентраций этанола в спирто-
воздушной смеси (рассчитаны относительно concentra-
ции спирта-ректификата 96%) на генераторе ГСВС-
МЕТА-02М.

C ₀ ^{ГС} , мг/м ³	90	180	495	540	990
C ₀ ^Р , мг/мл	0,232	0,463	1,274	1,390	2,547
V, мл 96 % этанола в 1 л рас- твора	0,30	0,60	1,66	1,81	3,31

2.3.9 Генератор готов к работе.

2.3.10 Общее время сохранности раствора в колбе с притертой пробкой и в стакане генератора ГС-1 после приготовления раствора должно быть не более 1 суток.

2.4 Для приготовления водно-спиртовых растворов на генераторе ГСВС-META-02M необходимо:

2.4.1 При наличии – использовать государственные стандартные образцы (ГСО) состава водных растворов этанола ВРЭ-2 (ГС08789-2006) с паспортами.

2.4.2 При необходимости приготовления на генераторе газовой смеси (ГС) с номинальным значением массовой концентрации этанола $C_0^{ГС}$, мг/м³, требуемое содержание этанола в водном растворе рассчитывается по формуле:

$$C_0^P = \frac{C_0^{ГС}}{388,66}, \text{ где}$$

C_0^P – номинальное значение массовой концентрации этанола в приготавливаемом (используемом в случае применения ГСО) составе водного раствора этанола) растворе, мг/мл.

2.4.3 Используя данные Приложения 1 и рассчитанные значения содержания спирта-ректификата (мл) в 1000 мл рабочего раствора для получения ГС с заданной массовой концентрацией этанола (мг/м³) (Приложение 3), приготовить необходимые растворы (см. п. 2.2.5.6).

2.4.4 При использовании готовых ГСО, как и при приготовлении необходимых рабочих растворов, соблюдать все рекомендации руководства по эксплуатации генератора спирто-воздушных смесей ГСВС-META-02M.

18 Ремонт

18.1 Краткие записи о произведенном ремонте.

«Алконт 01су»	№	заводской номер	предприятие, дата
наименование изделия	обозначение		
Наработка с начала эксплуатации			
параметр, характеризующий ресурс или срок службы			
Наработка после последнего ремонта			
параметр, характеризующий ресурс или срок службы			
Причина поступления в ремонт			
Сведения о произведенном ремонте			
вид ремонта и			
краткие сведения о ремонте			

18.2 Данные приемо-сдаточных испытаний после ремонта.

18.3 Свидетельство о приемке и гарантии.

«Алконт 01су»	№	заводской номер	вид ремонта
наименование изделия	обозначение		
наименование предприятия		согласно	вид документа

Принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта _____ в течение срока
параметр, определяющий ресурс
службы _____ лет, в том числе срок хранения _____
при условиях хранения

Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

М. П. _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____ год, месяц, число

$$C_s = \frac{V_p \times p \times C_E}{V_2 \times 10 \times 100} \quad (4), \text{ где}$$

V_p - объем избранной пипетки;
получаемые размерности C_g и C_s – [мг/м³] и [г/л] соответственно.

2.2.5.5 Если температура использования спирто-воздушных смесей отличается от температуры их приготовления на генераторе ГС-1, концентрацию этилового спирта в смеси необходимо привести к температуре использования умножением на поправочный коэффициент, вычисленный по формуле (5):

$$f_t = \frac{T_o + 26}{T_o + T} \quad (5), \text{ где}$$

f_t - поправочный коэффициент;

 $T_0 = 273 \text{ K};$

T - температура использования газовой смеси, °C.

2.2.5.6 Рабочий раствор готовить в мерной колбе ёмкостью 1000 мл. Заполнить колбу дистиллированной водой на 2/3 объёма. Добавить пипеткой рассчитанный объём первичного раствора (Приложение 2), довести объём жидкости в колбе до марки дистиллированной водой, закрыть пробкой, тщательно перемешать (см. п. 2.3.10 методики).

2.3 Подготовка генератора ГС-1 к работе.

20 контроль состояния изделия и ведения формуляра

[illegible]

2.3.1 Перед началом работы осмотреть генератор, удостовериться в целостности стаканов, исправности замков и уплотнения. Генератор должен быть предварительно промыт и высушен.

2.3.2 Залить рабочий раствор (850 ± 50) мл в стакан генератора ГС-1.

2.3.3 Включить питание генератора.

2.3.4 Проверить герметичность системы.

2.3.4.1 Заглушить выходной штуцер генератора.

2.3.4.2 Перевести регулятор подачи смеси в положение 2 (см. «Техническое описание и инструкции по эксплуатации генератора ГС-1»).

2.3.4.3 Если система герметична, пробулькивание пузырьков в стакане генератора должно прекратиться через 1-2 минуты.

2.3.5 Удалить заглушку.

2.3.6 Перевести регулятор подачі смеси в положення 1 (робота по замкненому циклу).

2.3.7 Включить тумблер "Стаб."

2.3.8 Не более чем за 60 минут температура раствора в стакане генератора должна установиться на постоянном значении ($26 \pm 0,2$) °C.

21 Перечень приложений

№ приложения	Наименование приложения	Местонахождение приложения
1	Методика освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01су"	стр. 28
2	Методика технического контроля, калибровки и настройки прибора "Алконт 01су"	стр. 31
3	Методика приготовления спирто-воздушных смесей на генераторах ГС-1 и ГСВС-META-02М	стр. 33
4	Методика поверки МРБ МП.367-2021	стр. 38
5	Методические указания по диагностике алкогольного опьянения с использованием специальных технических средств (специализированных приборов определения концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе «Алконт 01су»)	стр. 52

2.2.2 При помощи ареометра определить плотность этилового спирта.

2.2.3 На основании полученного результата, используя приведенный в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации генератора ГС-1" график или справочные таблицы, определить массовую концентрацию этилового спирта (%).

2.2.4 Приготовить первичный водно-спиртовой раствор.

2.2.4.1 Мерную колбу на 100 мл заполнить на 2/3 дистиллированной водой.

2.2.4.2 Отобрав пипеткой 10 мл этилового спирта и добавив его в колбу.

2.2.4.3 Довести объем раствора в колбе дистиллированной водой до марки, закрыть колбу, тщательно перемешать раствор.

2.2.5 Приготовить рабочий водно-спиртовой раствор.

2.2.5.1 Определить массовую концентрацию спирта в водно-спиртовом растворе по формуле:

$$C_S = C_g / K \quad (1), \text{ где}$$

$$V_1 = \frac{V_2 \times C_S \times A \times 100}{p \times C_E} \quad (2), \text{ где}$$

$$C_g = K \times C_S \quad (3),$$

2.2.5.2 Определить требуемый объем первичного раствора по формуле:

2.2.5.3 При необходимости дозирования спирта и исходного раствора пипетками с одной меткой пипетку подбирать вместимостью, близкой к объёму, рассчитанному по формуле (2).

2.2.5.4 Расчет концентрации спирто-воздушной смеси производить по формулам (3), (4):

МЕТОДИКА

освидетельствования с помощью прибора "Алконт 01су"

1 Физиологические основы выявления факта употребления алкоголя по результатам исследования выдыхаемого воздуха

При употреблении спиртных напитков алкоголь проникает путем диффузии через стенки желудка и кишечника в кровяное русло в практически неизменном виде (этилового спирта). С кровью, оттекающей от желудочно-кишечного тракта, он попадает в печень, далее в правые отделы сердца, сосуды легких, левые отделы сердца и, наконец, с артериальной кровью разносится по всем органам и тканям и распределяется в них пропорционально содержанию в тканях воды.

В выдыхаемый воздух алкоголь проникает по крови, диффундируя через стенки альвеол. Соотношение концентрации алкоголя в крови и альвеолярном воздухе постоянно и определяется разностью плотности сред: крови и воздуха, и составляет при колебаниях от 1:1300 до 1:3000 в среднем 1:2200. Это означает, что в 2200 см³ альвеолярного воздуха содержится такое же количество алкоголя, как и в 1 см³ (миллилитре) крови.

Содержание паров алкоголя (этанола) в выдыхаемом воздухе выражается в миллиграммах на 1 м³ (мг/м³) и с учетом отношения плотностей крови и воздуха может быть оценочно выражено в промиллях по крови, миллиграммах алкоголя в 1 миллилитре крови (‰, мг/мл, прт.) то же, что ‰ ВАС (Blood alcohol concentration). При этом 0,1 ‰ алкоголя в крови соответствует примерно 45 мг/м³ алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Как правило, в выдыхаемом воздухе в небольших количествах могут находиться и некоторые органические, так называемые редуцирующие вещества, такие как ацетон, альдегиды и др., которые так же, как и алкоголь, могут влиять на показания прибора.

Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе, крови или другой биологической среде организма не позволяет окончательно судить о степени опьянения человека. Это связано с неодинаковой реакцией одного человека на одни и те же дозы алкоголя, а также фазой алкогольной интоксикации. Однако, выявление в биологических средах организма содержания алкоголя, превышающего эндогенный уровень, свидетельствует о факте употребления спиртных напитков.

Факт употребления алкогольных напитков (состояние алкогольного опьянения) фиксируется с помощью прибора «Алконт 01су» при установлении показаний прибора от 0,4 ‰ (включительно) и выше с учетом его погрешности (см. метрологические характеристики прибора).

При использовании данного прибора, как и всех прочих технических средств контроля, следует помнить:

– показания технических средств контроля на факт употребления алкогольных напитков являются дополнительным методом, помогающим специа-

МЕТОДИКА

приготовления спирто-воздушных смесей на генераторах ГС-1 и ГСВС-META-02M

1 Назначение

1.1 Методика предназначена для приготовления увлажнённых спирто-воздушных смесей, используемых для поверки приборов "Алконт 01с" ("Алконт 01см", "Алконт 01су", "Алконт 01са") и калибровки газовых сенсоров на стадии изготовления приборов.

1.2 Методика позволяет получить из одной порции водно-спиртового раствора до 35 литров спирто-воздушной смеси заданного состава с массовыми концентрациями в диапазоне от 45 до 990 мг/м³ при температуре раствора (26 ± 0,2) °С – на генераторе ГС-1, до 40 литров смеси с аналогичными концентрациями при температуре раствора (34 ± 0,2) °С и относительной влажности газовой смеси не менее 95 % – на генераторе ГСВС-META-02M.

2 Подготовка водно-спиртовых растворов

2.1 Для приготовления водно-спиртовых растворов необходимы:

2.1.1 Ареометр без шара АОН-1 N8 ГОСТ 18481-81 (диапазон измерения 0,790 - 0,810 г/см³).

2.1.2 Пипетка мерная емкостью 1 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.

2.1.3 Пипетка мерная емкостью 5 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.

2.1.4 Пипетка мерная емкостью 10 мл, кл. 2, ГОСТ 20292-74.

2.1.5 Колба мерная емкостью 100 мл, 2-100-2, ГОСТ 1770-74.

2.1.6 Колба мерная емкостью 1000 мл, 2-1000-2, ГОСТ 1770-74.

2.1.7 Термометр лабораторный с ценой деления 0,1°С ГОСТ 28498-90.

2.1.8 Генератор ГС-1 ТУ 25-7557.002-86 или генератор ГСВС-META-02M ТУ 4381-043-21298618-2009.

2.1.9 Спирт этиловый (ректификат, высший сорт) ГОСТ 5962-67 или ГОСТ 18300-72.

2.1.10 Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72.

Примечание. Допускается использование других приборов и оборудования, метрологические характеристики которых не отличаются от приведенных.

2.2 Для приготовления водно-спиртовых растворов на генераторе ГС-1 необходимо:

2.2.1 Определить температуру этилового спирта и воды. Температура должна составлять (20±0,1) °С. При отклонении температуры жидкостей от указанной необходимо их охладить (подогреть).

зового сенсора, которые дополнительно дублируются свечением соответствующих светодиодов шкалы-линейки.

- после часа работы в проветренном помещении реальные показания прибора должны быть 0,0 % на индикаторе со свечением светодиода "0.0" ("чистый воздух");

- динамичное изменение показаний на индикаторе (рост показаний в %) и свечение соответствующих светодиодов линейки при поднесении сенсорного зонда к источнику паров этилового спирта и их динамичное восстановление (уменьшение) при последующей вентиляции (кондиционировании) (до 0.0% – "чистый воздух") – свидетельствуют о сохранении сенсором эксплуатационных свойств;

- постепенное восстановление показаний до значения "0.0" при проведении кондиционирования сенсора после длительного хранения прибора с сохранением динамических свойств (см. п. 4.1) может служить критерием достижения положительного результата кондиционирования.

3.2 Режимы настройки и калибровки прибора "Алконт 01су"

Режимы настройки и калибровки прибора "Алконт 01су" защищены от несанкционированного доступа и требуют использования программы поддержки, с помощью которой и осуществляется связь прибора с персональным компьютером.

Программа поддержки «Alcont.exe» размещена на сайте производителя www.alcont.brest.by.

Для работы программы должен быть установлен драйвер виртуального COM-порта (USB-SERIAL CH340). Для операционных систем Windows 8 и выше такая установка производится автоматически (при условии подключения к сети Internet). Для операционных систем Windows 7 и ниже необходимо установить драйвер самостоятельно. Консультации можно получить у производителя по электронной почте (e-mail: microt@brest.by) или использовать программное обеспечение, размещённое на сайте www.alcont.brest.by.

Посредством компьютера реализуются все режимы контроля, настройки и калибровки (см. раздел 9 формуляра).

листу ориентироваться в состоянии испытуемого;

- окончательное заключение о степени алкогольного опьянения принимает только эксперт-нарколог, учитывающий разнообразие реакций на алкоголь у отдельных лиц, наличие клинических синдромов опьянения.

2 Факторы, влияющие на точность освидетельствования с помощью прибора «Алконт 01су»

При исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь нередко допускаются ошибки. Чаще всего они обусловлены неточным выполнением методики исследования (см. ниже). Кроме того, имеется ряд обстоятельств объективного характера, способных существенно влиять на конечный результат.

2.1 Ошибочный результат исследования может быть получен за счет небольших количеств алкоголя, адсорбировавшегося на слизистой оболочке рта и глотки при употреблении непосредственно перед исследованием спиртосодержащих лекарств. Так, при употреблении небольших количеств подобных препаратов адсорбированный алкоголь выделяется с выдыхаемым воздухом в течение 10 - 20 минут в значительных количествах. Это же относится к непосредственному употреблению алкогольных напитков. В целях повышения точности измерений, необходимо, чтобы с момента последнего приема алкоголя прошло не менее 20 минут.

2.2 Ошибка может быть обусловлена наличием в полости рта либо в окружающем воздухе примесей редуцирующих веществ. Например, наличие в окружающем воздухе значительных концентраций ацетона, бензина, ряда растворителей, выхлопных газов может воздействовать на чувствительный элемент сенсора и искажать результаты исследования. В течение 3 - 5 минут после курения на результаты пробы могут оказывать влияние выделяющиеся из дыхательных путей летучие соединения углерода.

2.3 Для получения воздуха из глубины легких испытуемый должен выдохнуть определенное минимальное количество воздуха. Только в этом случае полученные результаты совпадут с результатом анализа крови на алкоголь. На практике установлено, что минимальный объем анализируемого выдыхаемого воздуха должен составлять не менее 1,2 литров. При слишком слабом, коротком или прерывистом поступлении воздуха, исследование должно быть проведено повторно. Следует учитывать, что задержка дыхания на входе в течение 20 секунд может давать увеличение показаний до 50 % от содержания алкоголя, определяемого на фоне спокойного дыхания. После гипервентиляции и при учащенном поверхностном дыхании показания могут уменьшаться до 12 %.

3 Порядок работы с прибором "Алконт 01су" при исследовании выдыхаемого испытуемым воздуха

3.1 Помещение, в котором проводятся исследования, должно быть проветрено, посторонние запахи органических веществ (растворителей и т. п.)

3.2 Оператор включает прибор согласно формуляру изделия и приводит его в режим готовности.

3.3 Испытуемый опрашивается об употреблении перед исследованием спиртосодержащих лекарств, курении. Необходимо, чтобы от момента курения до исследования прошло не менее пяти минут, с момента последнего приема спиртосодержащих жидкостей – не менее двадцати минут.

3.4 В зависимости от конкретных обстоятельств и состояния испытуемого эксперт (оператор) принимает решение по проведению теста, инструктирует обследуемого и устанавливает готовность прибора к выполнению теста.

3.5 Исследование проводить в положении испытуемого сидя, на фоне спокойного дыхания.

3.6 У лиц, страдающих сахарным диабетом, «ацетоновое» дыхание может вызывать ложные показания приборов.

3.7 Это же необходимо учитывать при обследовании лиц, находящихся в состоянии продолжительного голодания (как правило, свыше 7 дней).

4 Порядок проведения теста

4.1 Испытуемый извлекает (получает) стерильный сменный мундштук индивидуального пользования из упаковки, стыкует его короткой частью с сенсорным зондом.

4.2 Получив указание оператора, установившего готовность к тесту, обследуемый, зажав мундштук губами и удерживая зонд любой рукой, делает через него один полный плавный энергичный выдох длительностью не менее трех секунд. После завершения выдоха освободить губы от мундштука и продолжать обычное дыхание. Конечный результат фиксируется на индикаторе прибора с выдачей звукового сигнала.

4.3 При неправильных действиях испытуемого – тест следует повторить.

4.4 После окончания теста мундштук отделяется от сенсорного зонда. Снятый сменный мундштук после разового использования подлежит дезинфекции. Дезинфекцию производить кипячением в дистиллированной воде не менее тридцати минут с последующей сушкой или другим способом в соответствии с санитарными правилами по осуществлению дезинфекционной деятельности (Приказ Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 25.11.2002 г. № 165 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждений здравоохранения», приложение 3 (Инструкция «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения»).

МЕТОДИКА

технического контроля, калибровки и настройки прибора «Алконт 01су»

1 Условия проведения технического контроля, калибровки и настройки

Технический контроль, калибровку и настройку производить при следующих нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность (60 ± 15) %;
- атмосферное давление ($101,3 \pm 4$) кПа;
- напряжение питания:
- переменного тока – 230 В (+6 % -10 %), (50 ± 1) Гц;
- постоянного тока – ($12,6 \pm 2$) В.

Работы должны проводиться в проветренном (вентилируемом) помещении.

2 Подготовка к проведению работ

2.1 Перед проведением работ ознакомиться с настоящим ФОРМУЛЯРОМ.

2.2 Технические средства контроля разместить в непосредственной близости от прибора (персональный компьютер).

2.3 Перед началом работ рекомендуется включить прибор и выдержать его в рабочем состоянии не менее 1 часа.

2.4 Достижение полноты диагностической картины, проведение настройки, калибровки прибора обеспечивается подключением его к USB-порту персонального компьютера и использованием программы поддержки.

3 Технический контроль состояния системы прибора «Алконт 01су».

Контроль состояния системы, возможные неисправности и способы их устранения достаточно подробно освещены в разделе 9 настоящего формуляра. Ниже пойдет речь о специальных режимах работы прибора, о которых в разделе 9 упоминалось в сжатом виде.

3.1 Контроль состояния газового сенсора.

3.1.1 Включить прибор в режиме "Проверка", т. е. включить его, предварительно переведя правый переключатель в положение "ТЕСТ". На индикаторе будут отображаться значения, эквивалентные степени "загрязненности" га-