

Информация по


Модель

автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
СМА, модель 2 (В)


Устройство, транспортируемое
в комплекте для
плазмафереза
ТУ 9444-029-70440344-2016
04-2021




вариант исполнения: Система, модель 2 (В)




Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 3 (В)

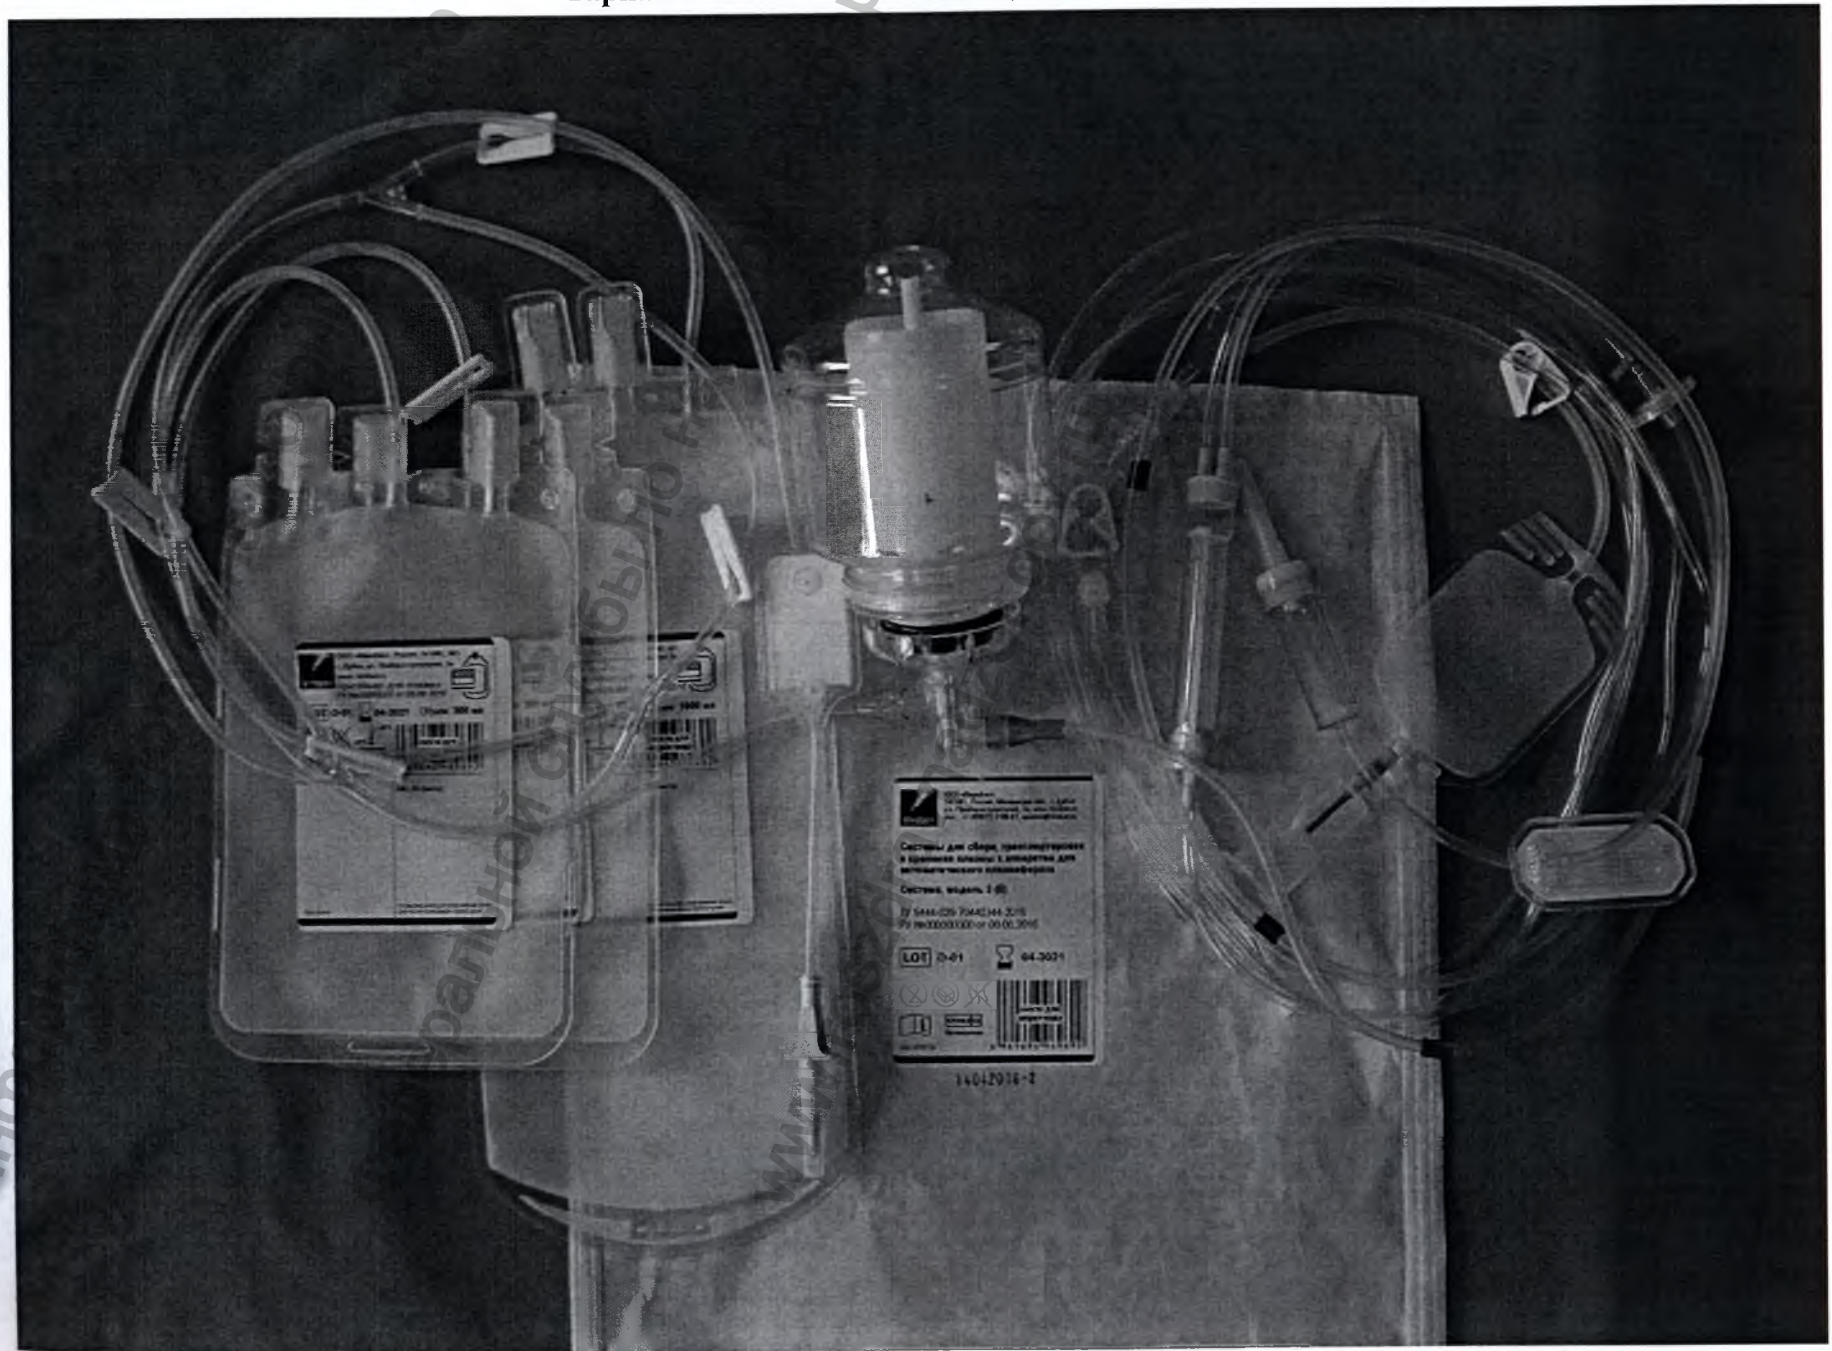


Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 4 (В)

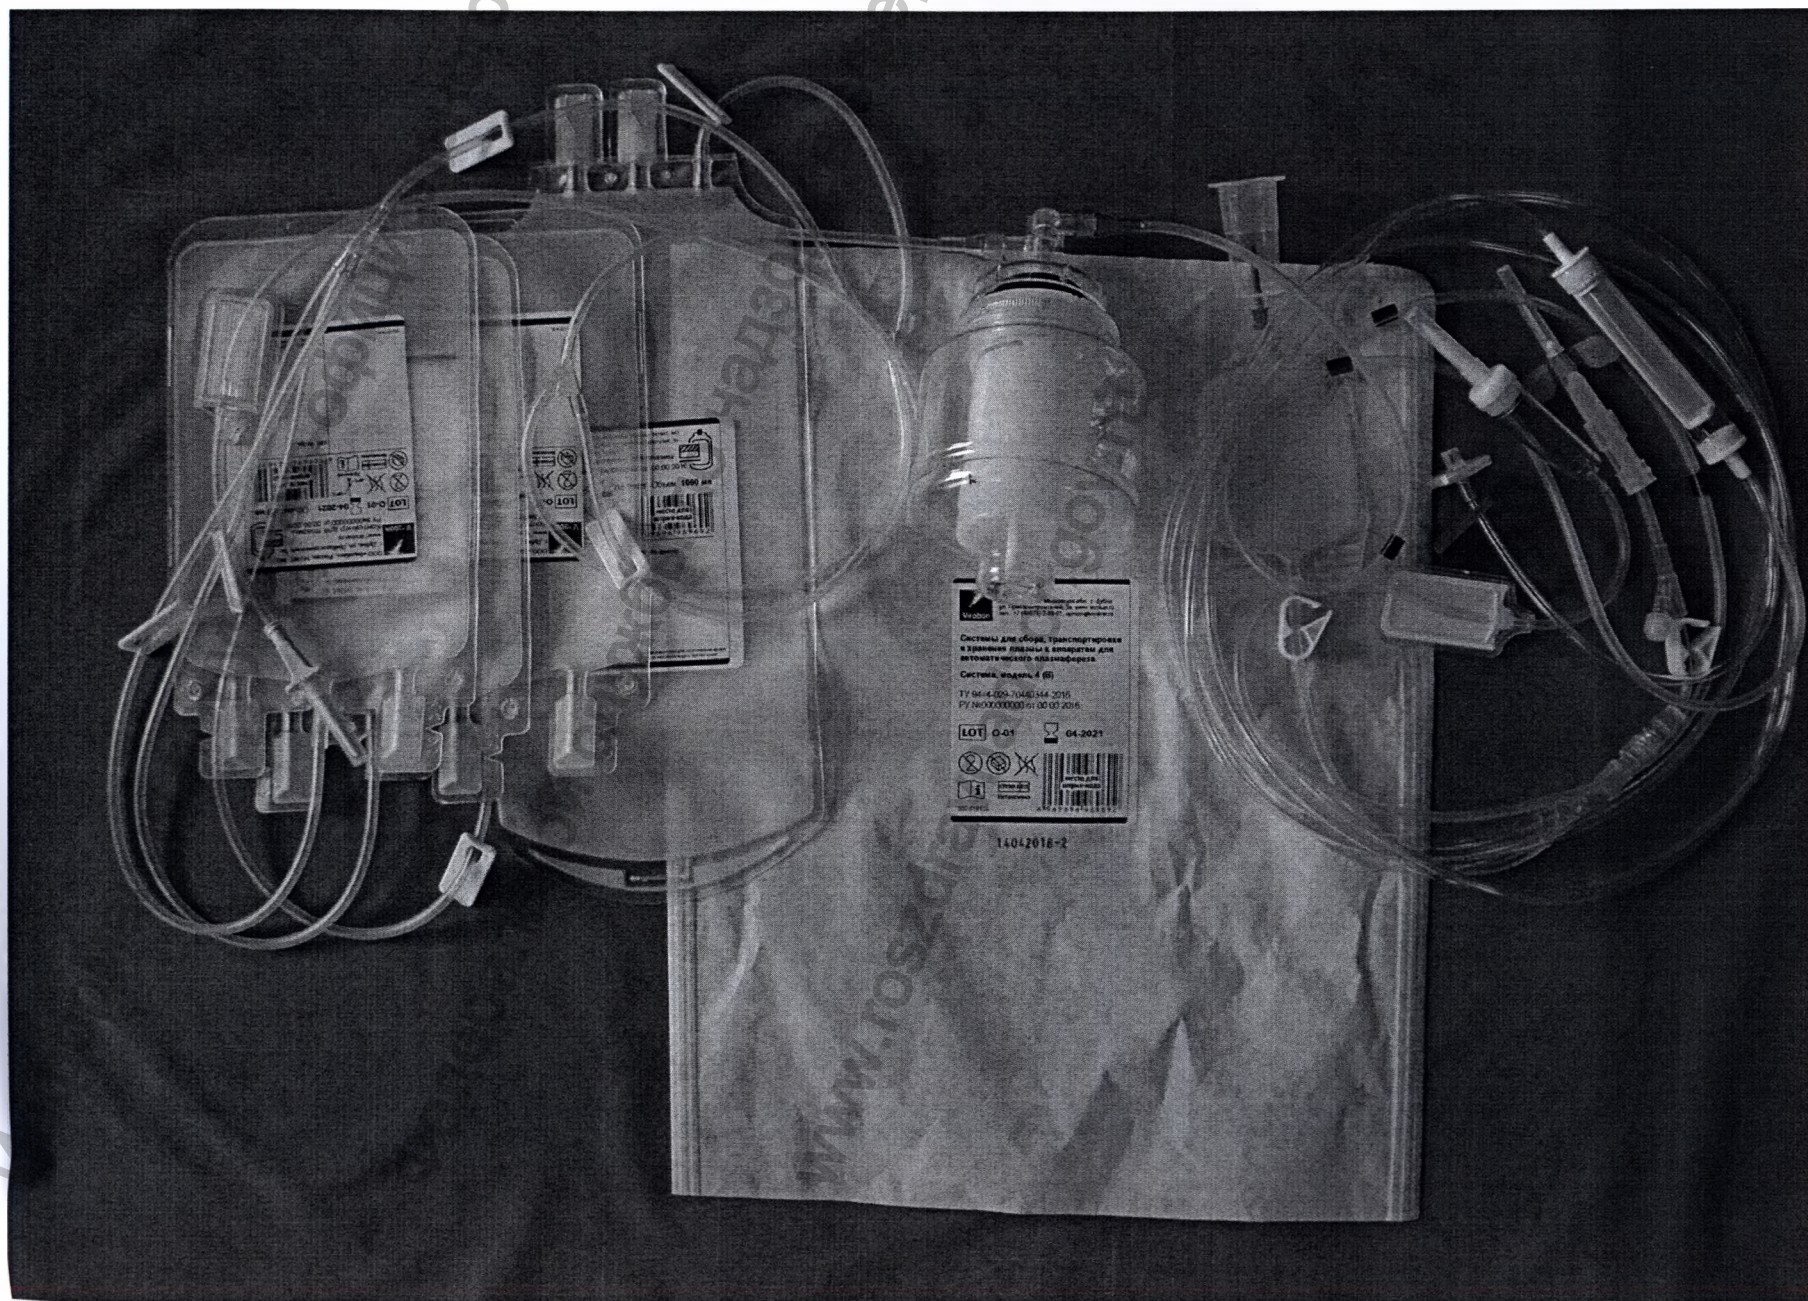


Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 5 (В)

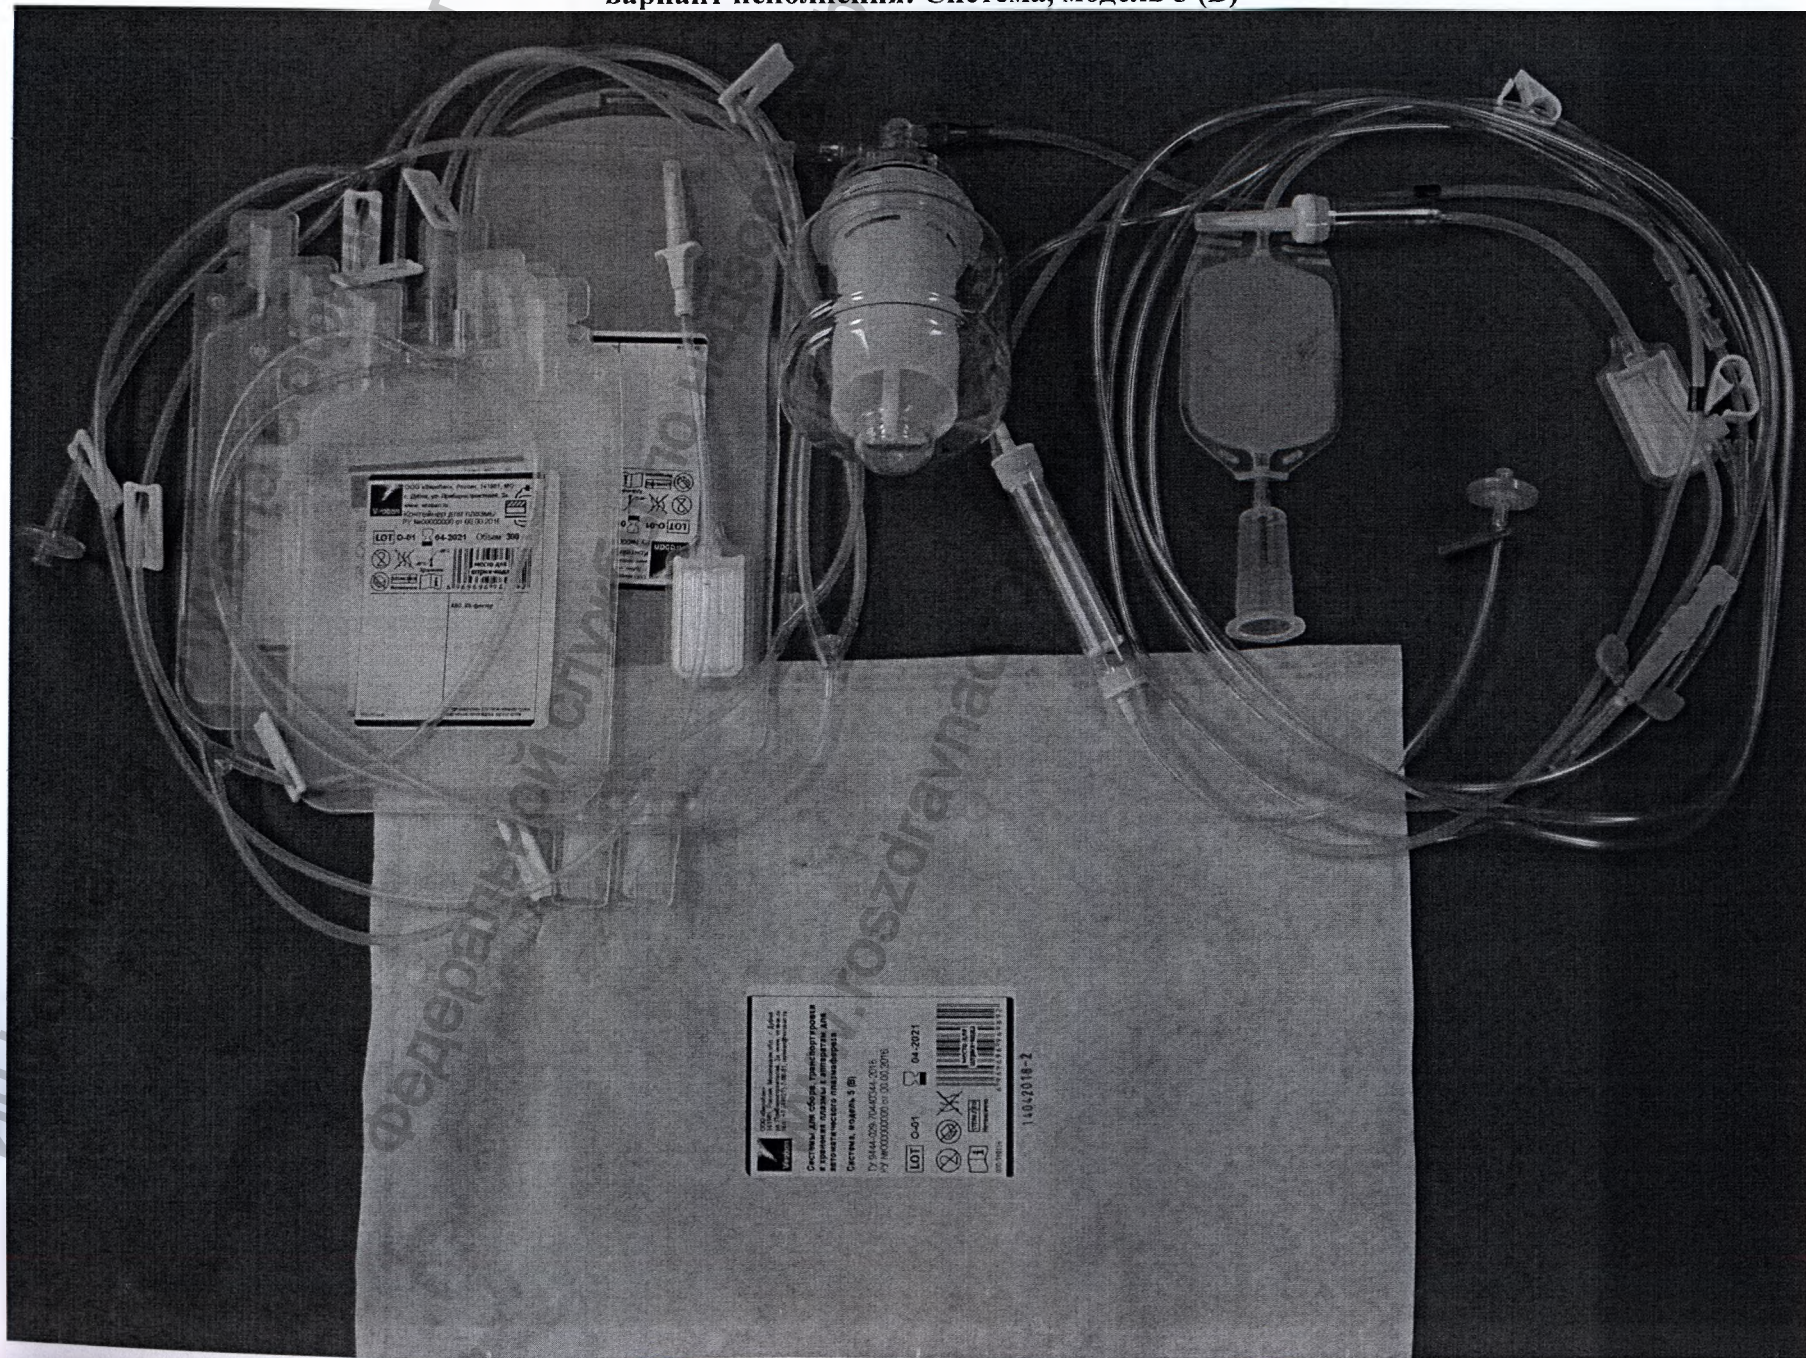


Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 1 (HS)

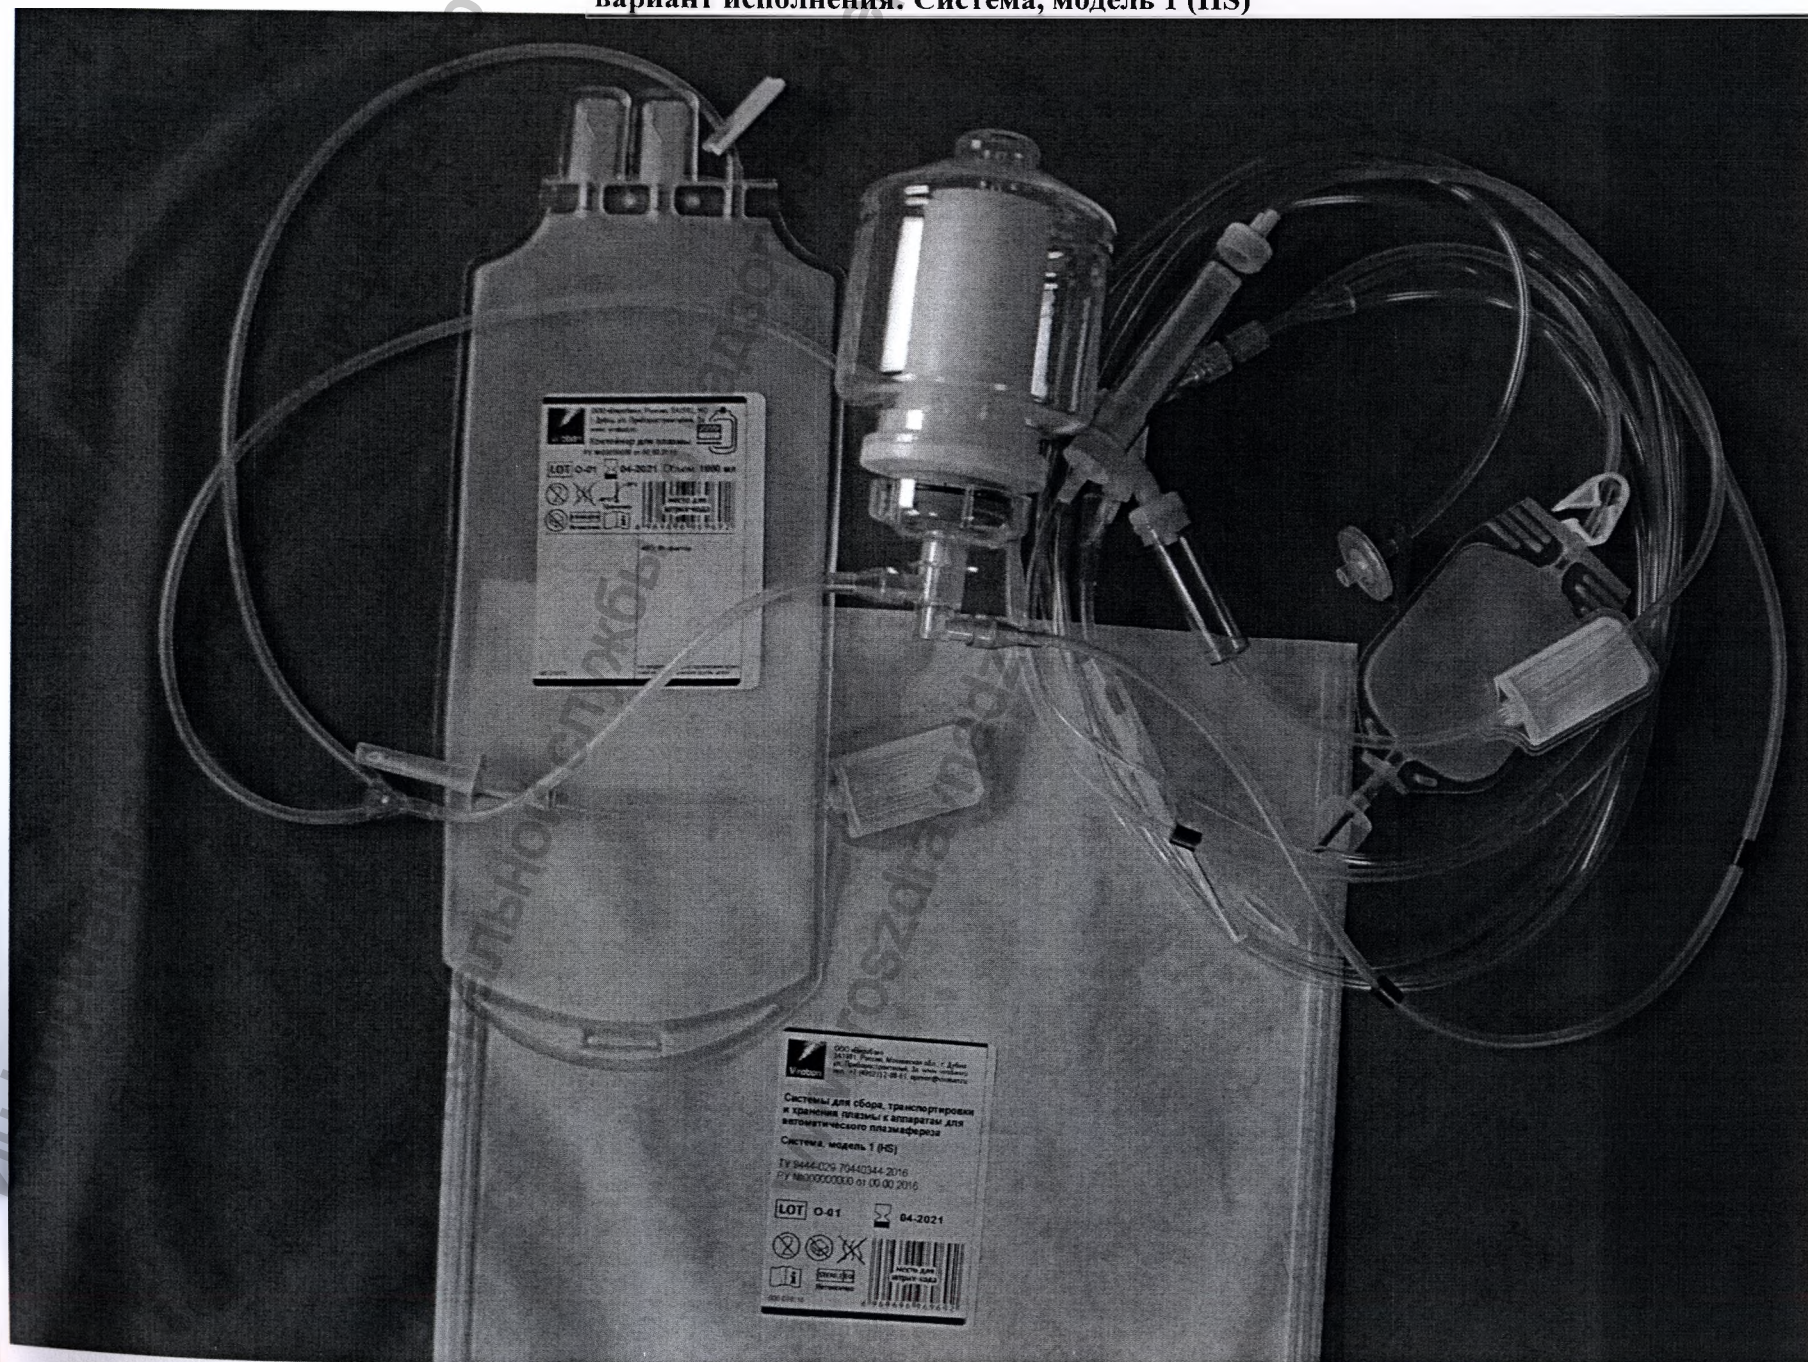


Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 2 (HS)

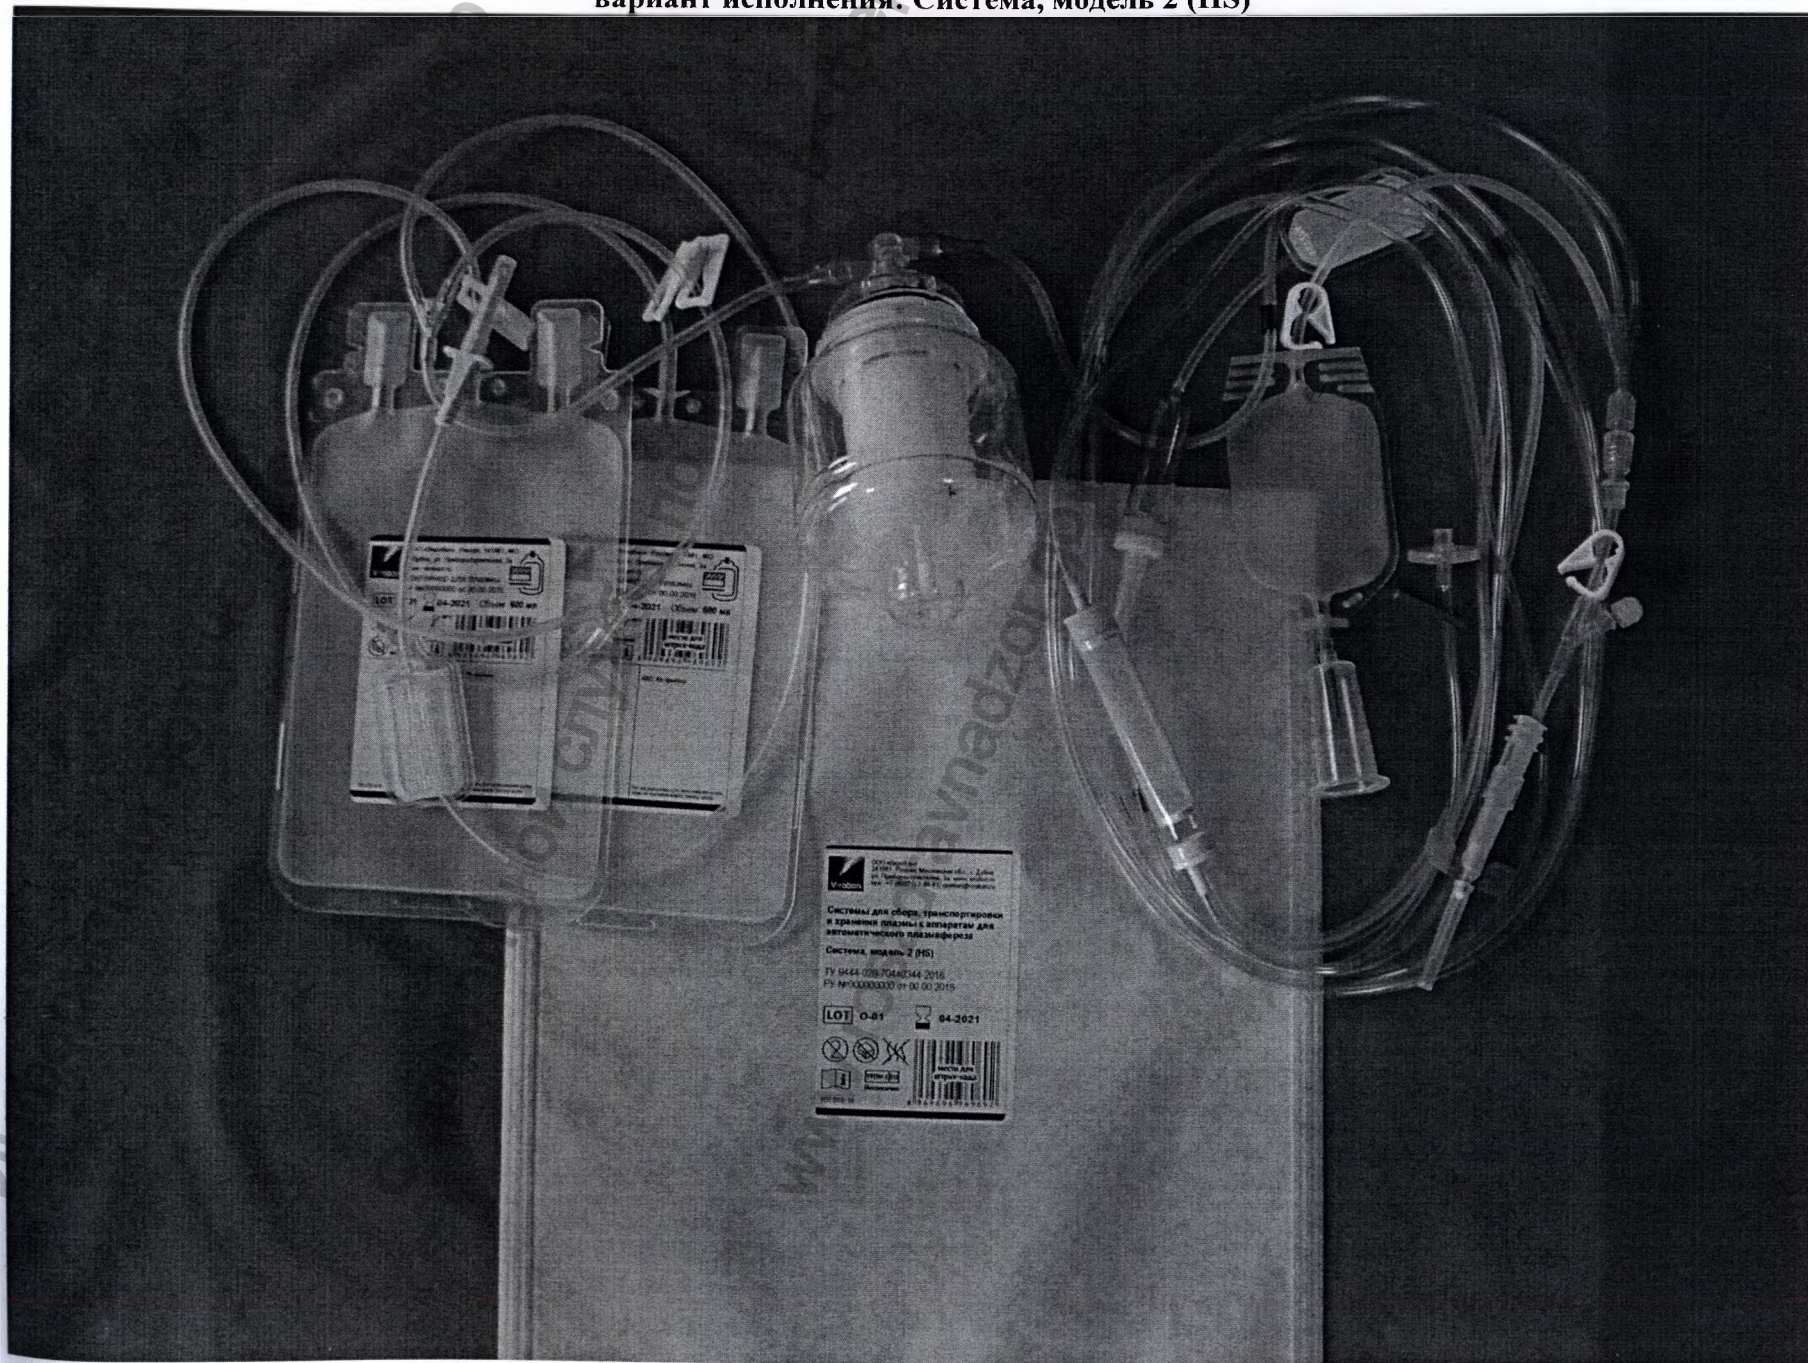


Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 3 (HS)

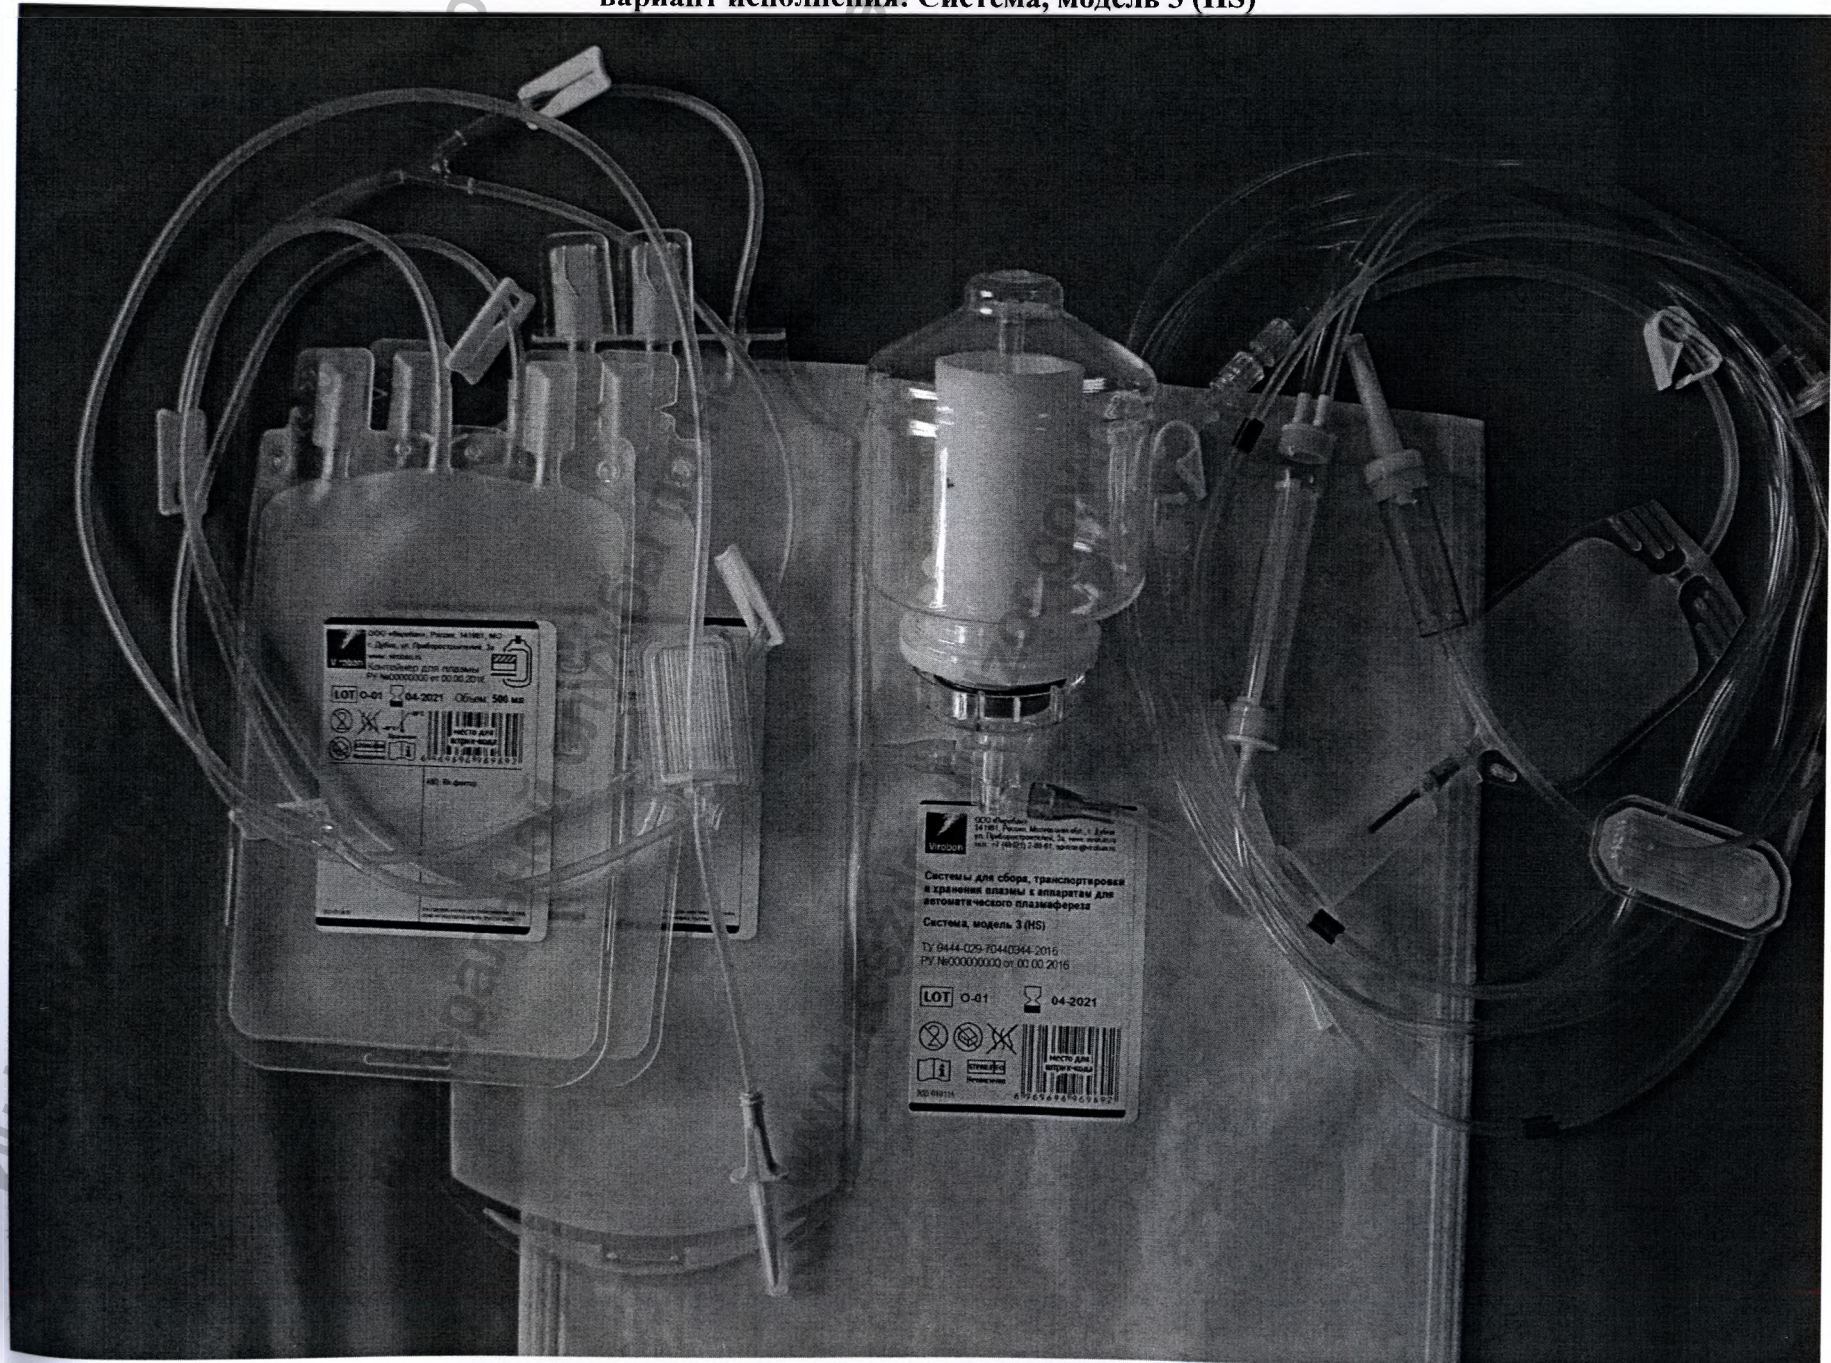


системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 4 (HS)

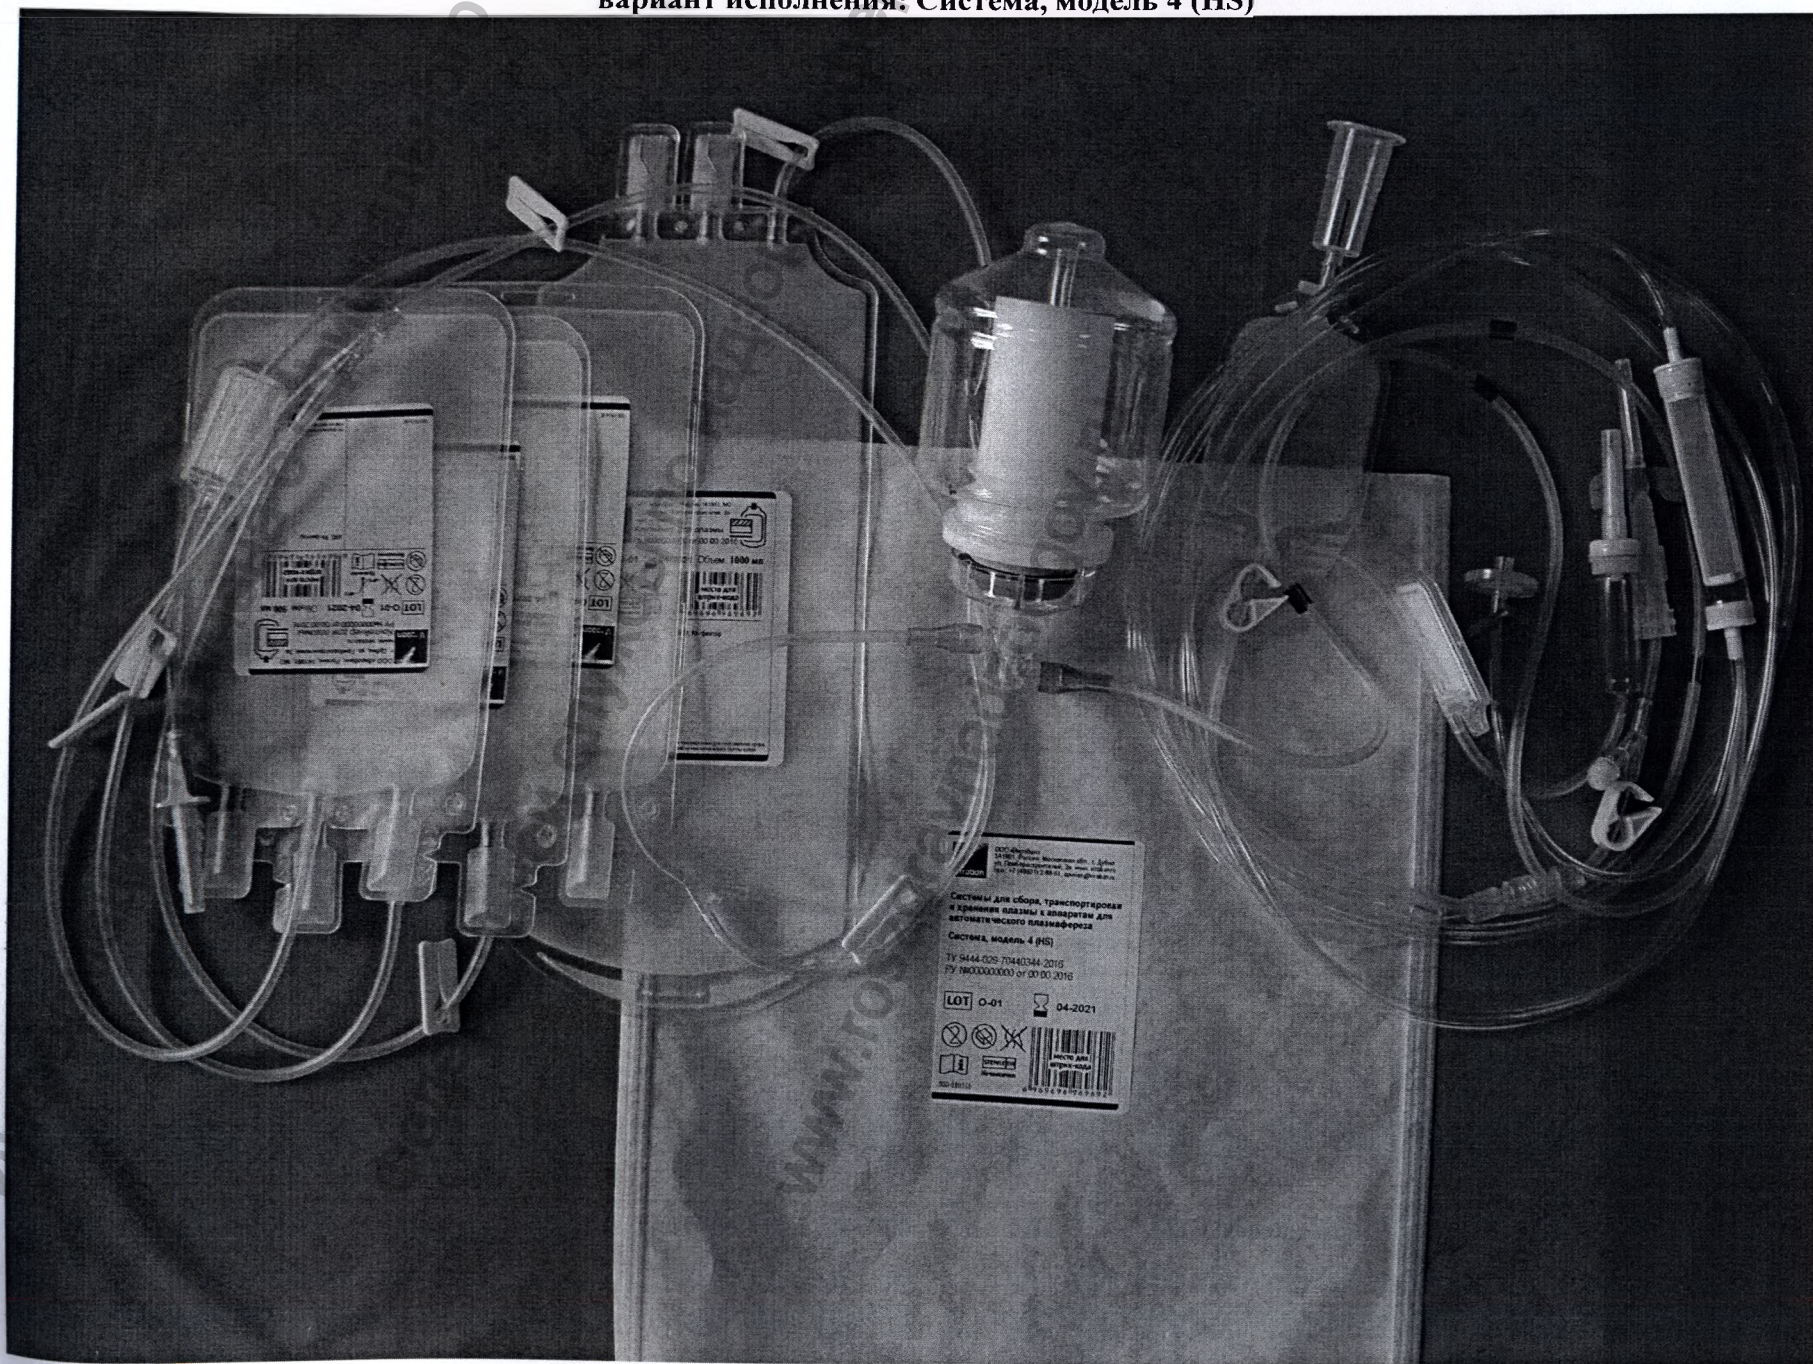


Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 5 (HS)

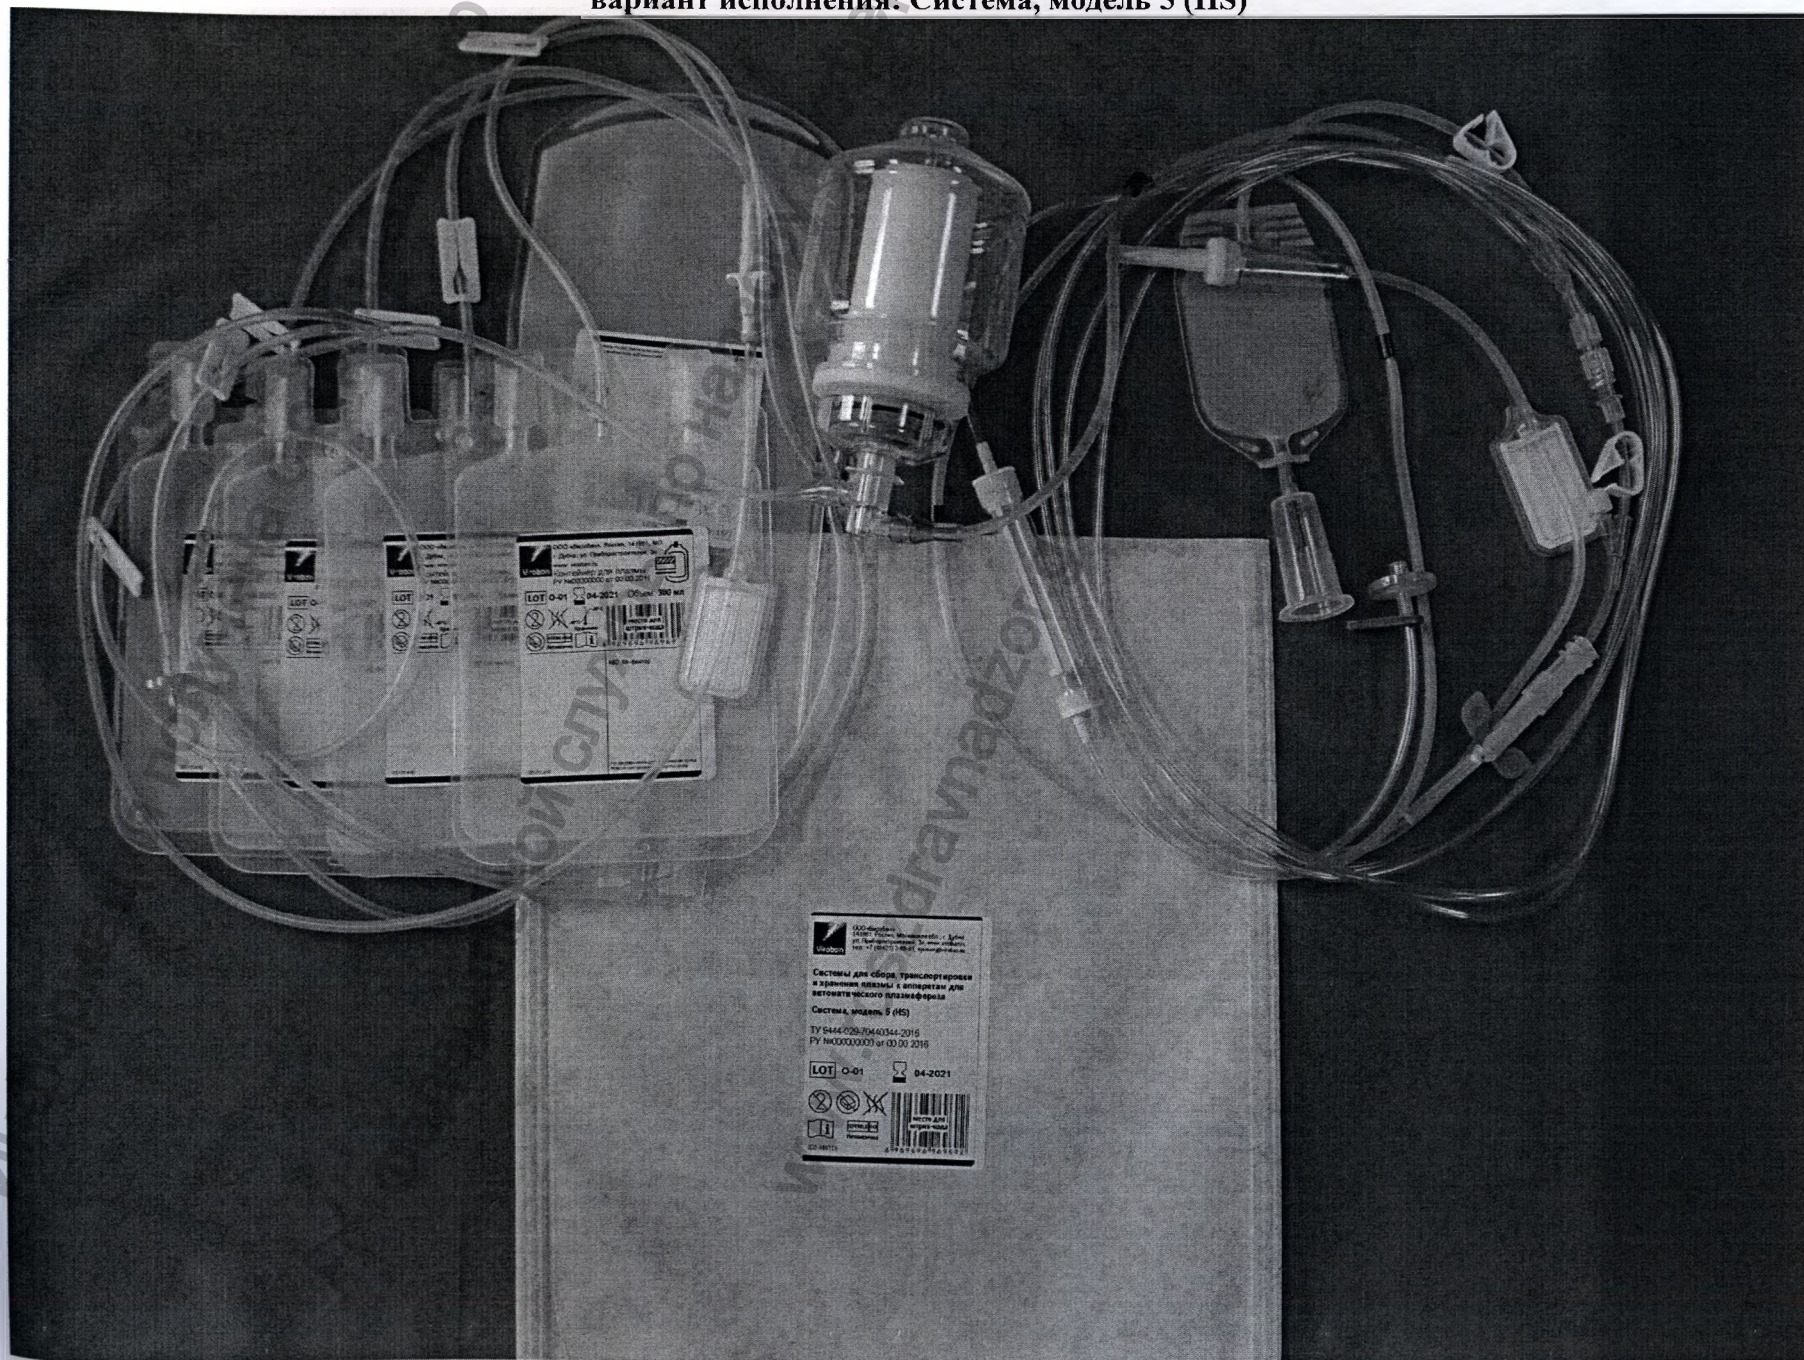

Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 1 (В, РП)

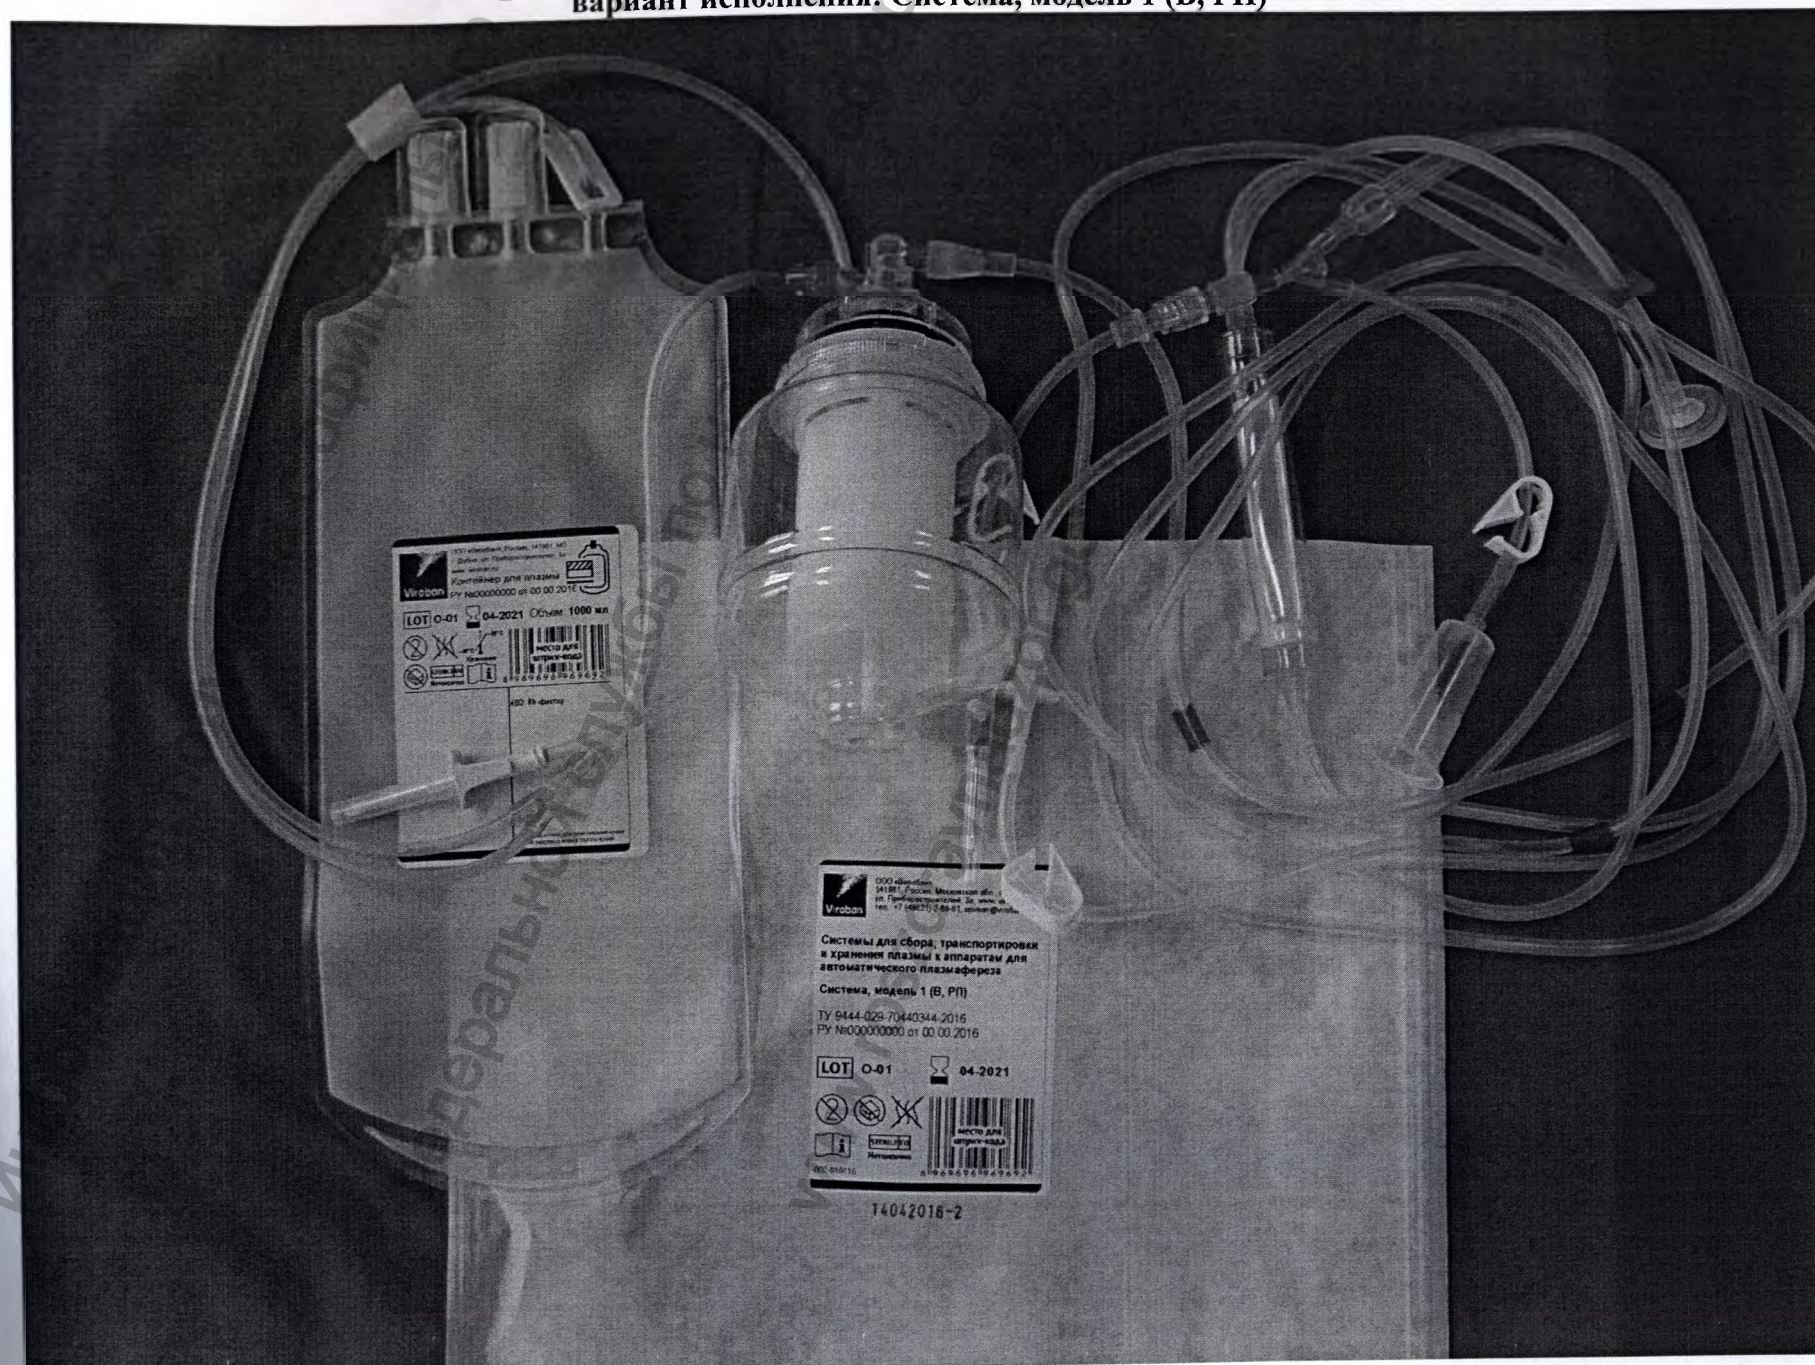

Системы для сбора, транспортировки и хранения плазмы к аппаратам для автоматического плазмафереза по ТУ 9444-029-70440344-2016
вариант исполнения: Система, модель 1 (HS, РП)

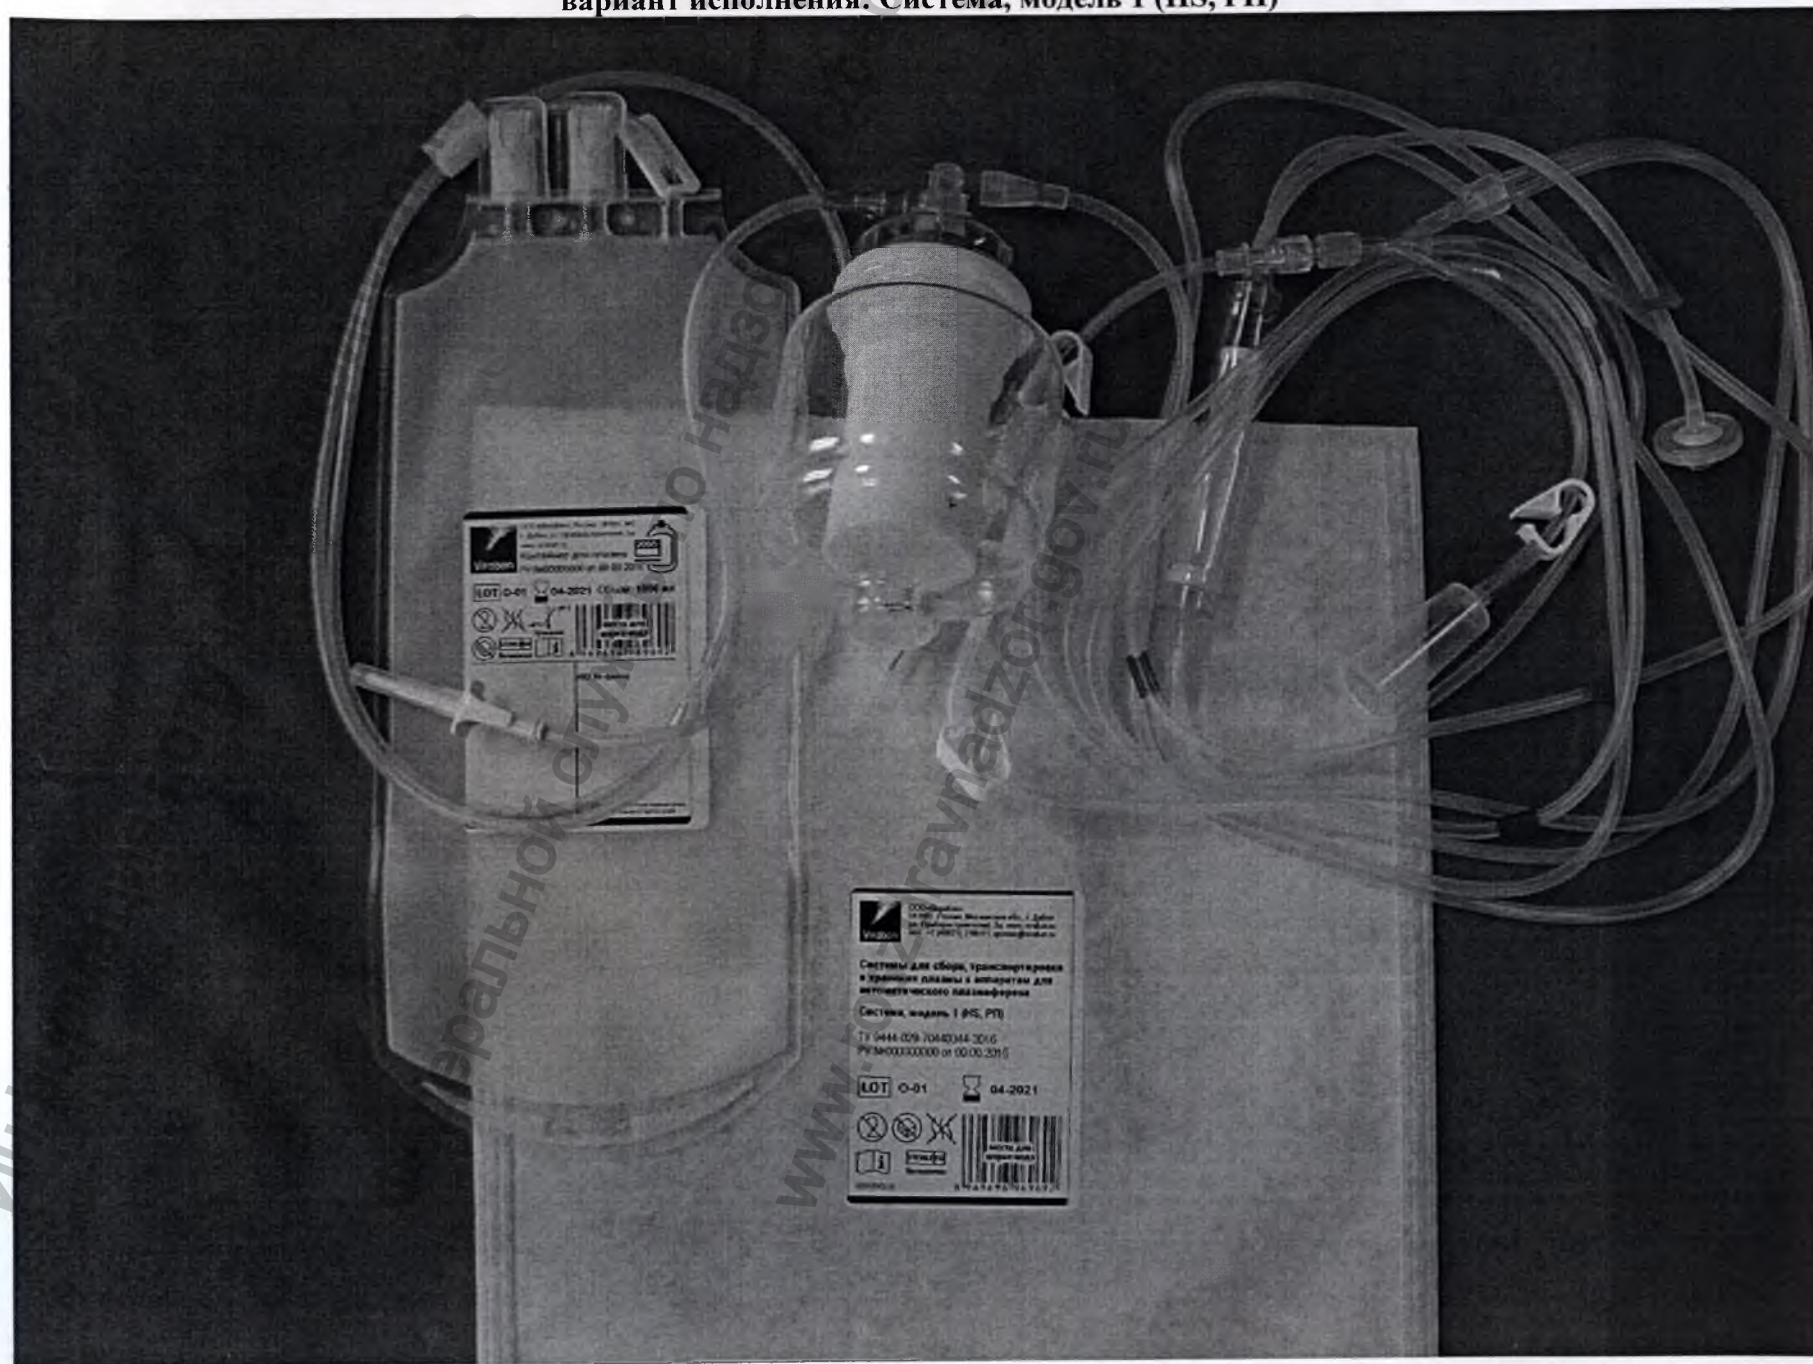

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Виробан»

12 л. (Внешняя часть)

Генеральный директор ООО «Виробан»

В. В. Николаев



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.roszdravnadzor.gov.ru