

Информация получена с официального

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.gov.ru

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.**

Технические условия

ТУ 33.10.14-003-84354588-2017

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА С ОФИЦИАЛЬНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
www.government.ru

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (белый).


Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медлак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.
Тел: (495) 645-04-74.
Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
Объем – 4,5 л.
Номинальная нагрузка – 8,0 кг.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
375х205х130
Номер партии: МП-03-4,5-1117
Дата изготовления: 24.11.2017
РУ № _____
СС № _____

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Изделие в сборе)



МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение основного контейнера)

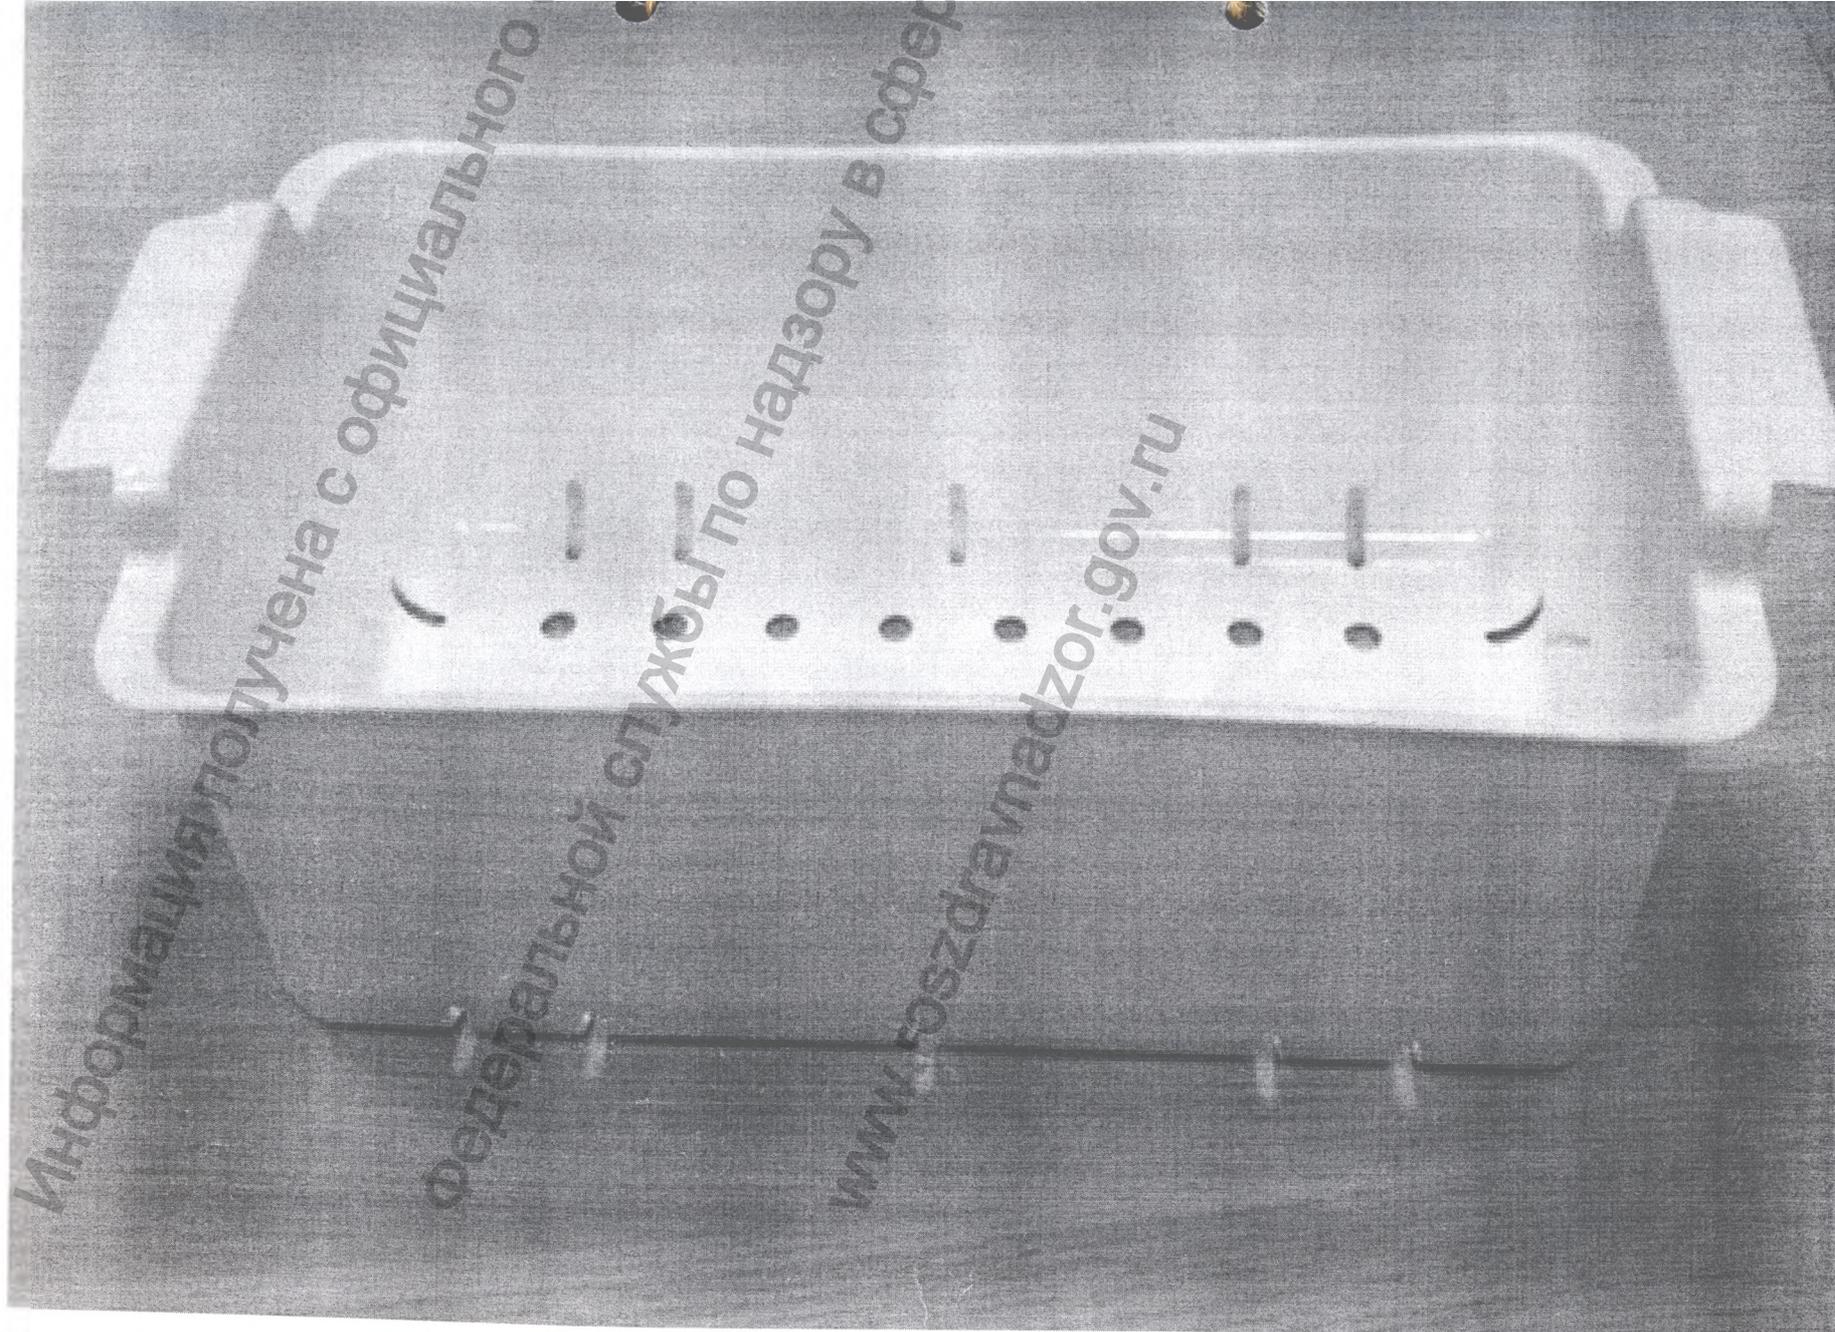


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение перфорированного контейнера- вкладки)



МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5


л. (Фотографическое изображение крышки контейнера)

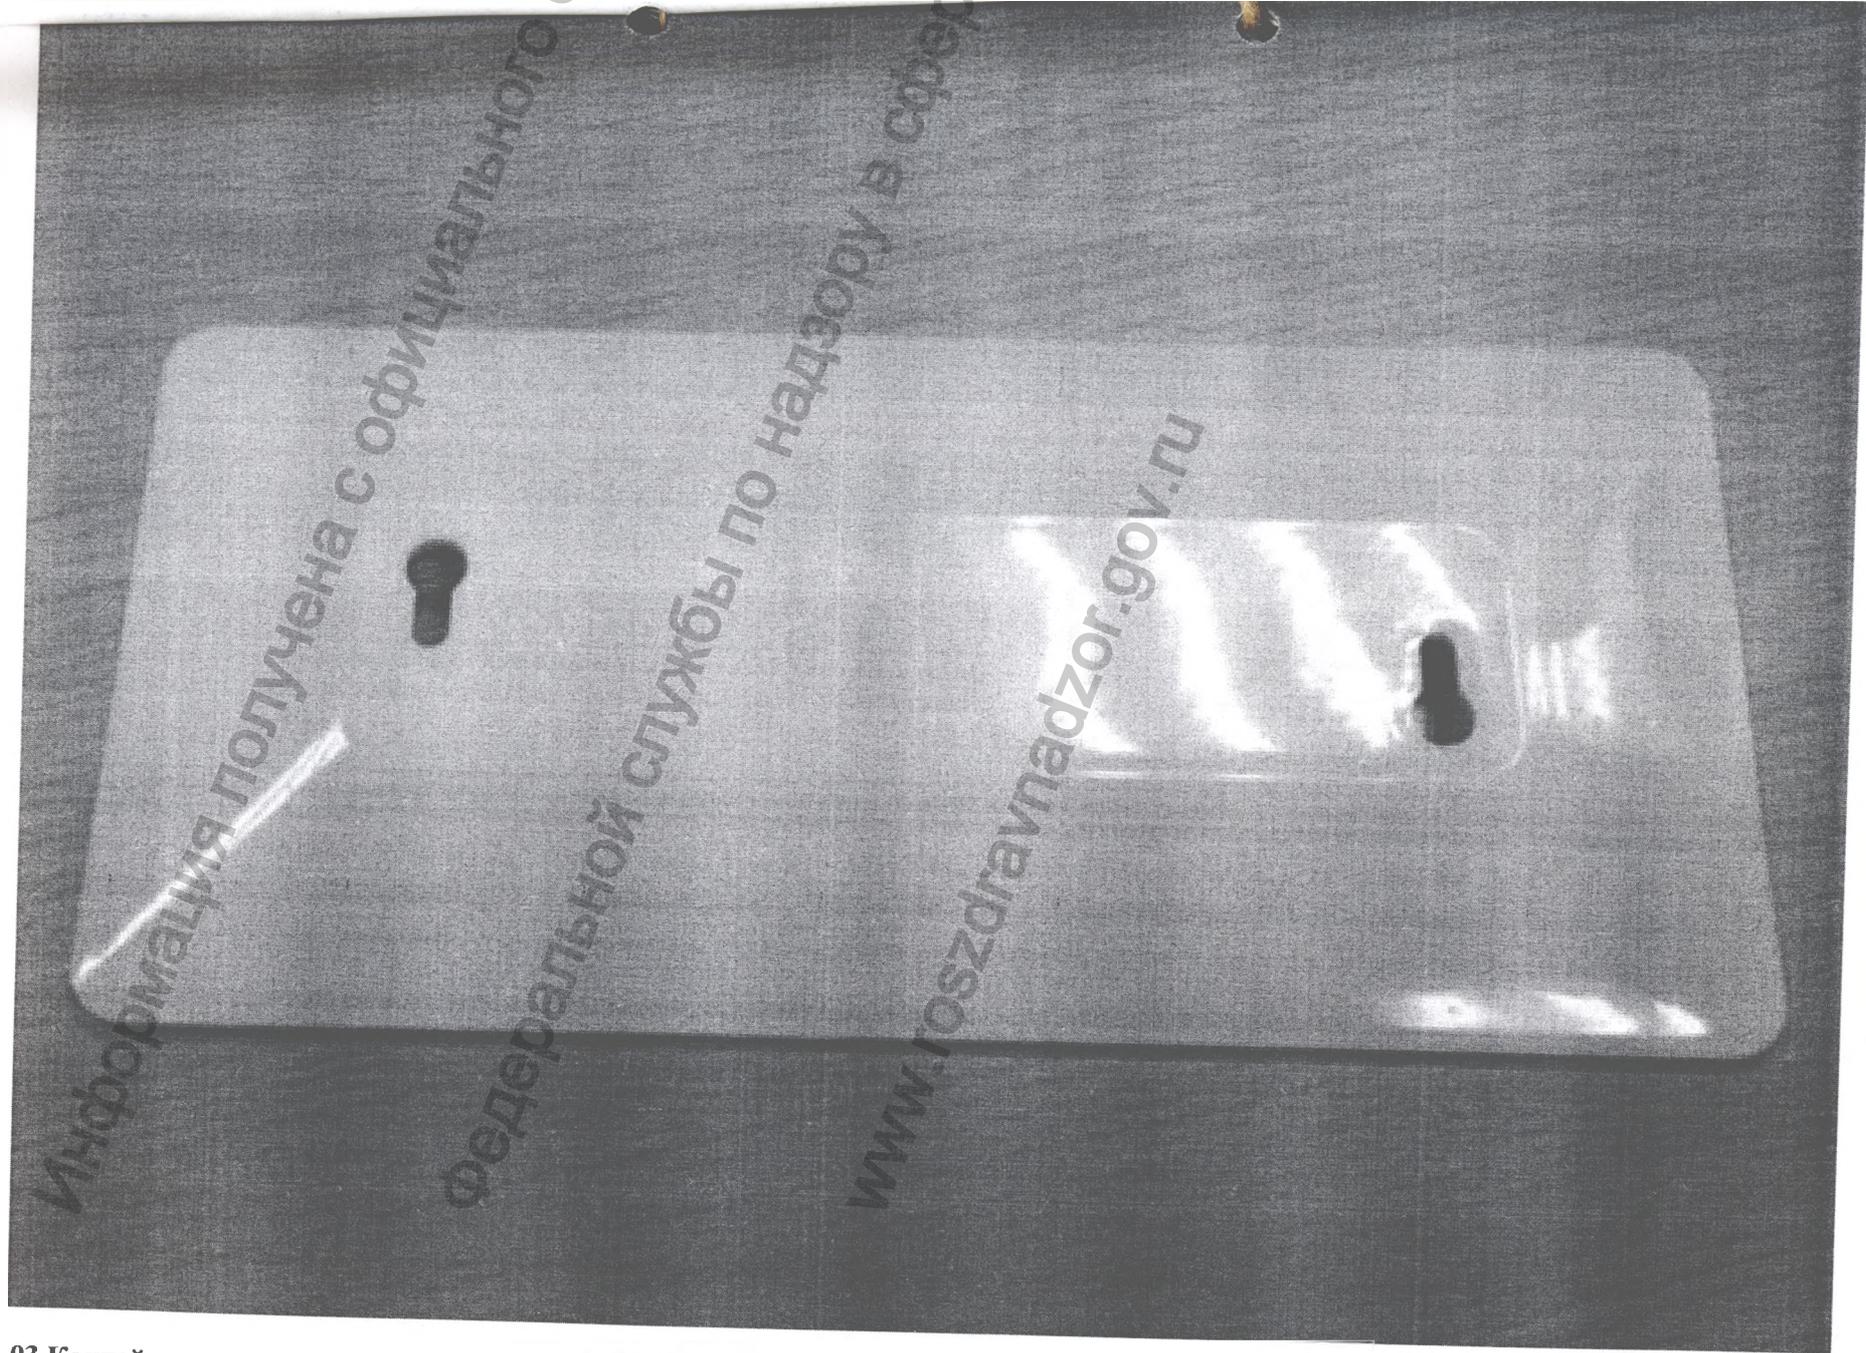


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение пресса контейнера)



МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л (Фотографическое изображение ручки контейнера)

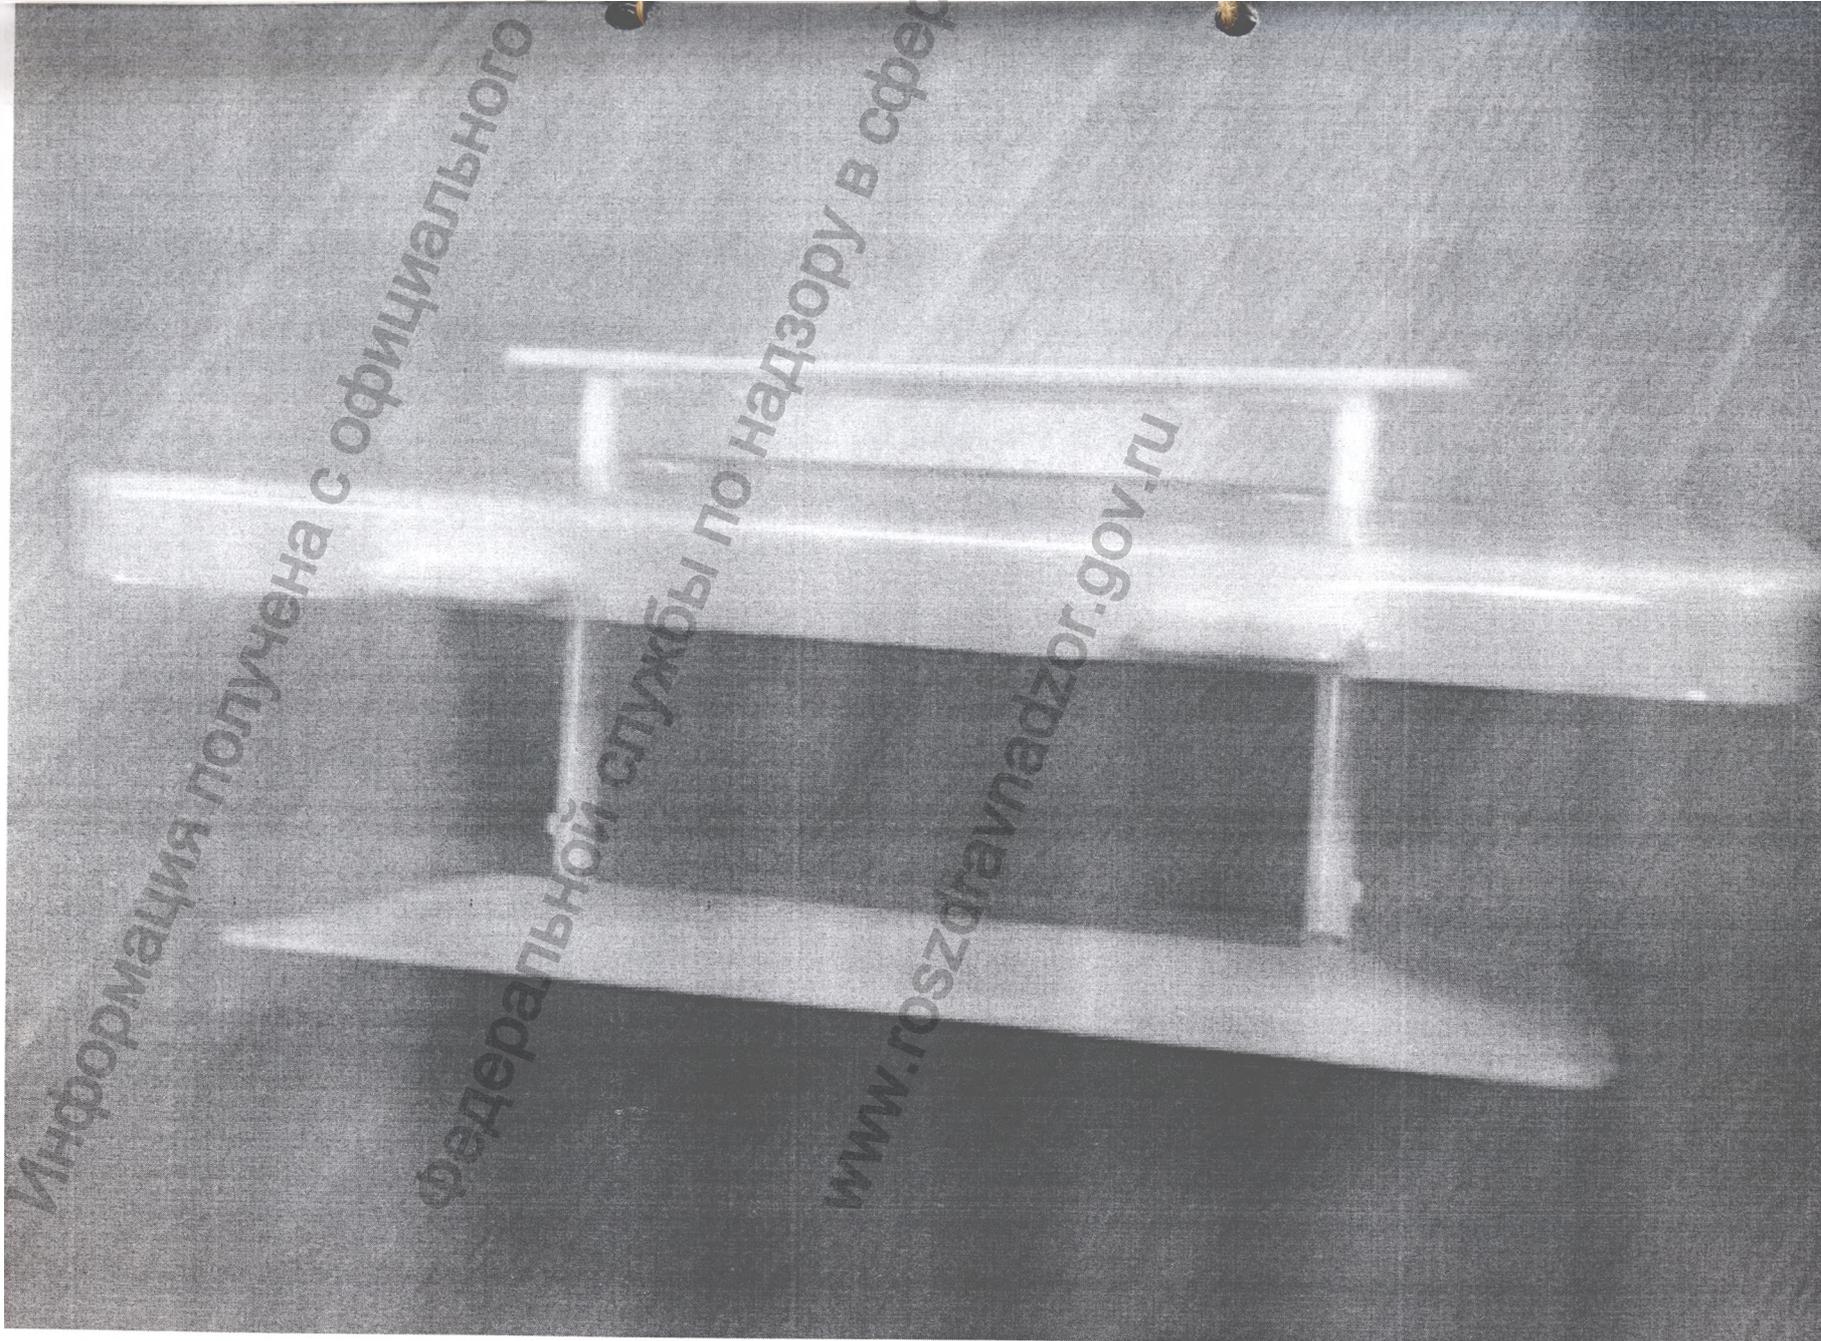


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)

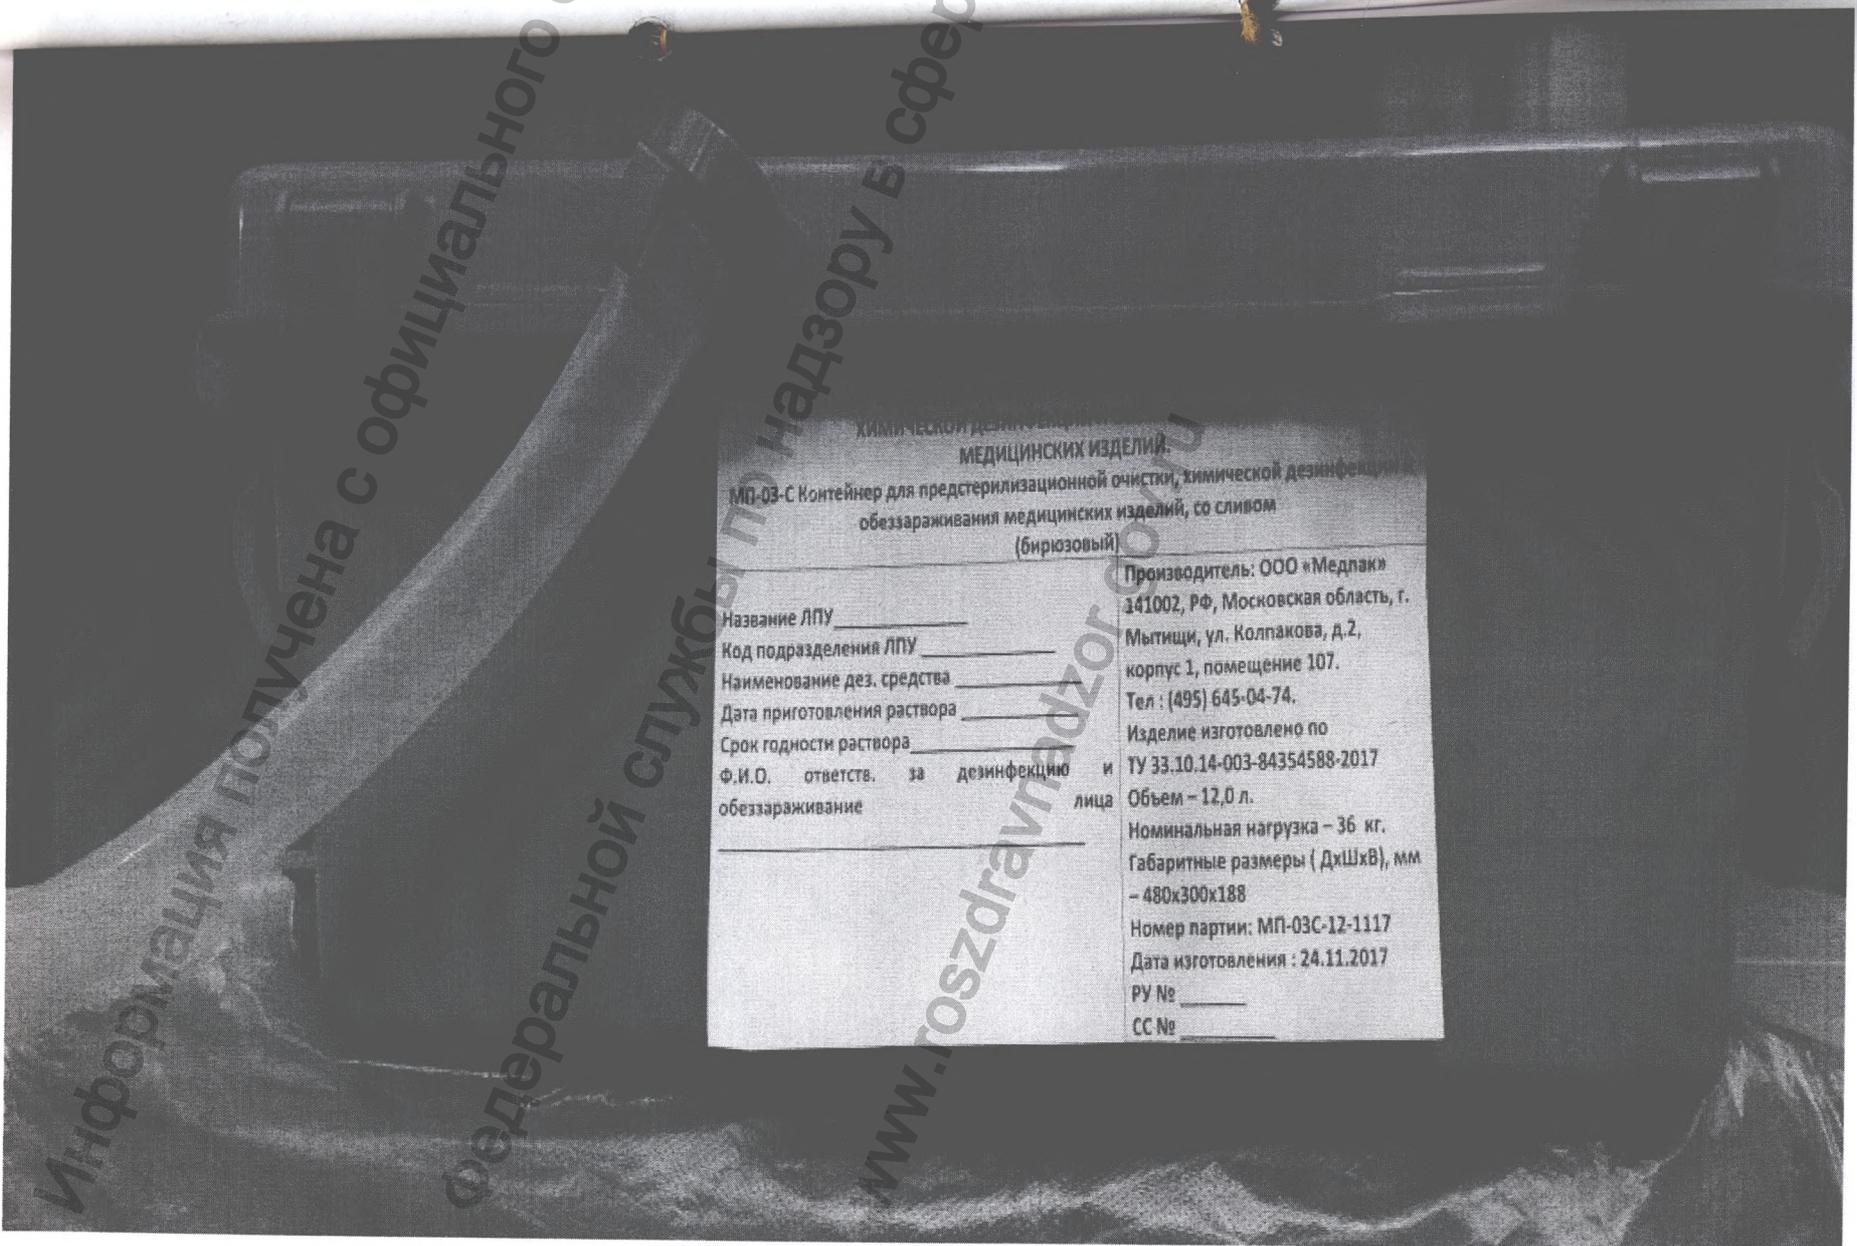


ХИМИЧЕСКОЙ ДИЗИНФЕКЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, со сливом
(бирюзовый)

Название ЛПУ _____	Производитель: ООО «Медлак»
Код подразделения ЛПУ _____	341002, РФ, Московская область, г.
Наименование дез. средства _____	Мытищи, ул. Колпакова, д.2,
Дата приготовления раствора _____	корпус 1, помещение 107.
Срок годности раствора _____	Тел : (495) 645-04-74.
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и обеззараживание _____ лица	Изделие изготовлено по ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
	Объем – 12,0 л.
	Номинальная нагрузка – 36 кг.
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – 480x300x188
	Номер партии: МП-03С-12-1117
	Дата изготовления : 24.11.2017
	РУ № _____
	СС № _____


МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой), объемом 7,5 л. (Изделие в сборе)

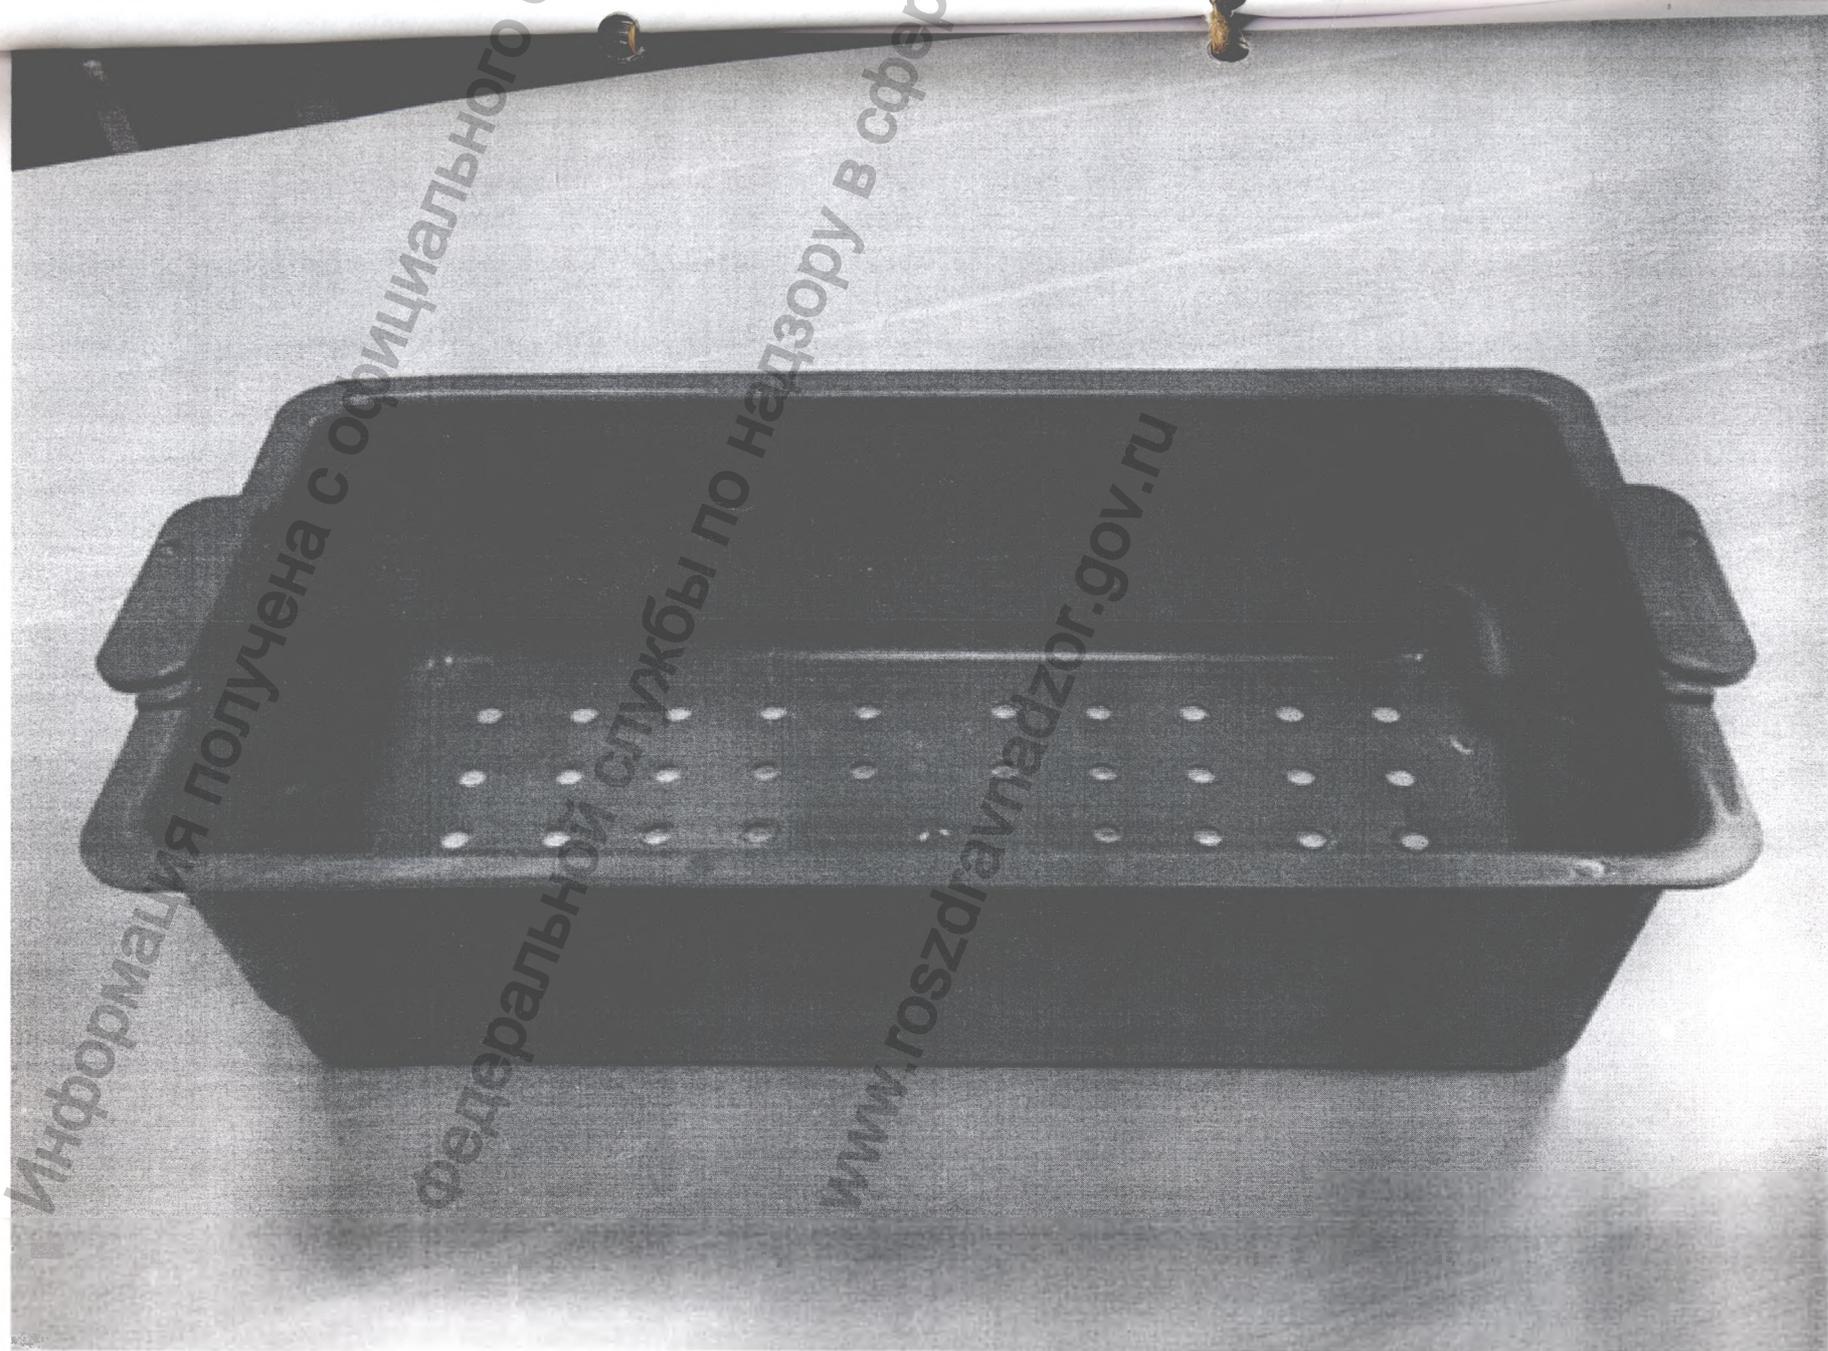

МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой) (Фотографическое изображение перфорированного контейнера-вкладки)

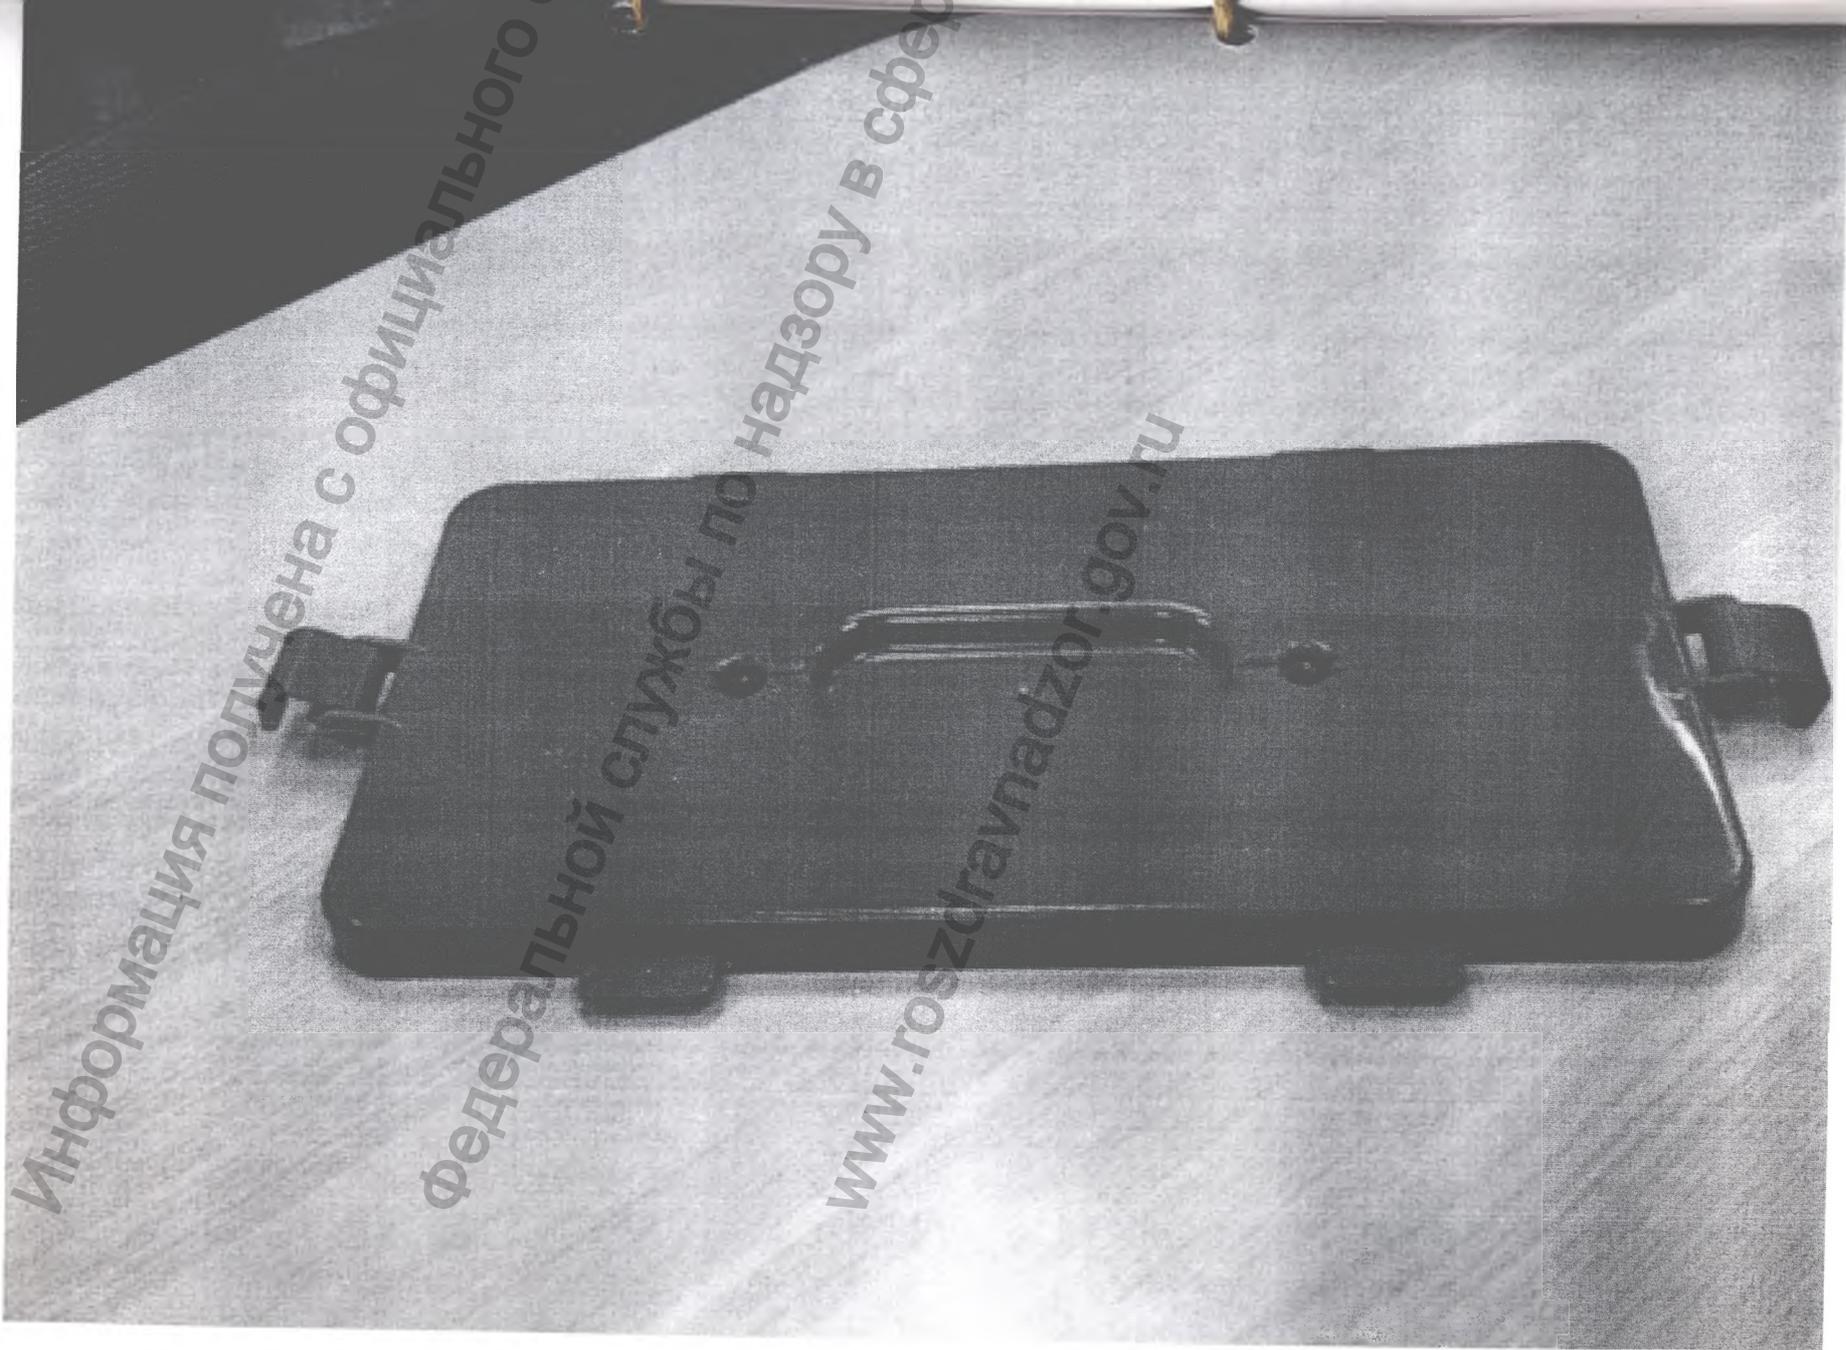


МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение крышки)

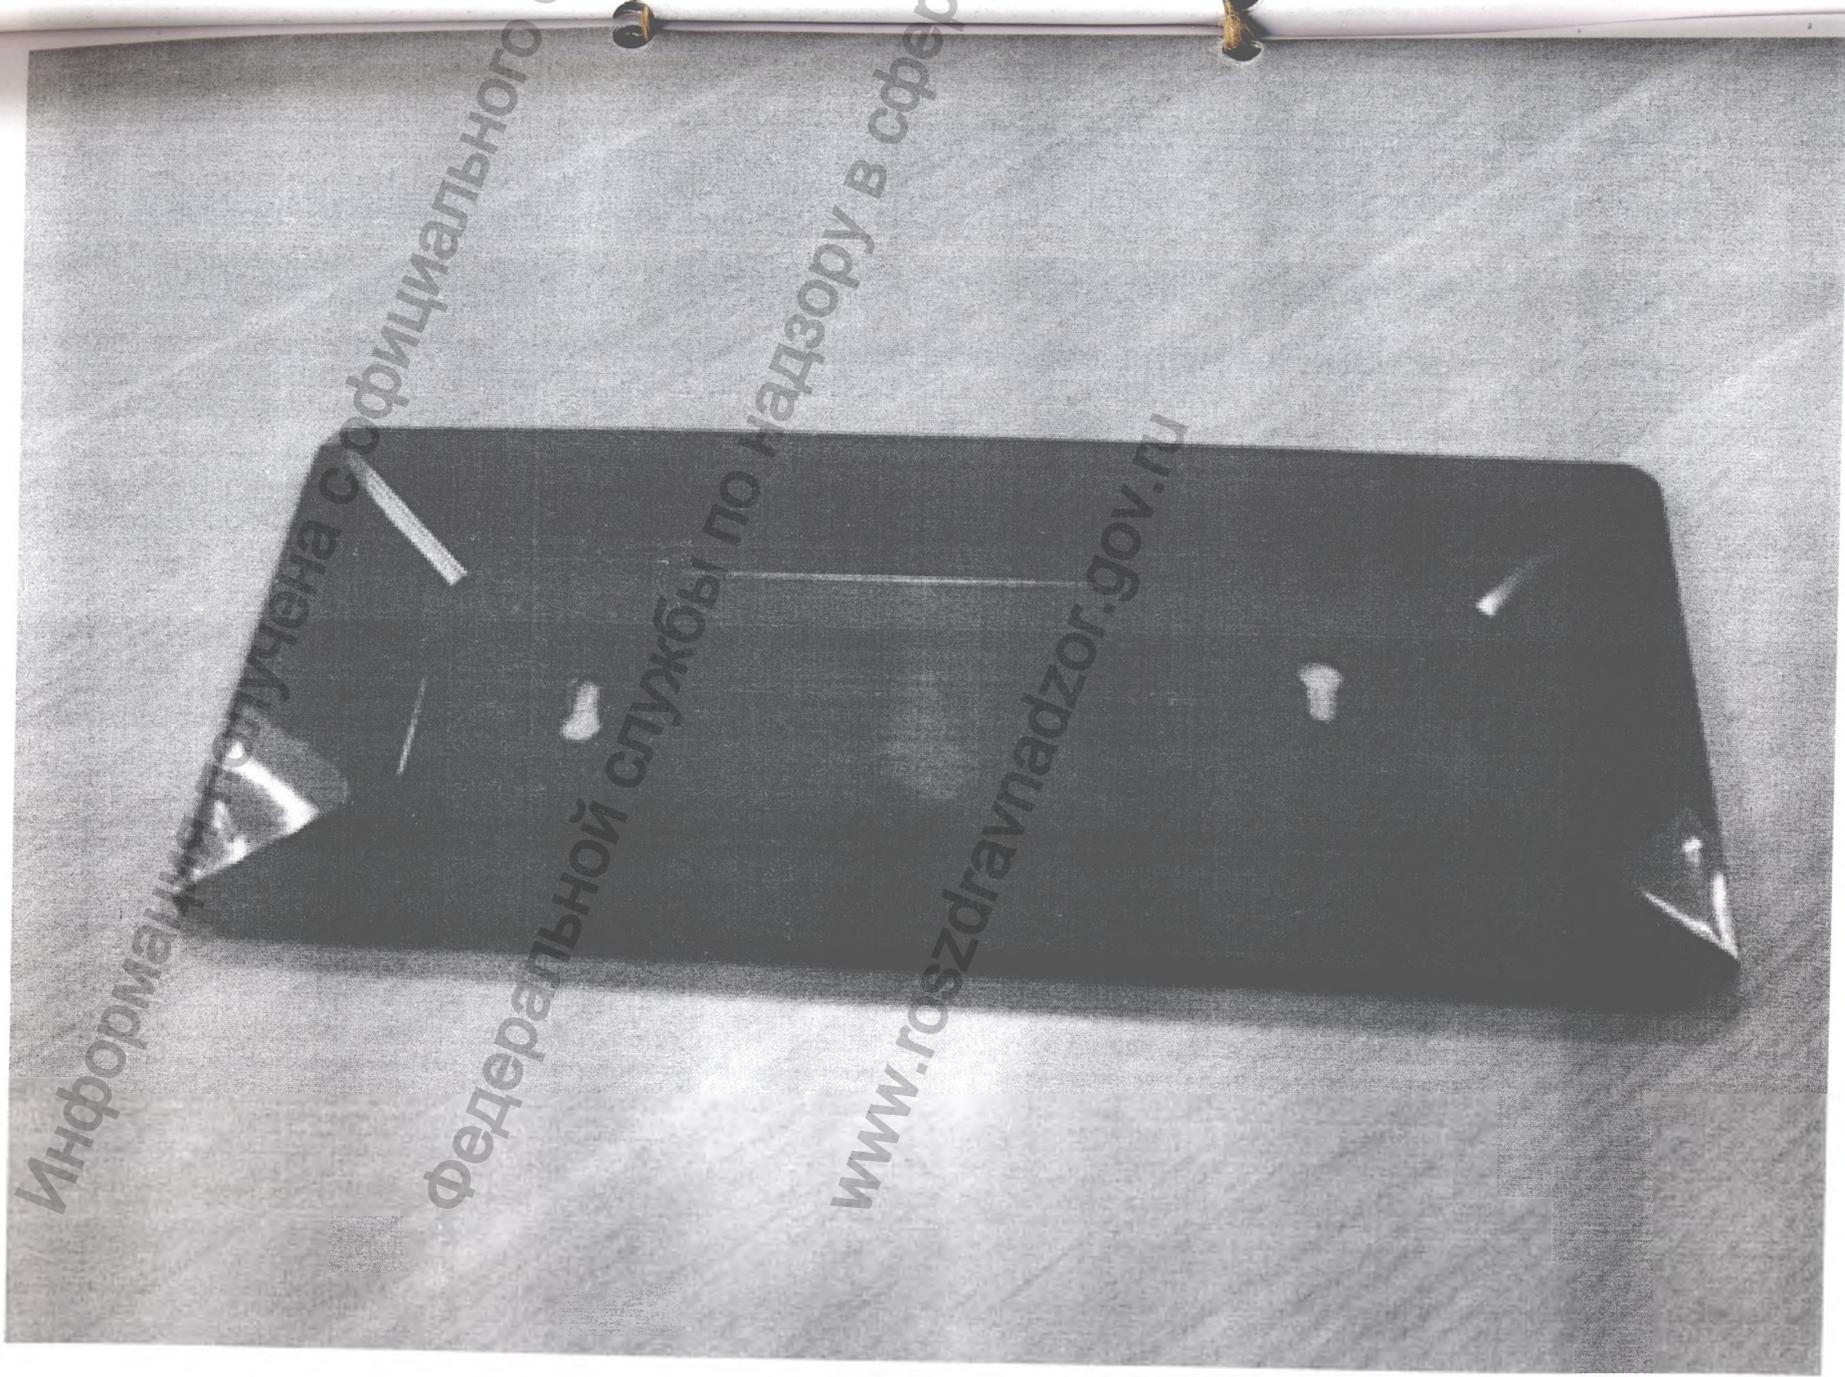

12
МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующей крышкой), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение пресса)




13
МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксацией ручки) (Регистрация МИ в Росздравнадзоре ОИ), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение ручки)

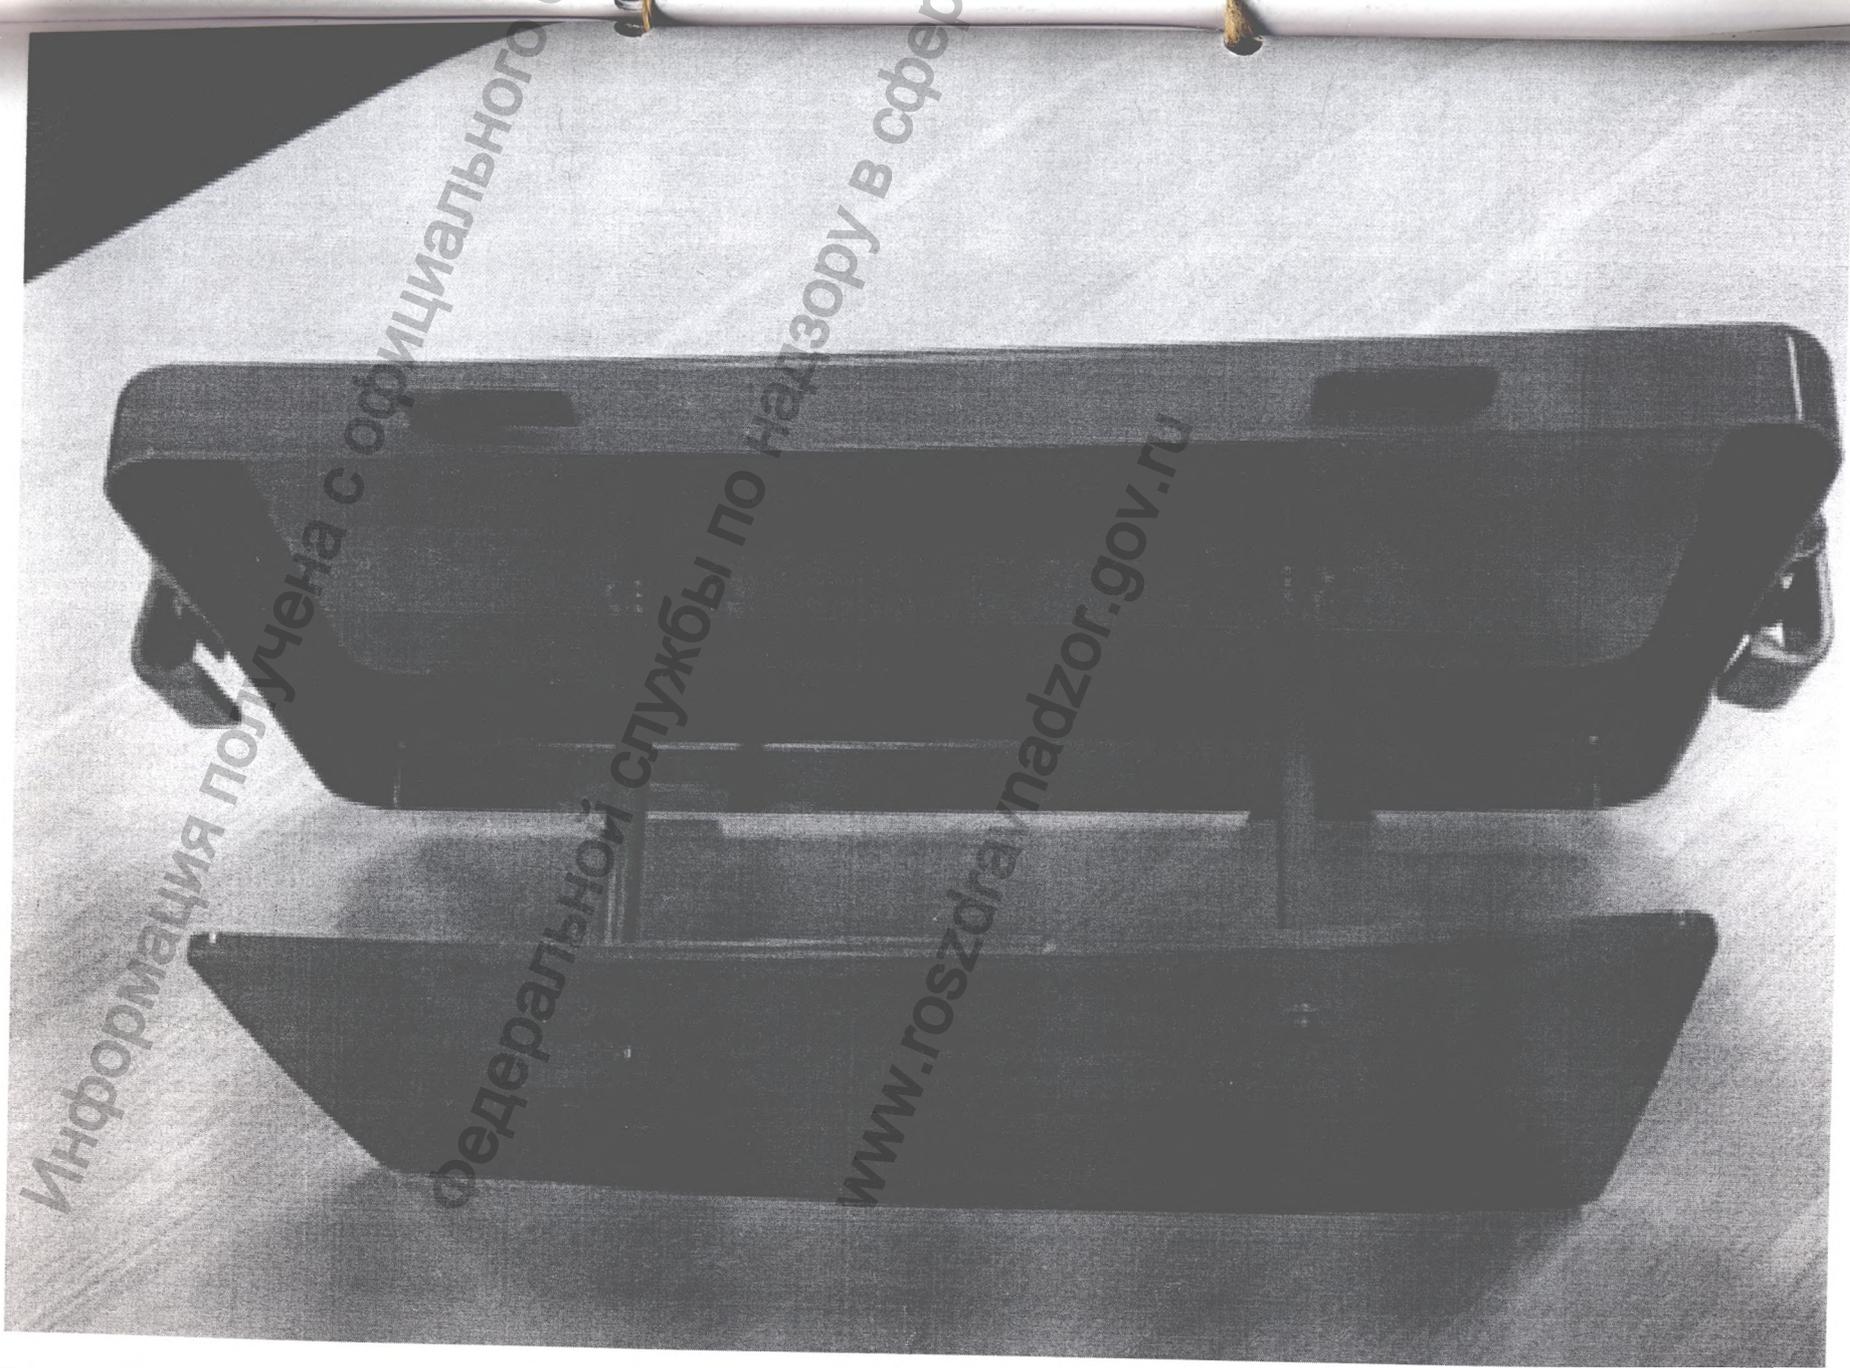


МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой) объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)




МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объемом 12,0 л. (Изделие в сборе)

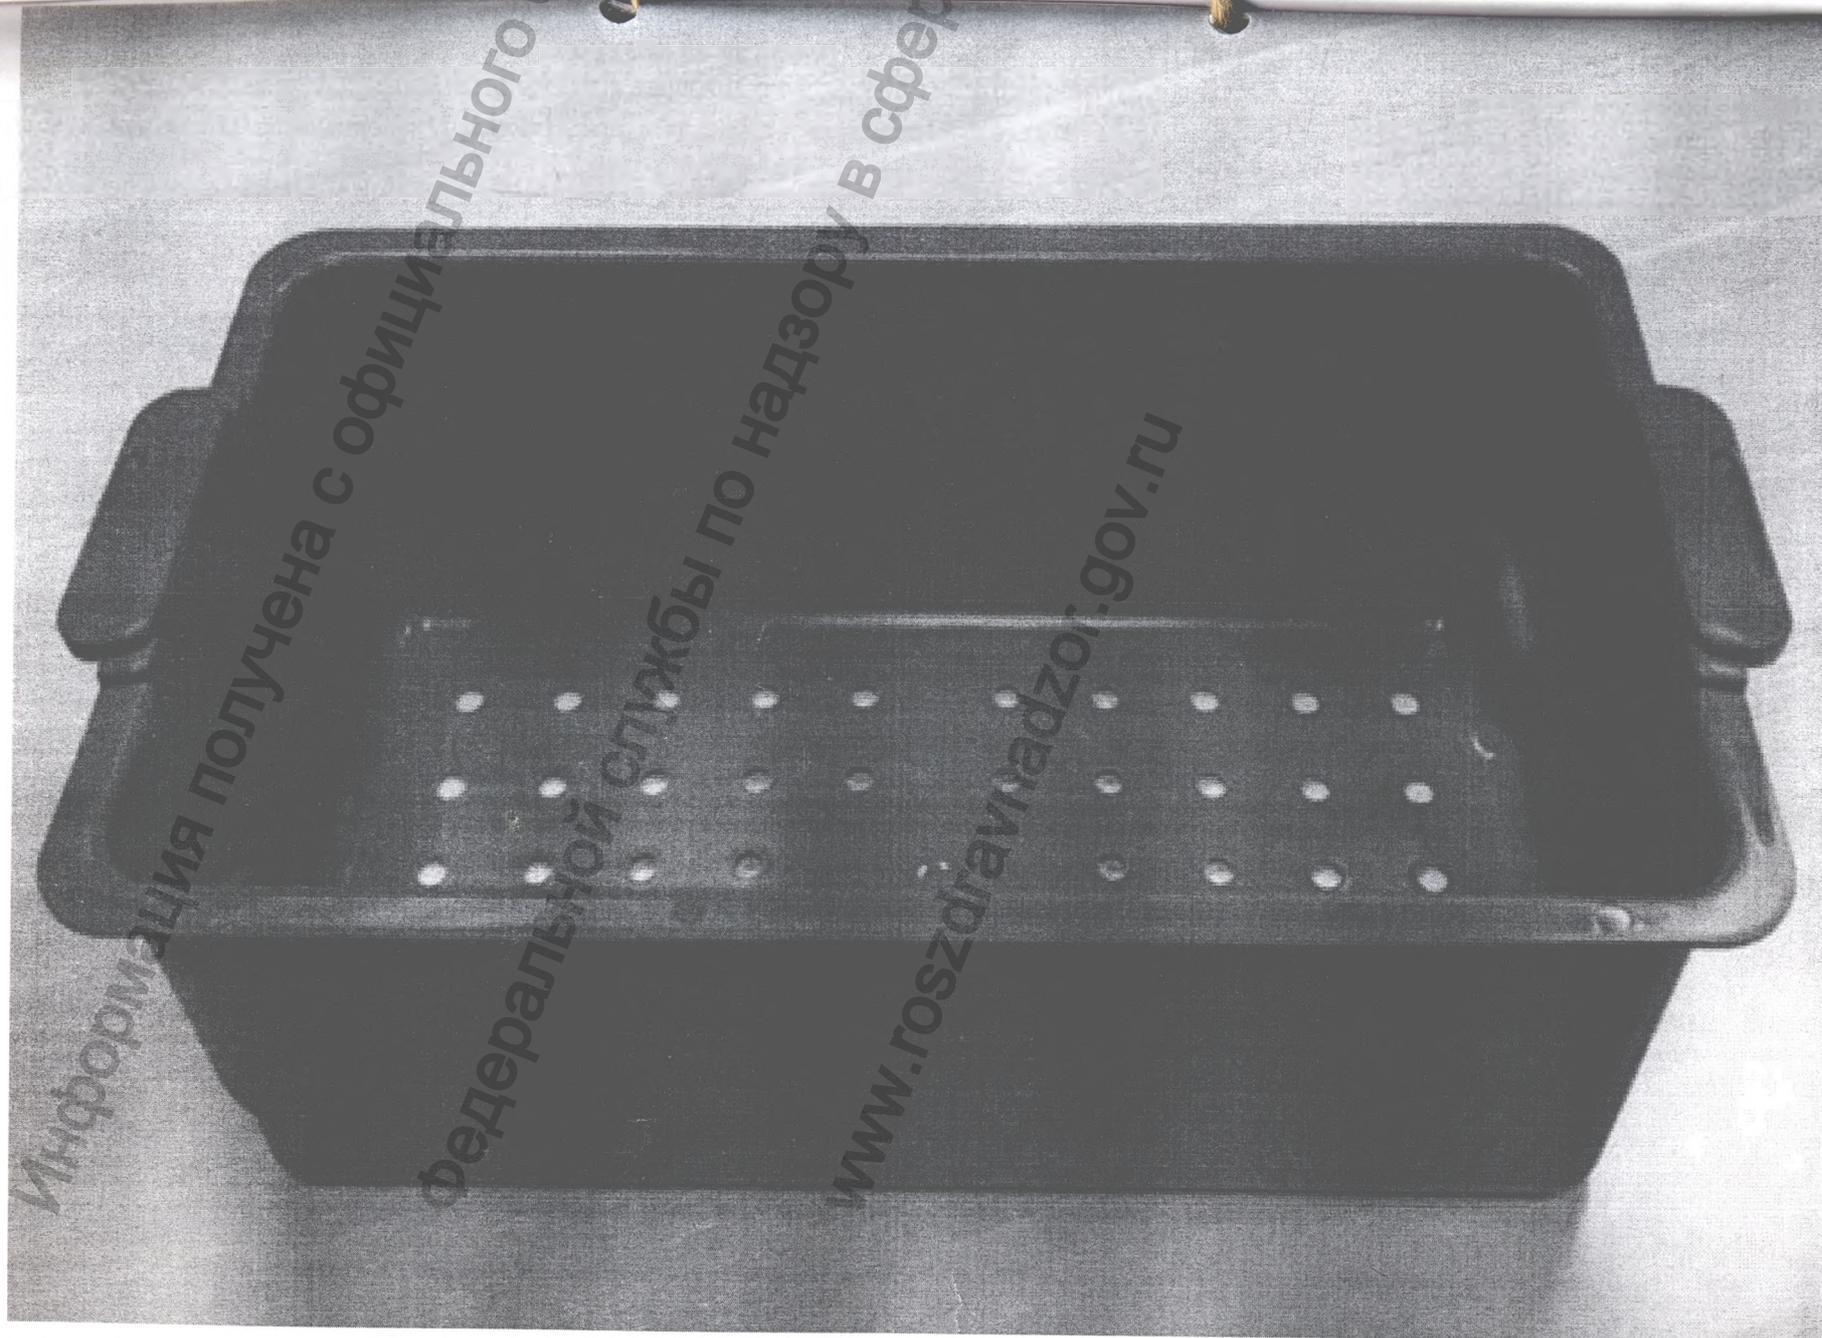

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объемом 12,0 л. (Фотографическое изображение перфорированного контейнера-вкладки)

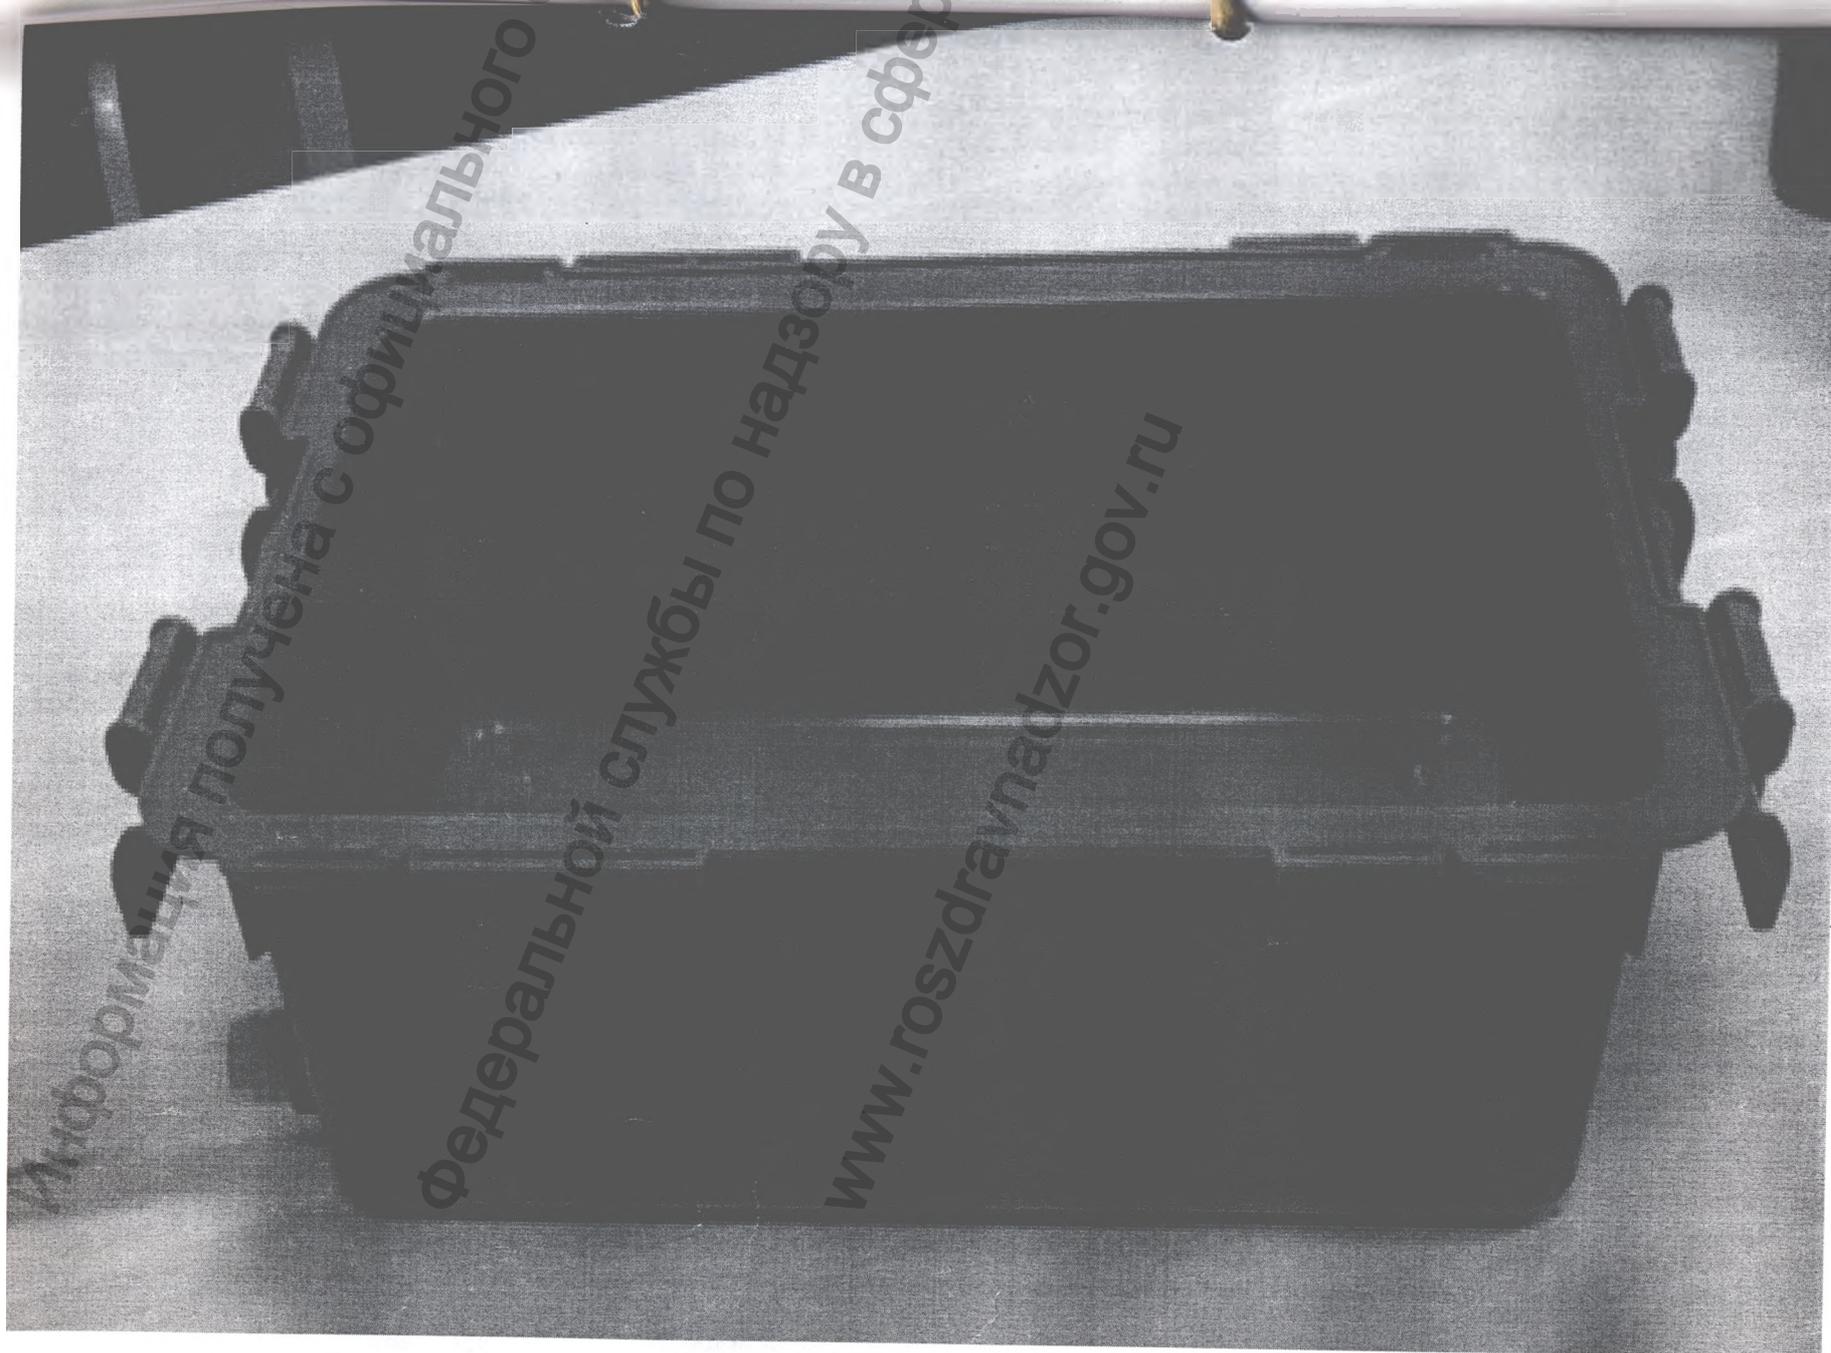


МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объемом 12,0 л. (Фотографическое изображение основного контейнера с полочками наружу)

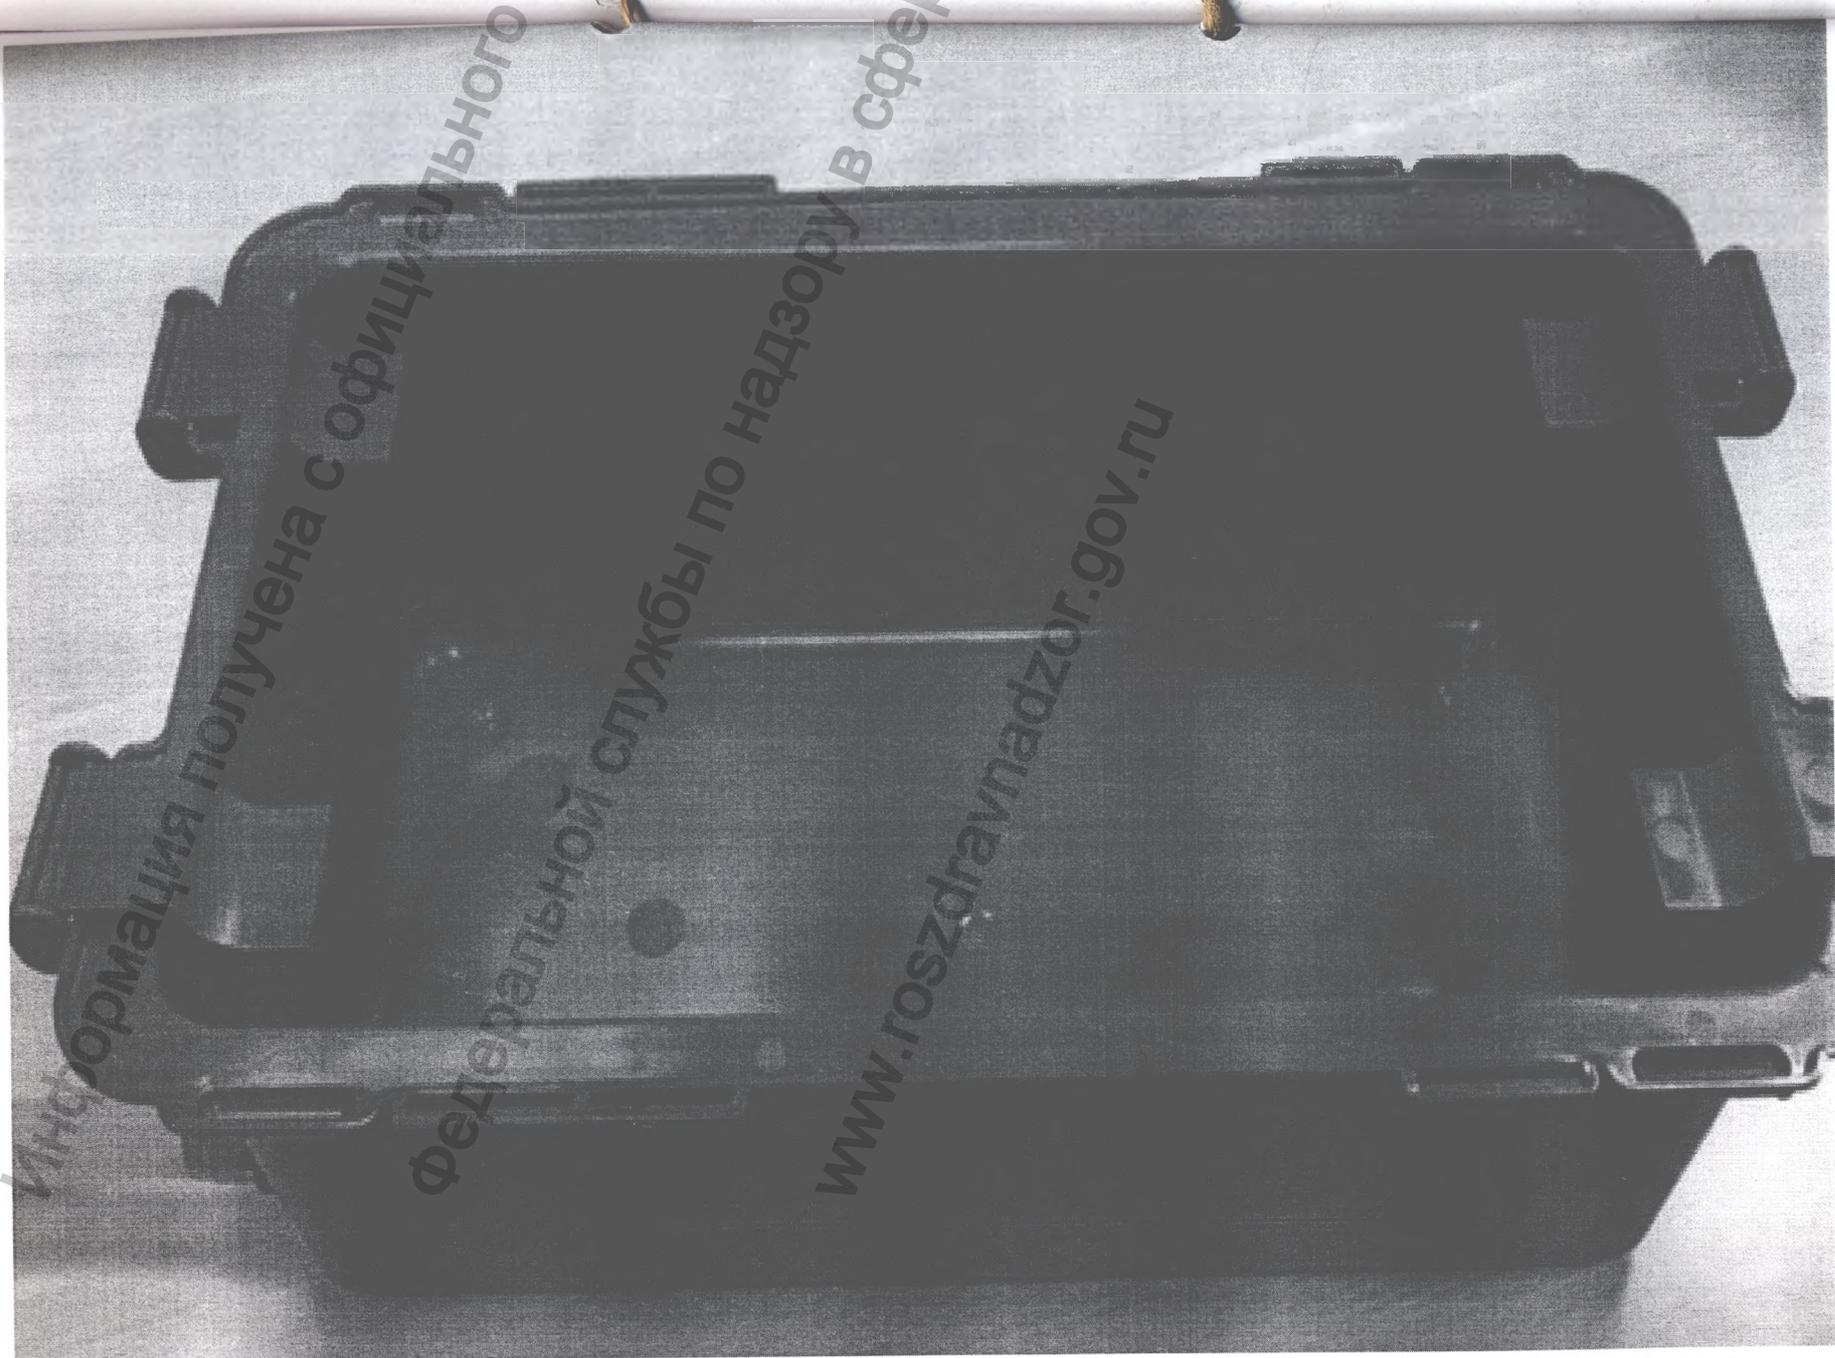

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объём 10 л. Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru Графическое изображение основного контейнера с полочками внутри)



МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объемом 12,0 л. (Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru) изображение основного контейнера с перфорированным контейнером- вкладкой,

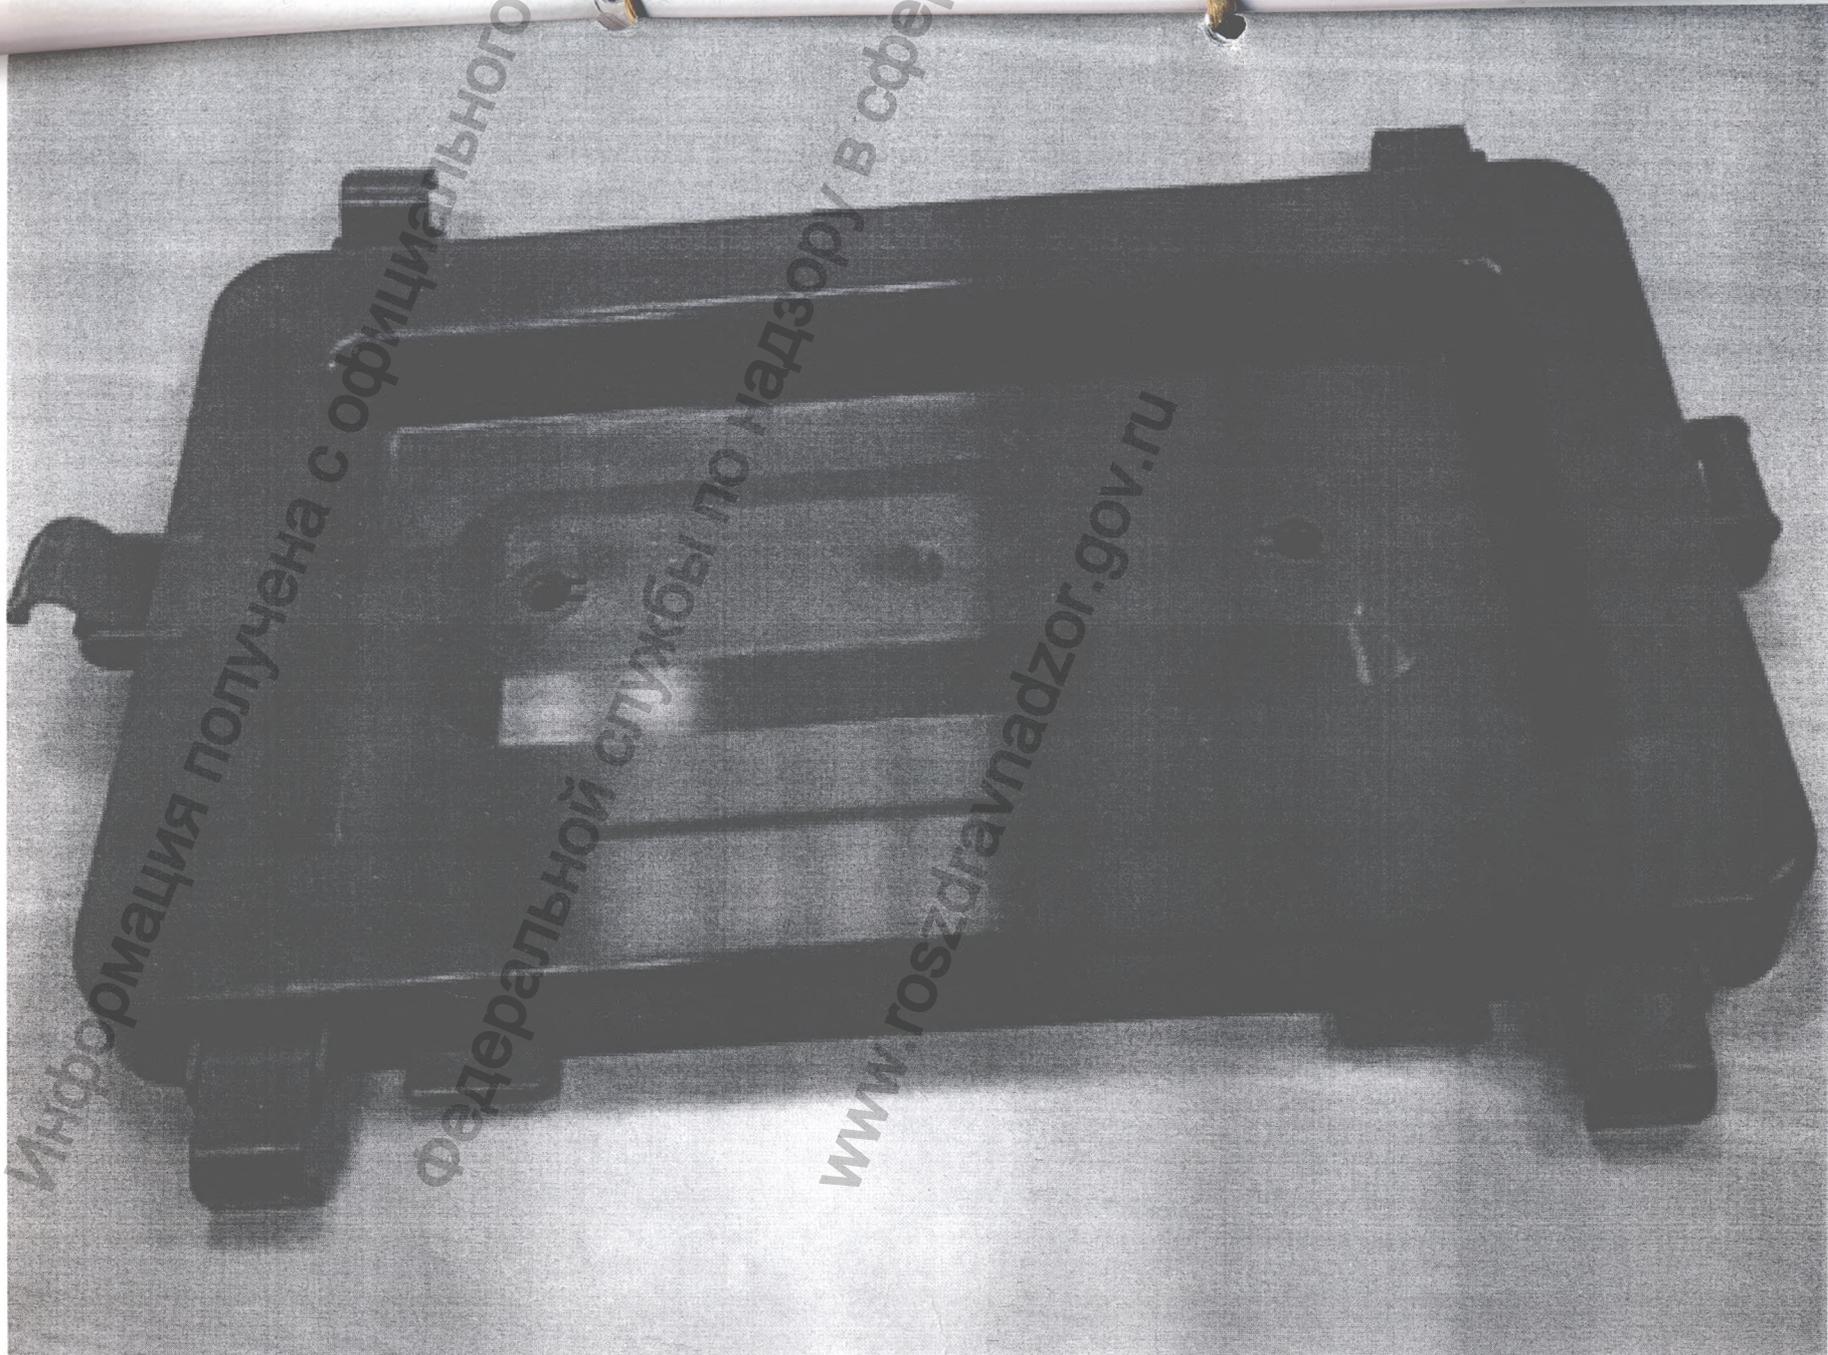

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
(б www.neuasert.ru | info@neuasert.ru)
м 12,0 л. (Фотографическое изображение крышки)



МПИ-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.hevacert.ru | info@hevacert.ru

модель 12,0 л. (Фотографическое изображение ручки)

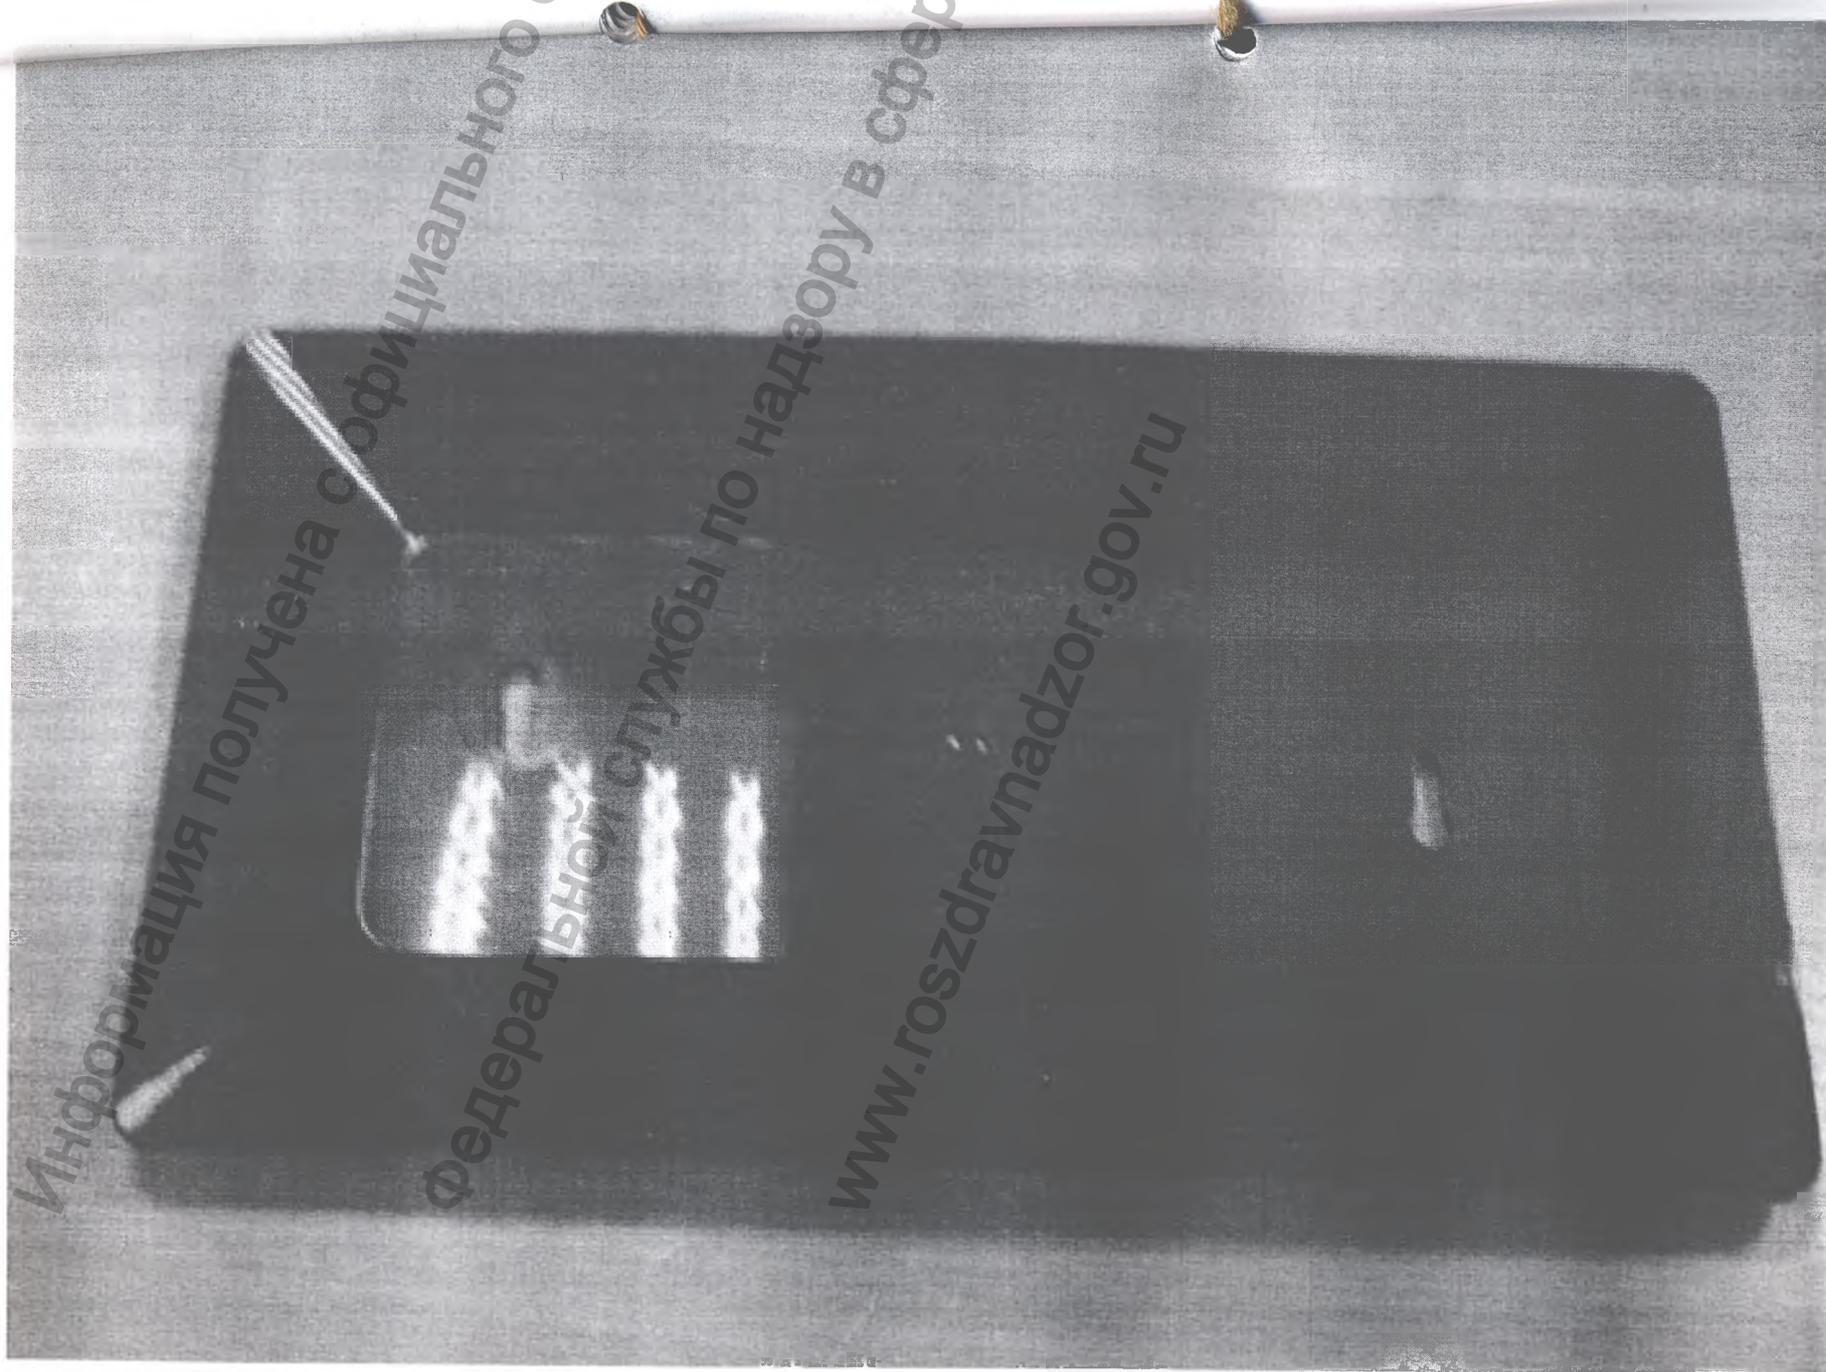


МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru **Мом 12,0 л. (Фотографическое изображение пресса)**

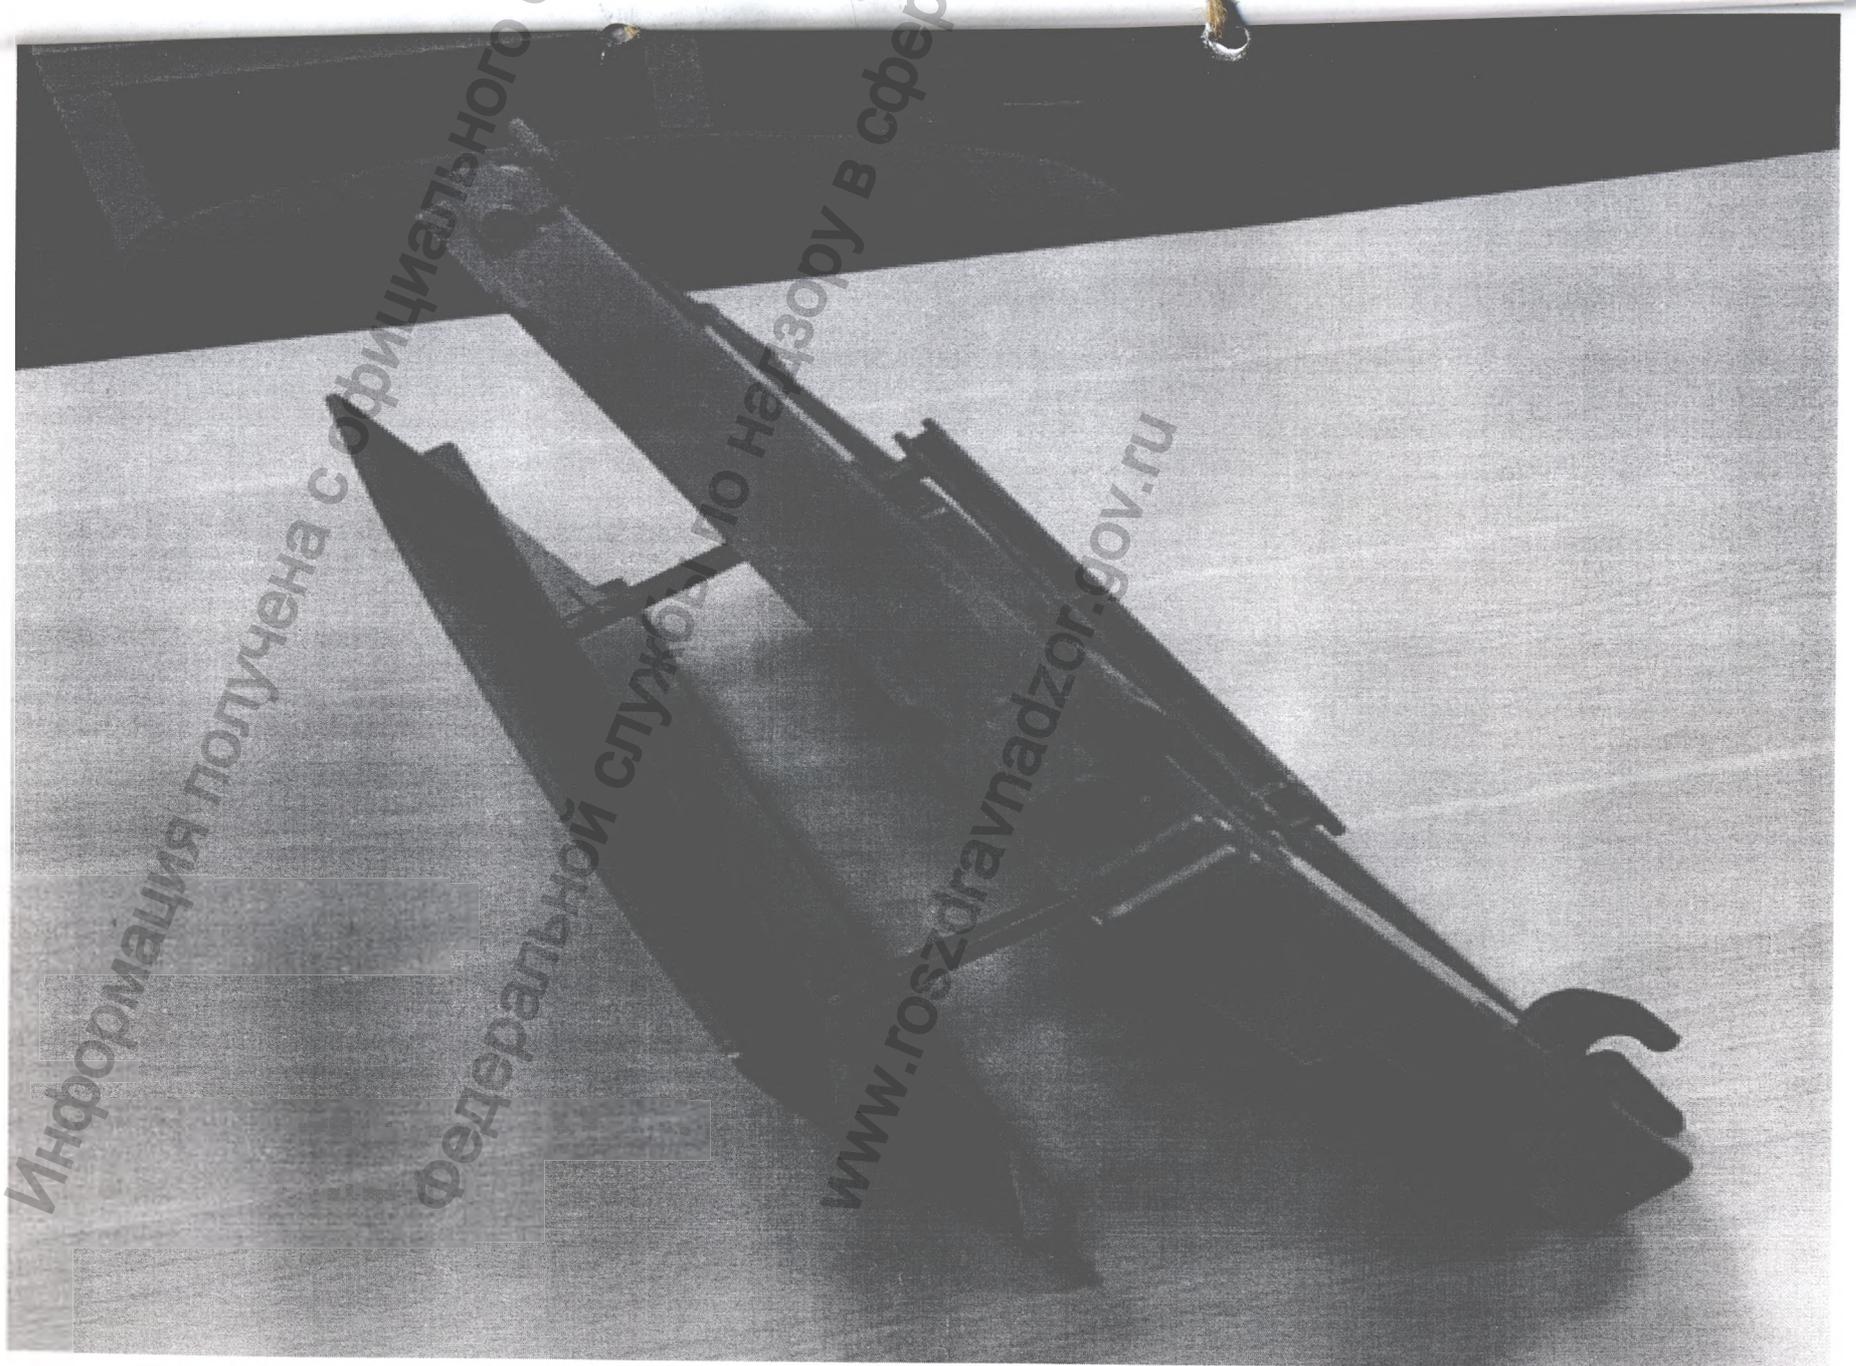

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), фотографиями Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru **фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)**

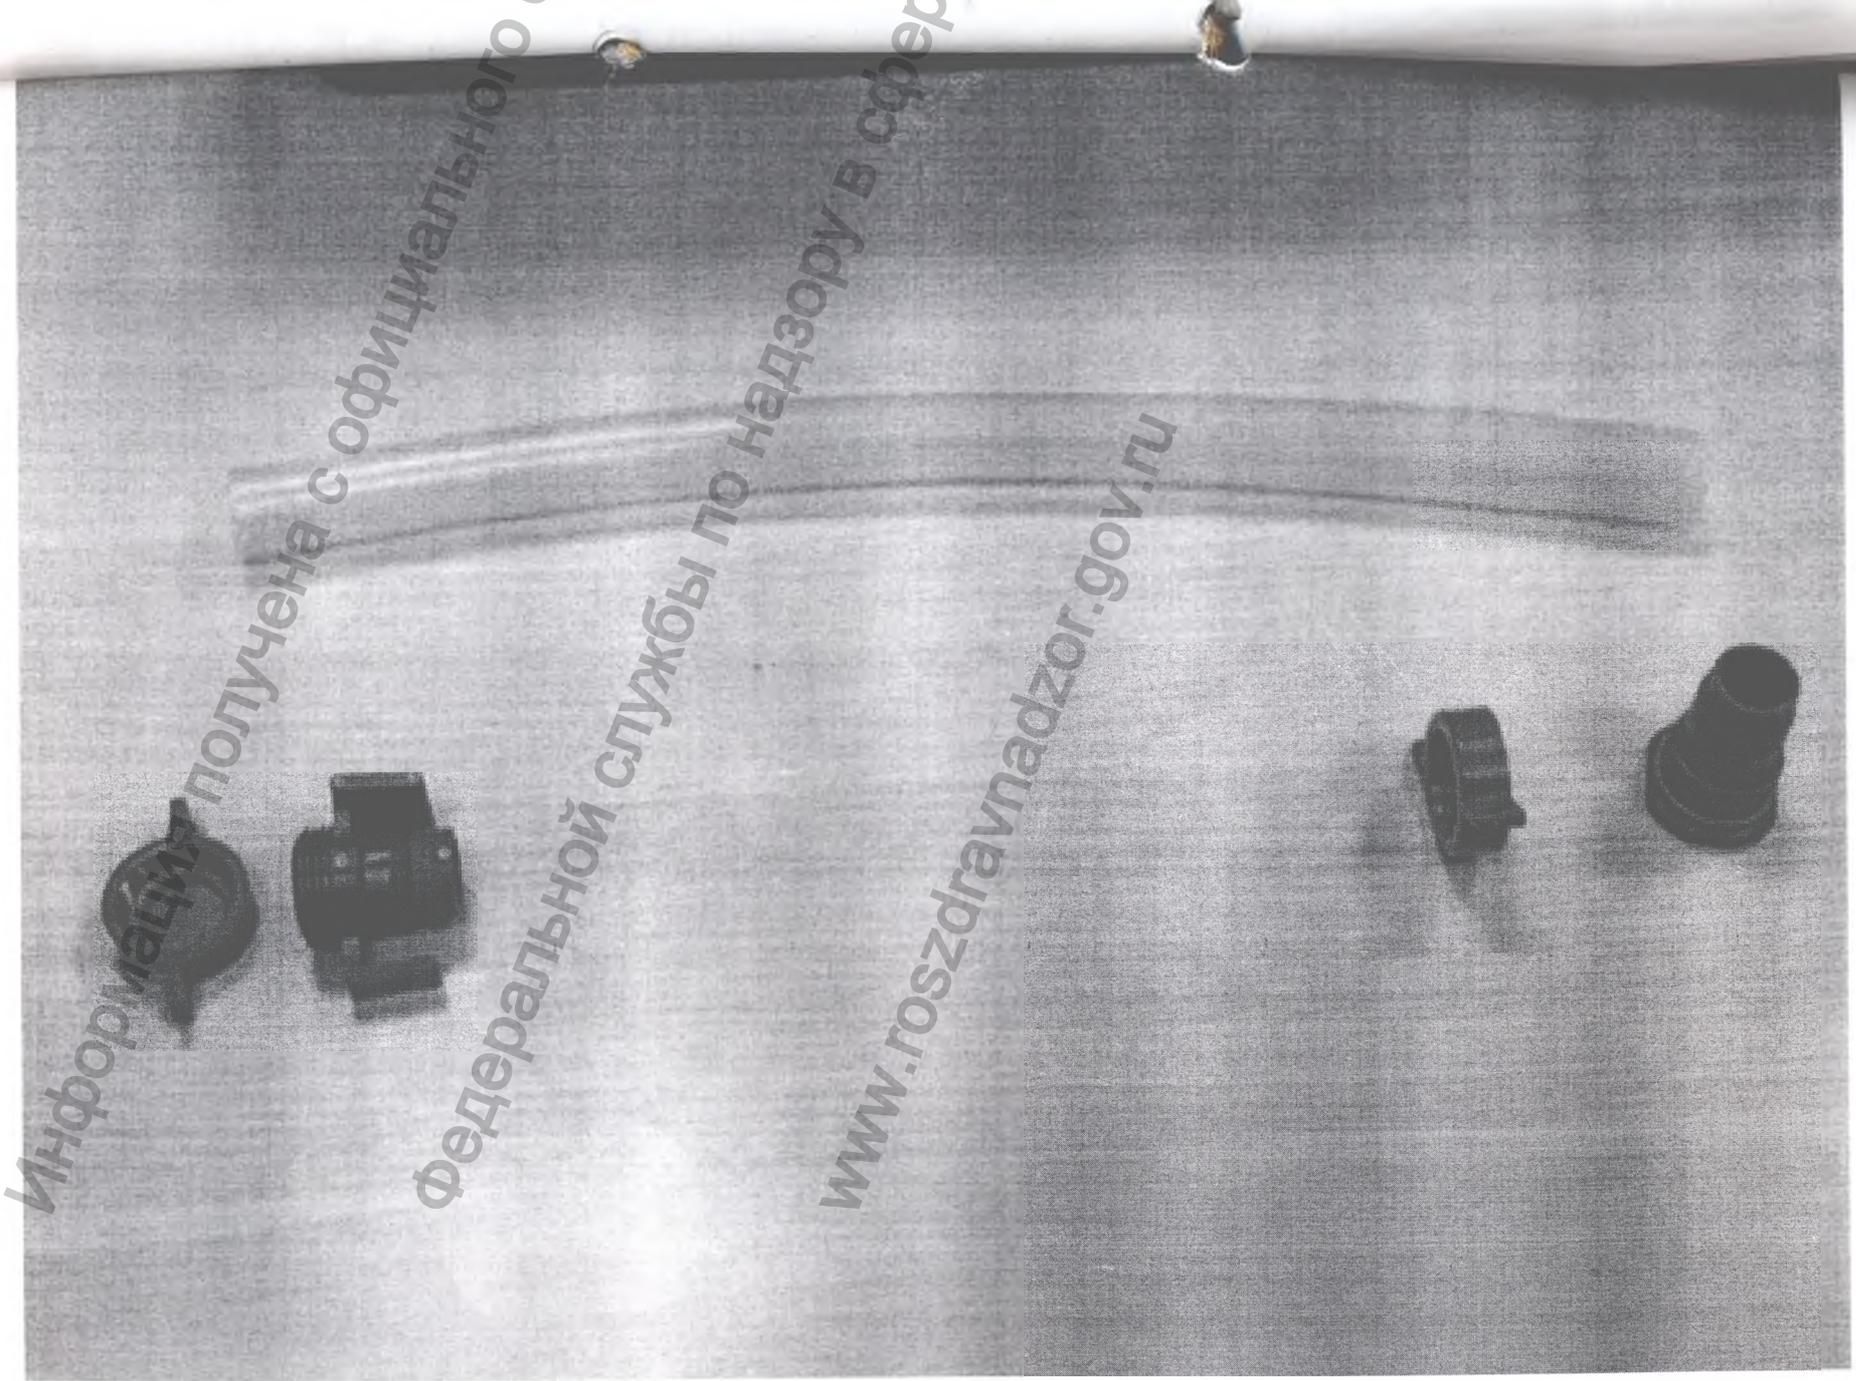

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
(бирюзово-голубого цвета) л. (Фотографическое изображение слива в разобранном виде)

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru

Макет маркировки

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (бирюзовый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.
Тел : (495) 645-04-74.
Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
Объем –1,3 л.
Номинальная нагрузка – 4,5 кг.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
170*120*130
Серийный номер МП-03-1.3-1114
Дата изготовления : 24.11.2014
РУ № _____
СС № _____

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (бирюзовый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.
Тел : (495) 645-04-74.
Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
Объем – 4,5 л.
Номинальная нагрузка – 8,0 кг.
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
375x205x130
Серийный номер МП-03-4.5-1114
Дата изготовления : 24.11.2014
РУ № _____
СС № _____

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru



Прошито прокумера
25 (двадцать пять)
штучек