




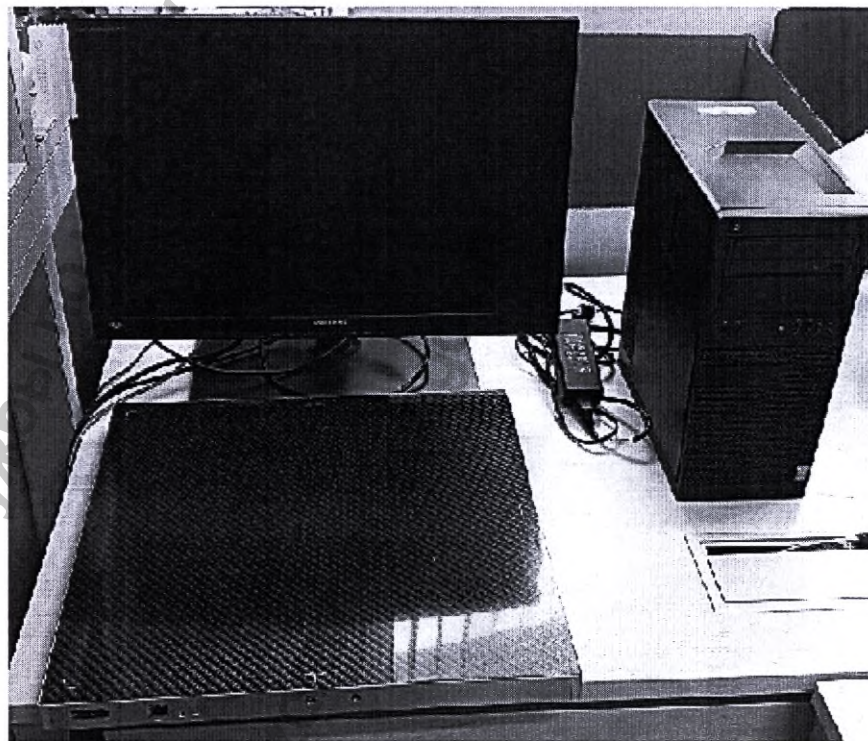


Фотографии медицинского изделия
Аппарат универсальный рентгенографический диагностический
«УнивеРС-Флюорограф-МТ»,
производства АО «МТЛ», Россия

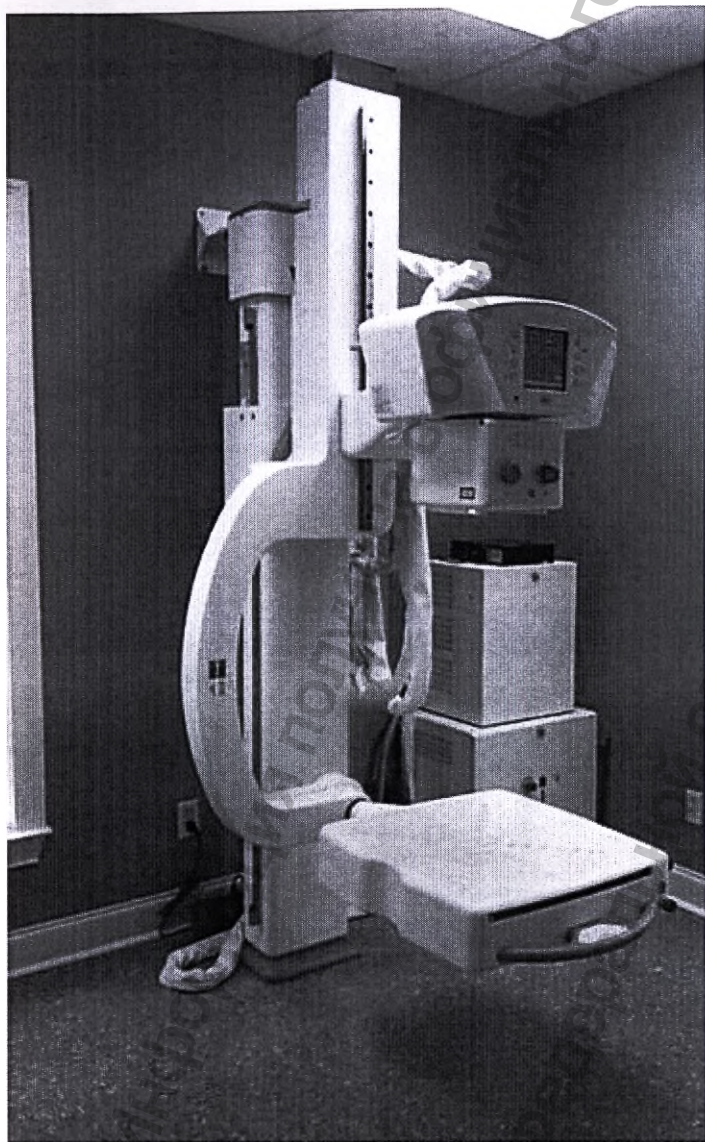


**Аппарат универсальный рентгенографический диагностический
«УнивеРС-Флюорограф-МТ»-01
производства АО «МТЛ», Россия**

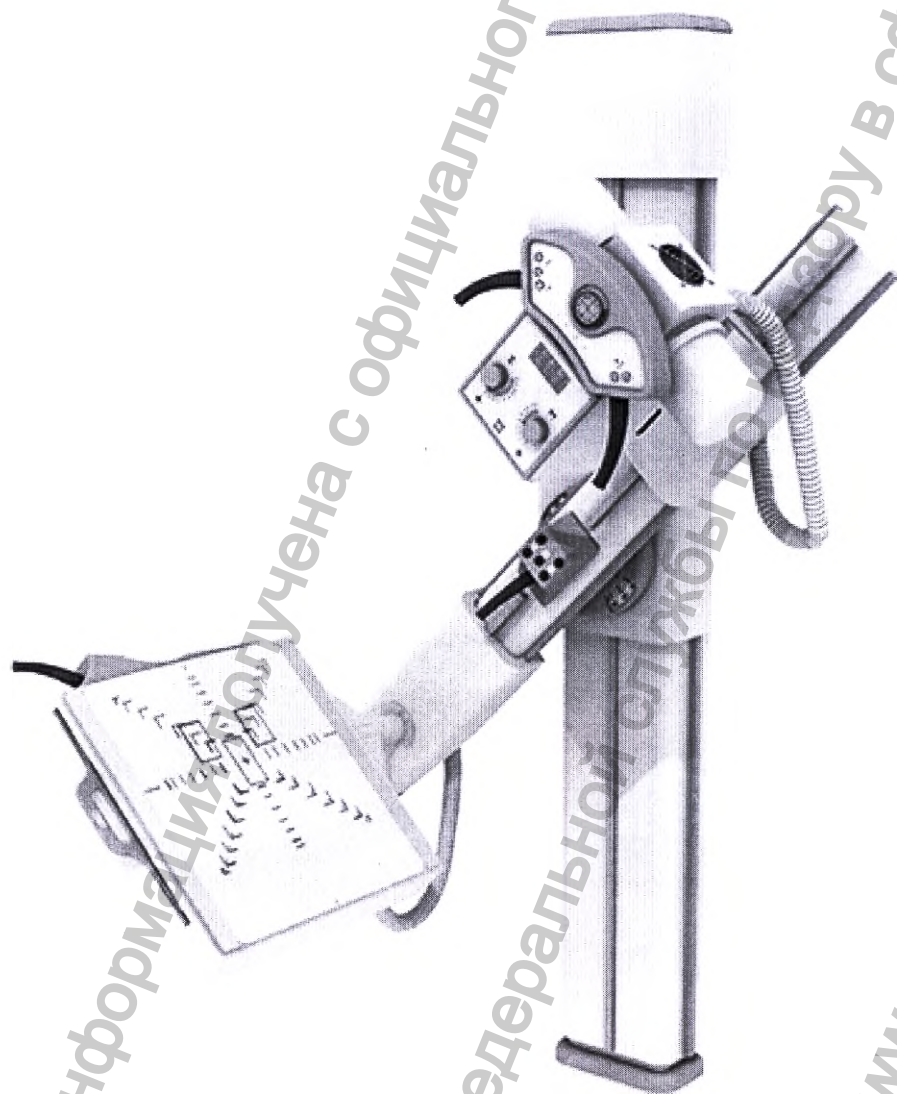


**Аппарат универсальный рентгенографический диагностический
«УнивеРС-Флюорограф-МТ» - 02
производства АО «МТЛ», Россия**

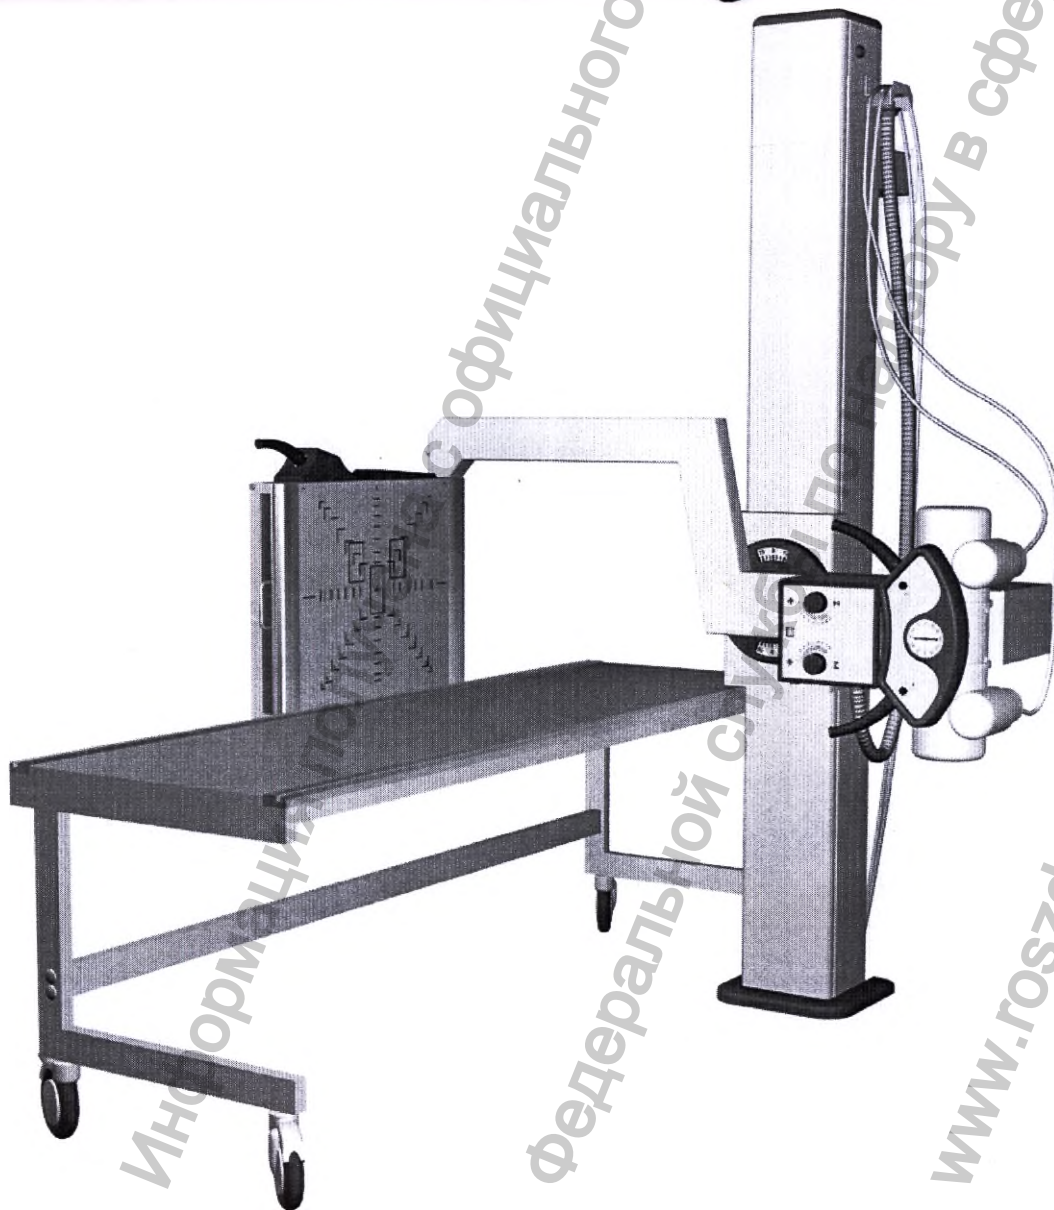


Аппарат универсальный рентгенографический диагностический
«УнивеРС-Флюоро-МТ»-03
производства АО «МТЛ», Россия

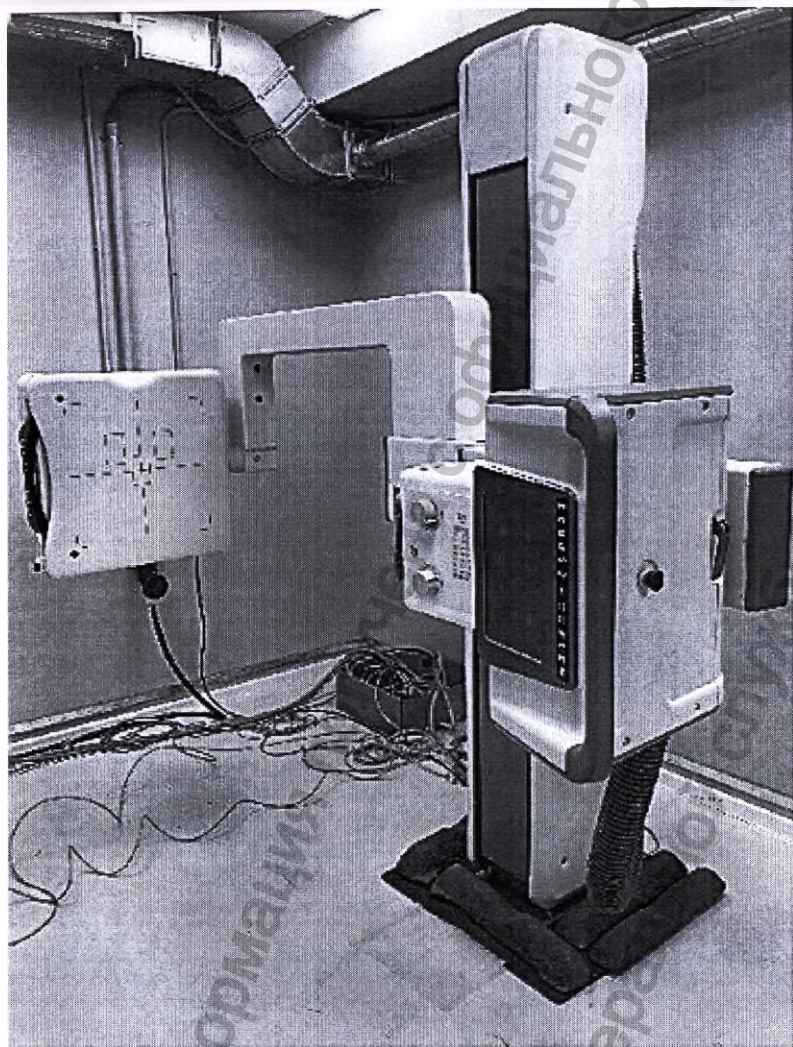

**Аппарат универсальный рентгенографический диагностический
«УнивеРС-Флюорограф-МТ» - 04
производства АО «МТЛ», Россия**

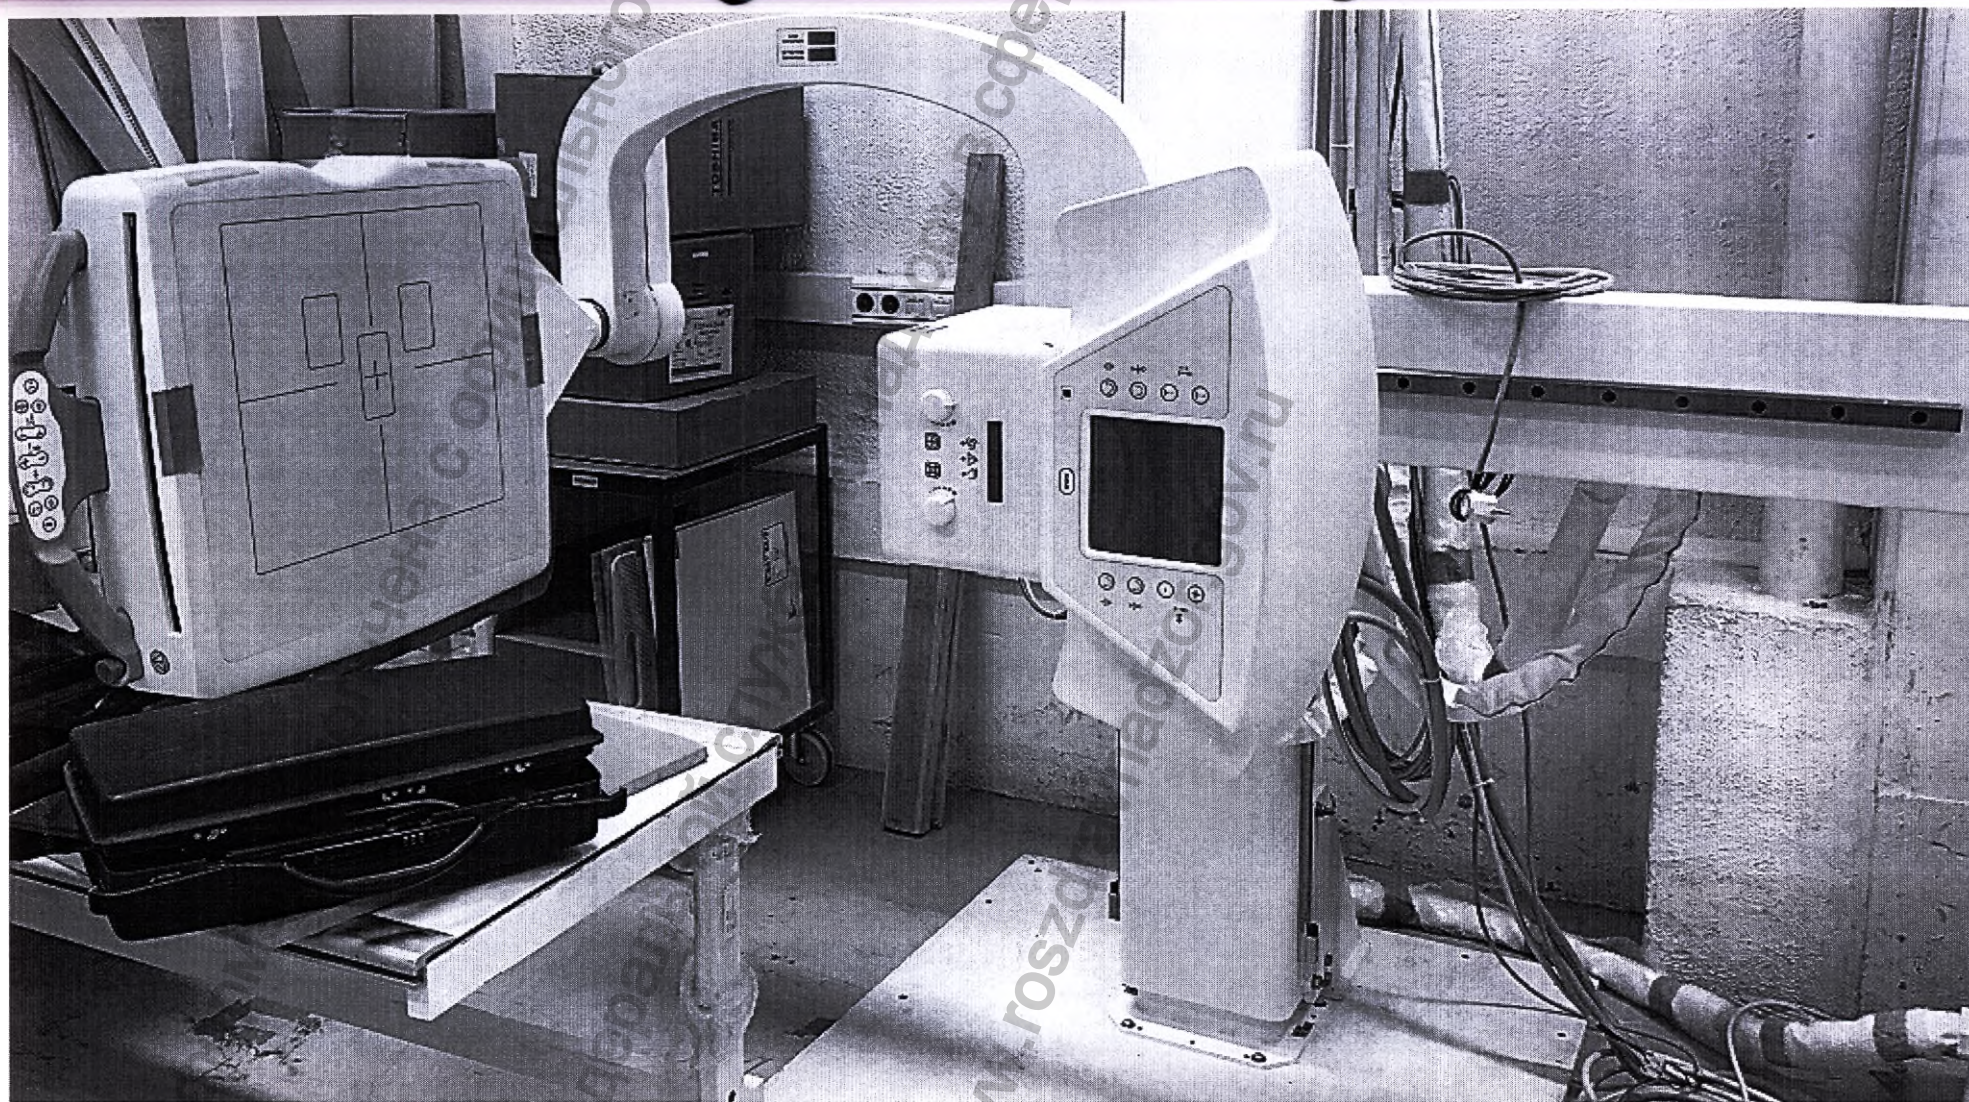


Универсальный рентгенографический штатив
X PLUS LP PLUS с блоком управления,
производства фирмы Sedecal S.A., Испания

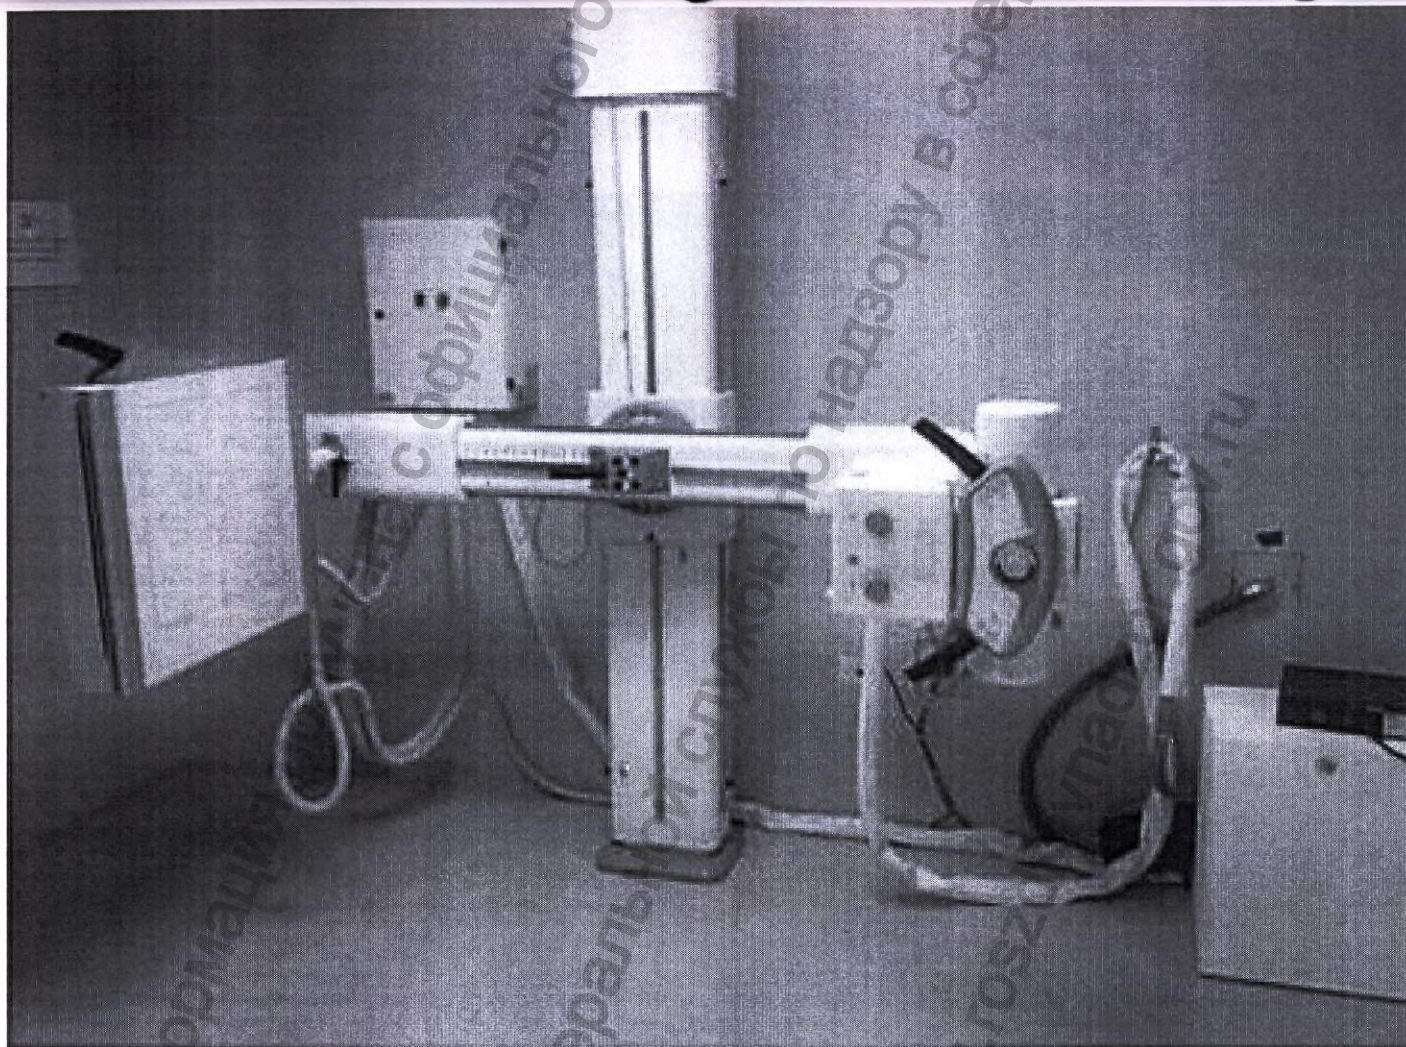


Универсальный рентгенографический штатив
Sedecal X с блоком управления,
производства Sedecal S.A., Испания



Универсальный
рентгенографический штатив
BRS без блока управления,
производства фирмы Sedecal
S.A., Испания

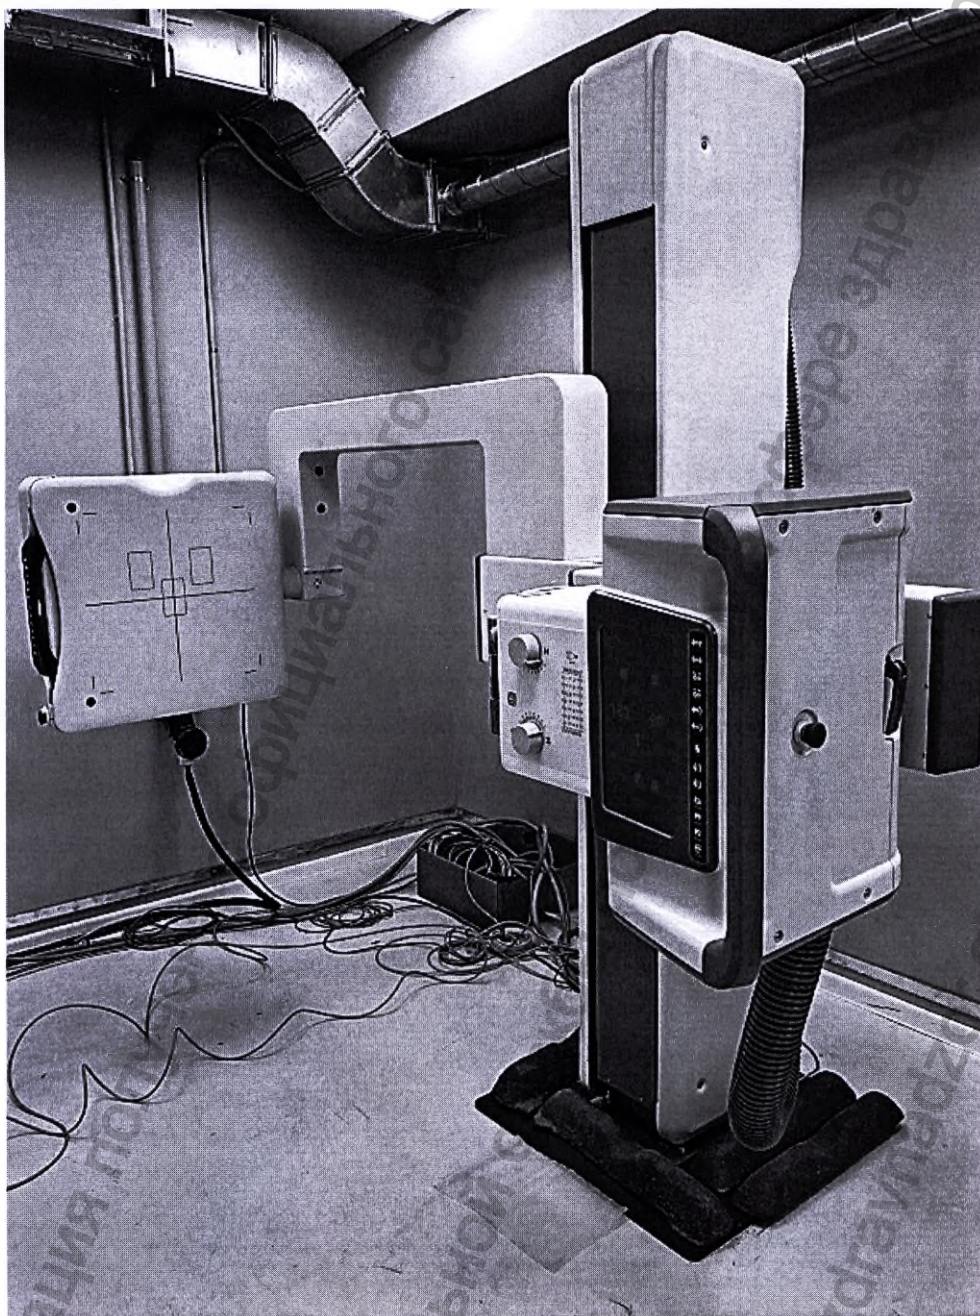


Универсальный рентгенографический штатив
МТ без блока управления ,
производства АО «МТЛ», Россия

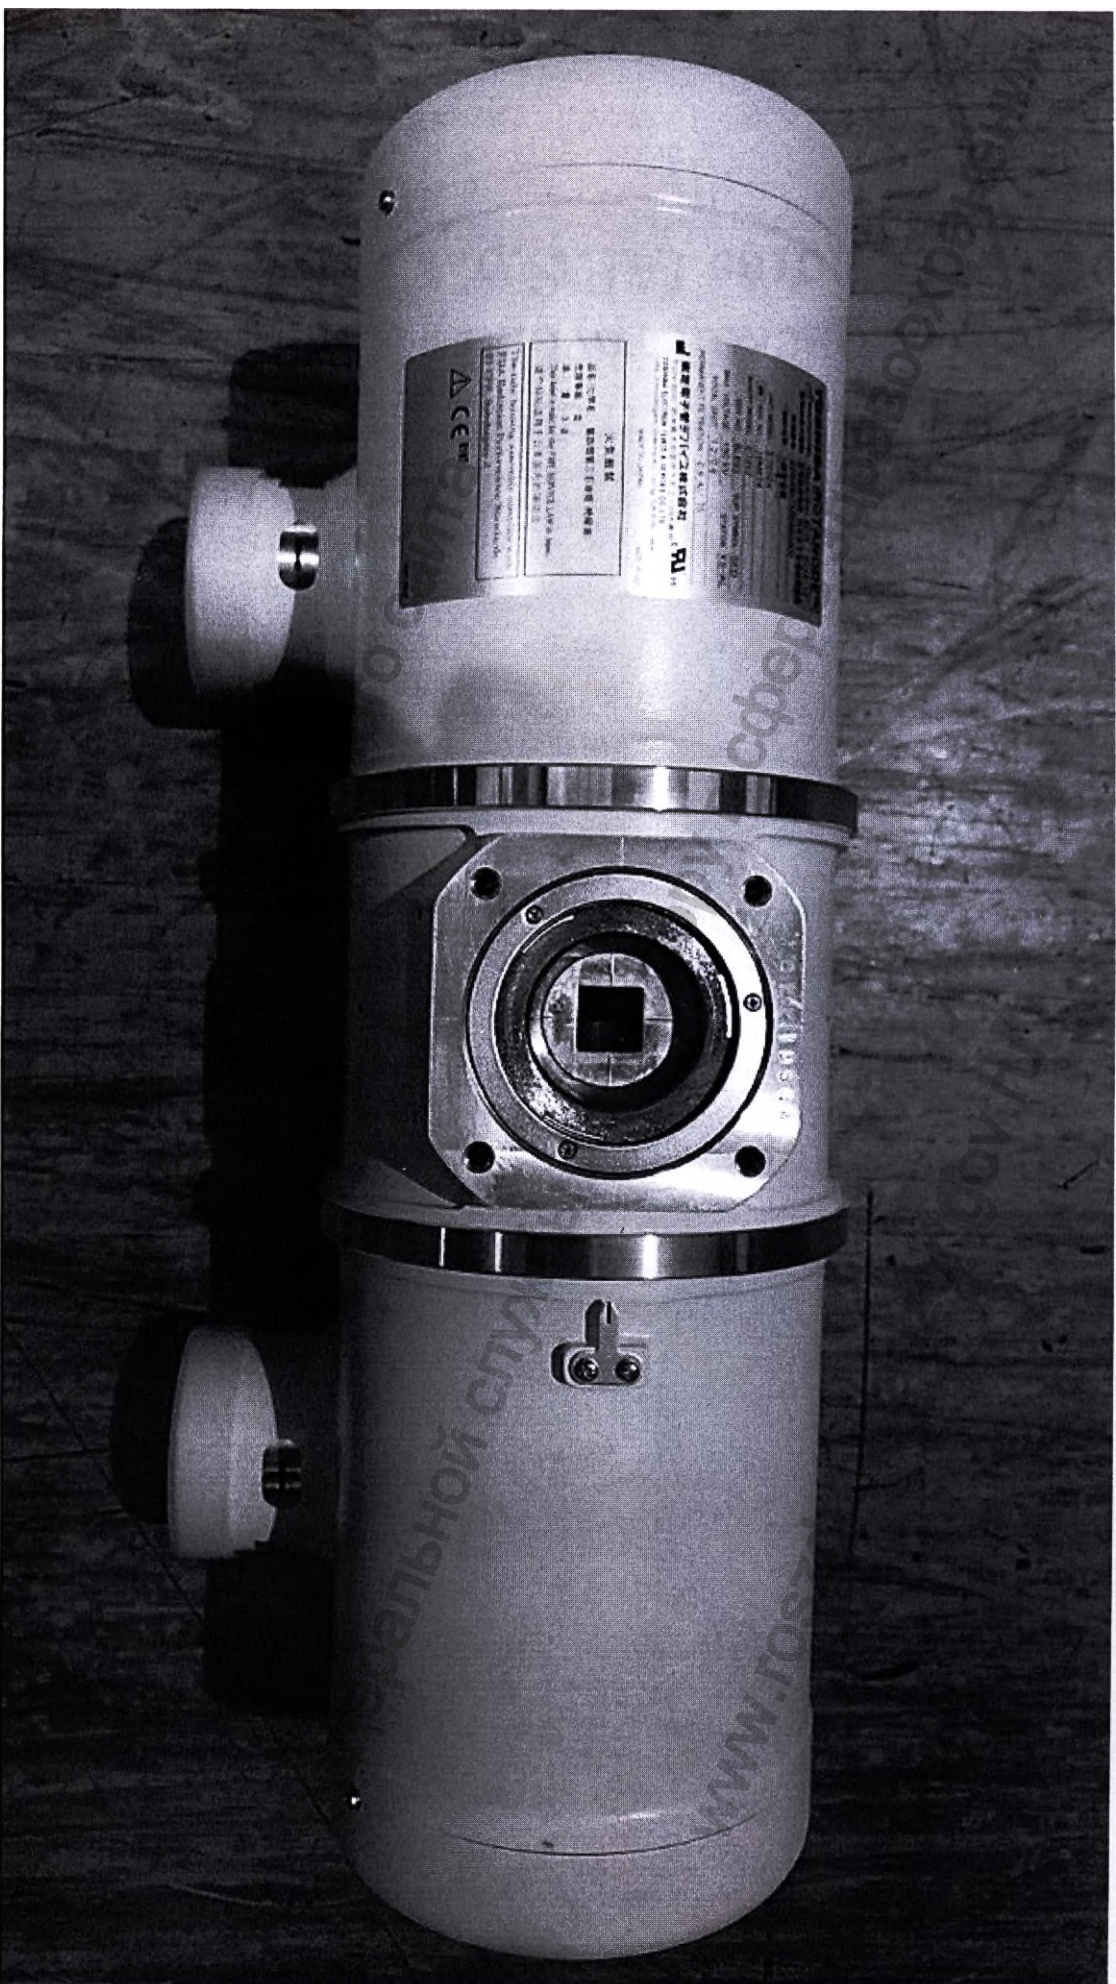


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой E7252X, или E7865X, или E7884X
производства фирмы Canon Electron Tubes & Devices Co. Ltd., Япония




Излучатель рентгеновский с
рентгеновской трубкой RTM782HS,
производства IAE S.p.A Италия

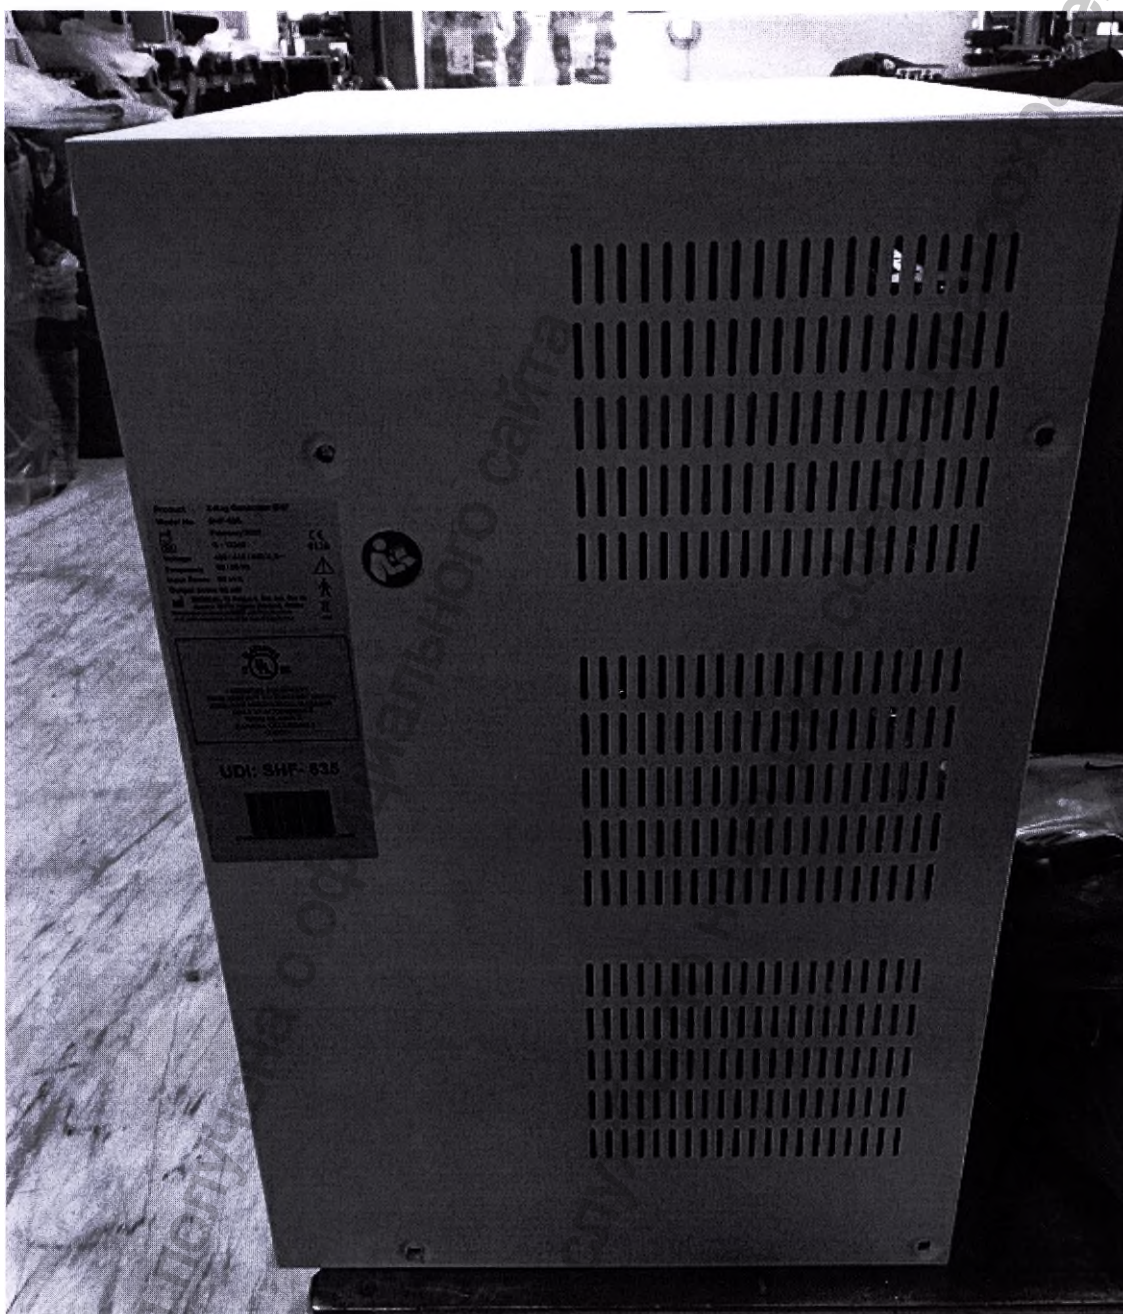


Рентгеновское питающее устройство (РПУ)
SHF315-C, или SHF415-C, или SHF 515-C, или
SHF330, или SHF335, или SHF430, или
SHF435, или SHF535, или SHF635,
производства фирмы Sedecal S.A., Испания

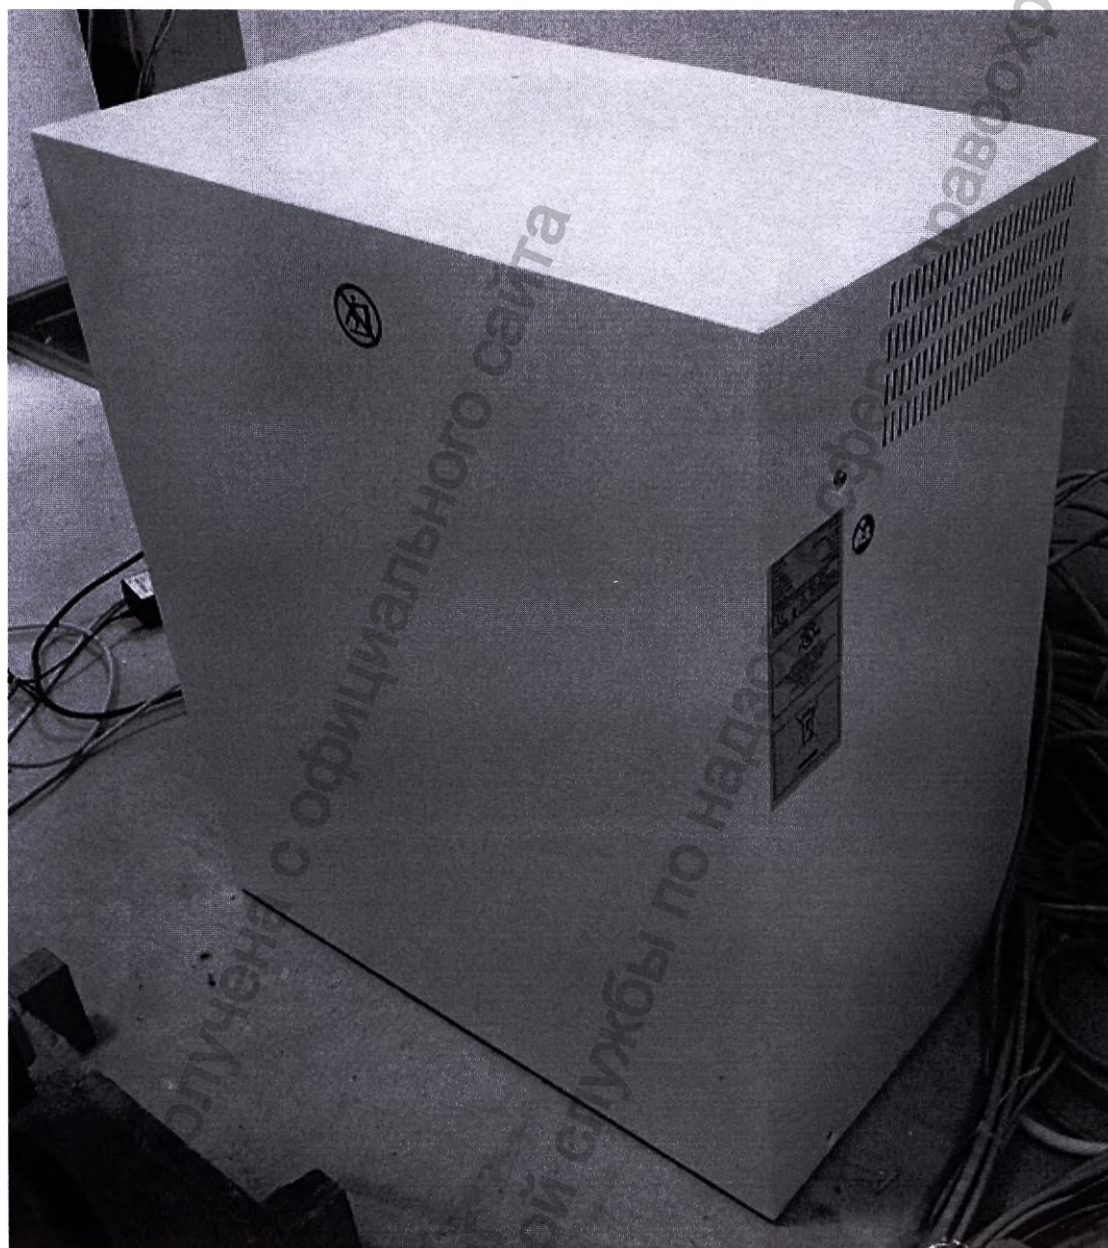

Рентгеновское питающее устройство
(РПУ) SHFR 500 или SHFR 600,
производства Sedecal S.A., Испания

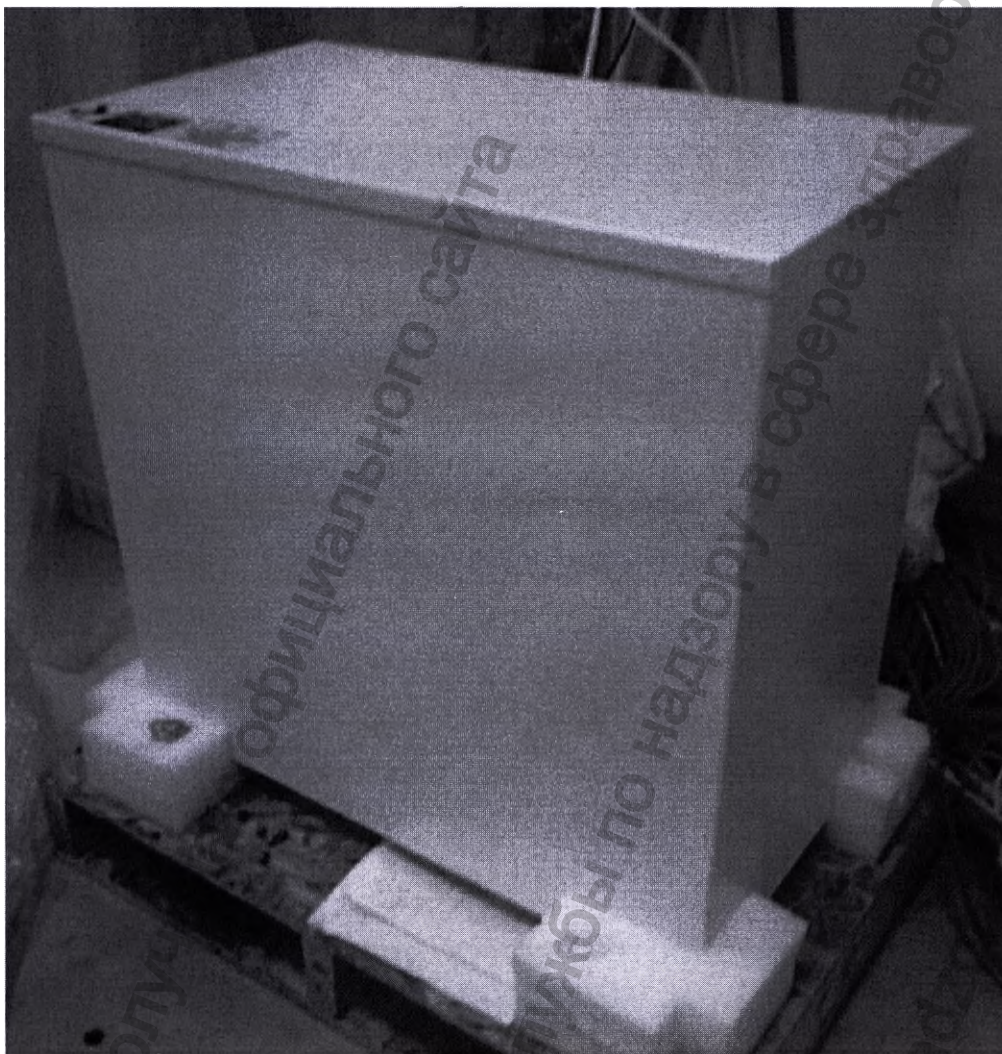

Рентгеновское питающее устройство (РПУ)
G200RAD-MT 40 kW, или
G200RAD-MT 50 kW, или G200RAD-MT 65 kW
производства Communications & Power Industries Inc., Канада
На фото представлено РПУ G200RAD-MT 50 kW

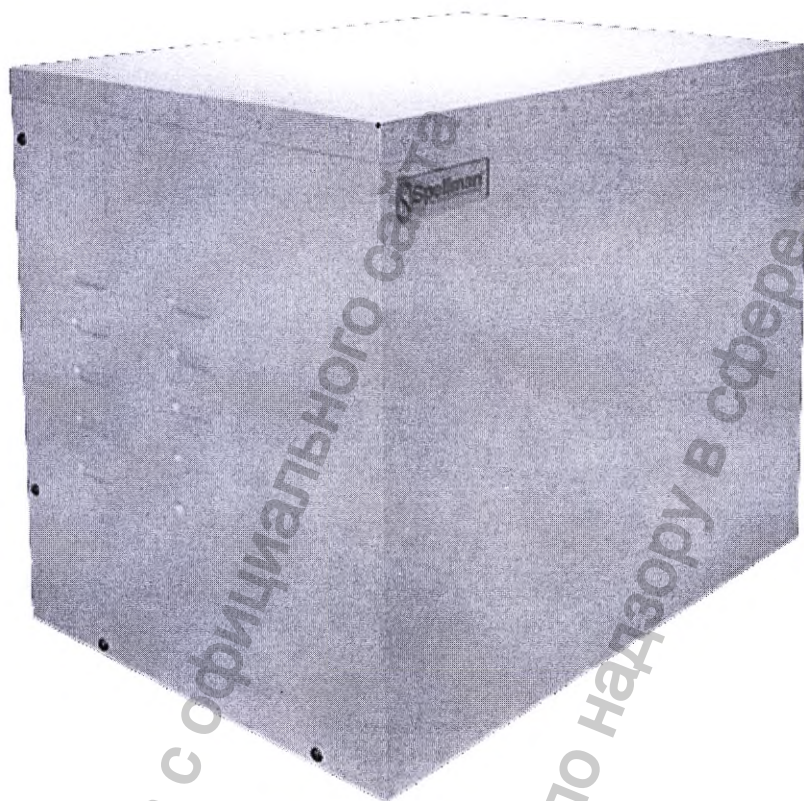


Рентгеновское питающее устройство
(РПУ) Spellman Z series 32kW, или
Spellman Z series 40kW, или Spellman Z
series 50kW, или Spellman Z series 65kW,
или Spellman Z series 80kW, производства
Spellman High Voltage Electronics
Corporation, США



Консоль управления РПУ
КЖЛЯ.034.050.10.01.00.000
производства АО «МТЛ», Россия




Консоль управления РПУ
КЖЛЯ.048.000.1.100.00
производства АО «МТЛ», Россия

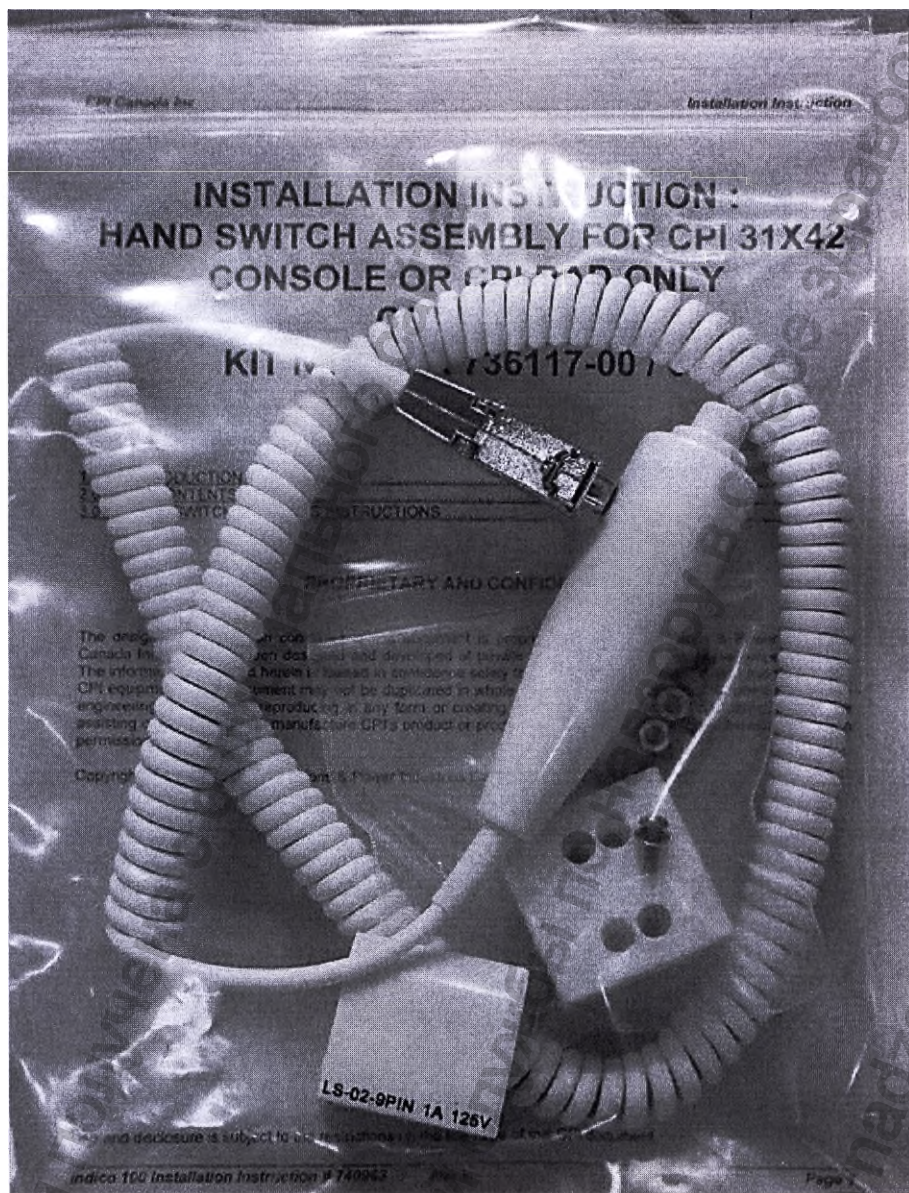

Устройство включения экспозиции
производства Communications & Power Industries
Inc., Канада или OMRON Corporation, Япония
на фото представлено устройство включения экспозиции
производства Communications & Power Industries Inc., Канада



Растр рентгеновский отсеивающий JPI
производства фирмы
JPI Healthcare Co., Ltd, Республика Корея

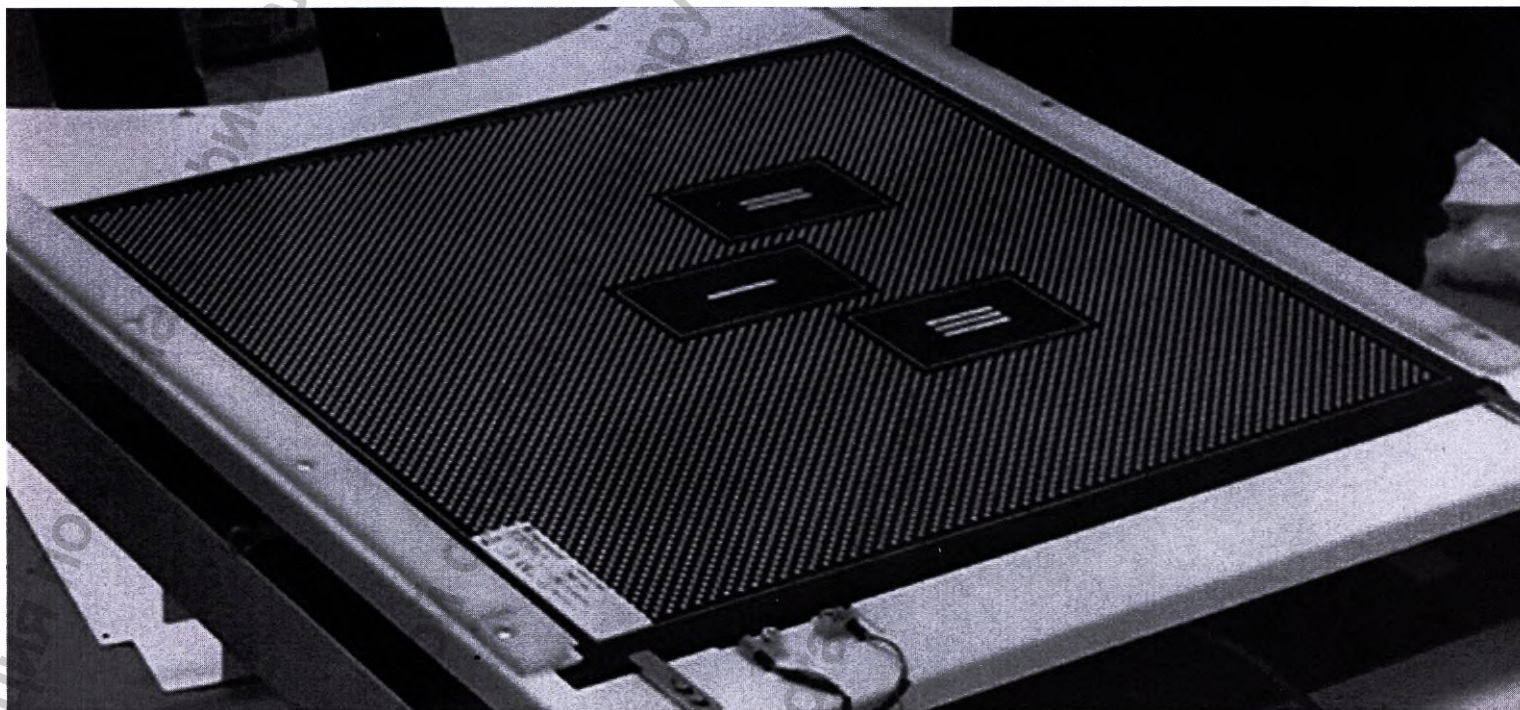


Ионизационная камера
(может комплектоваться управляющим кабелем)
серии SSMC

производства Varex Imaging Corporation, Нидерланды




Ионизационная камера (может комплектоваться
управляющим кабелем) 10358400 Dosemat,
производства Gilardoni, Италия

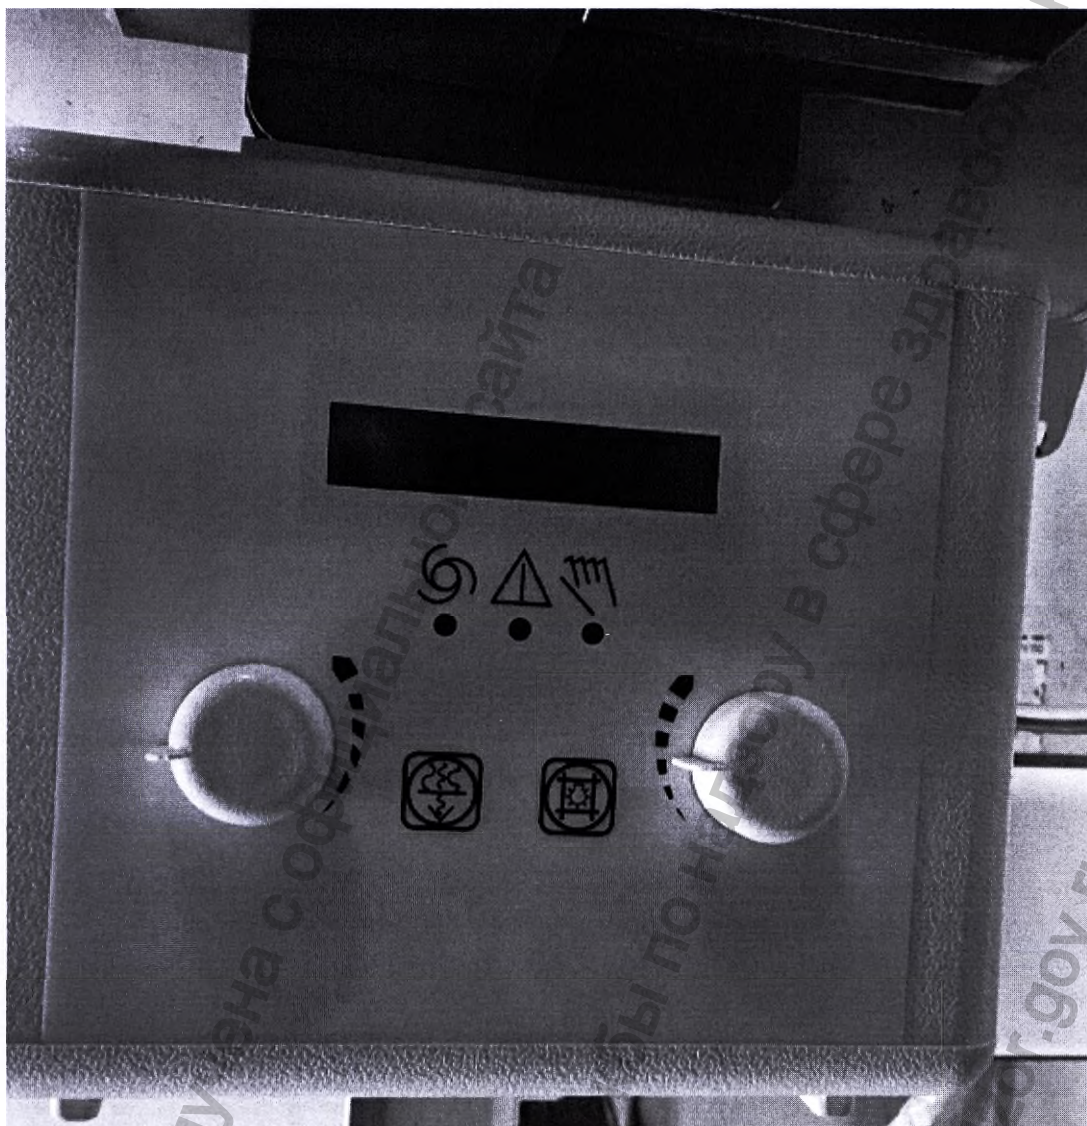


Коллиматор с соединительными элементами,
с автоматическим управлением
серия R225

(может комплектоваться автоматическими
или ручными сменными фильтрами)

производства Ralco S.r.l, Италия

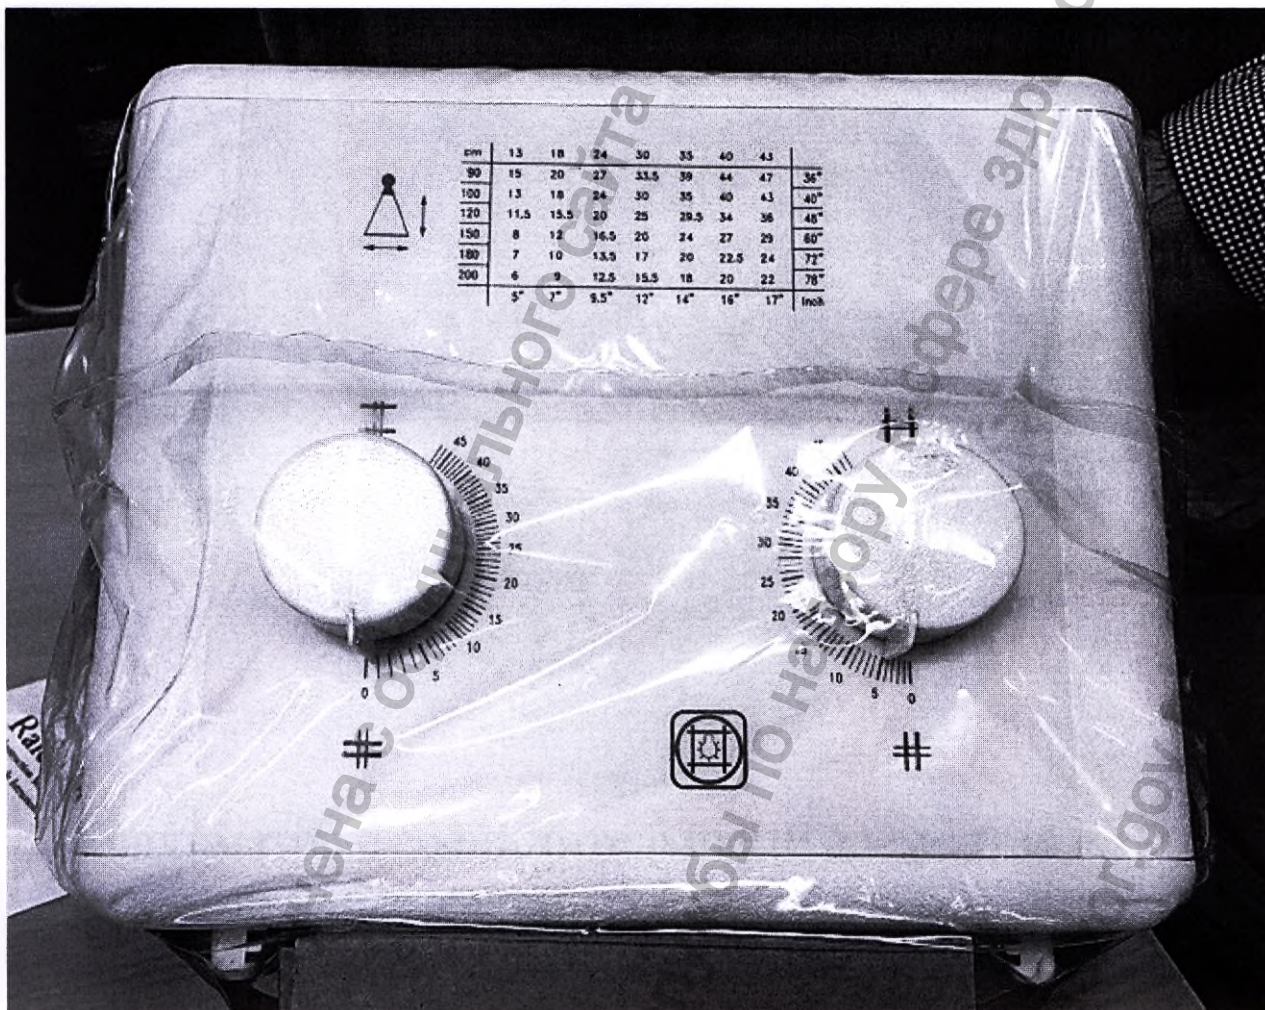


Коллиматор с соединительными элементами, с ручным управлением, серия R225 производства Ralco S.r.l, Италия

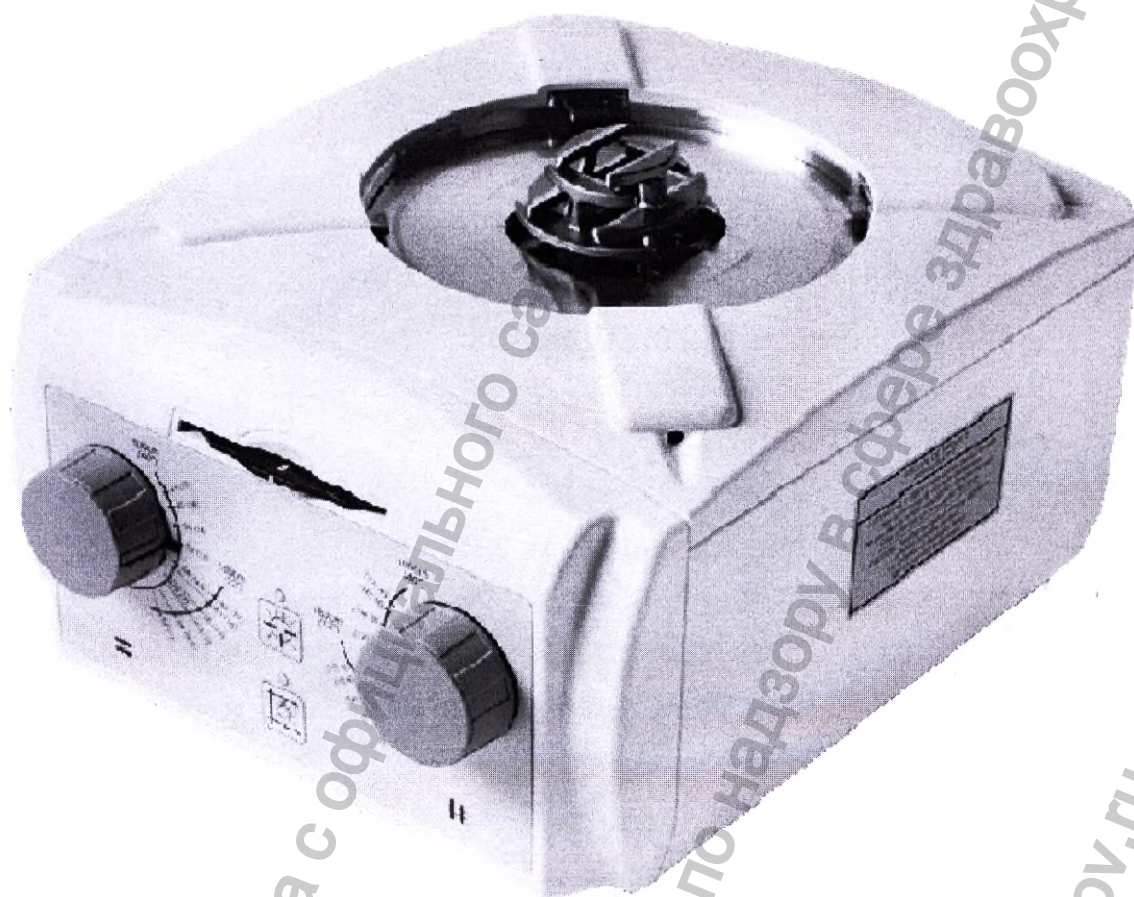

Коллиматор с соединительными элементами,
с ручным управлением
серия Optica 10
(может комплектоваться автоматическими
или ручными сменными фильтрами)
производства Varex Imaging Nederland B.V.,
Нидерланды или Varex Imaging Corporation,
США или Varex Imaging Corporation, Филиппины




Коллиматор с соединительными элементами,
с автоматическим управлением
серия Optica 30
(может комплектоваться автоматическими
или ручными сменными фильтрами)
производства Varex Imaging Nederland B.V.,
Нидерланды или Varex Imaging Corporation,
США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

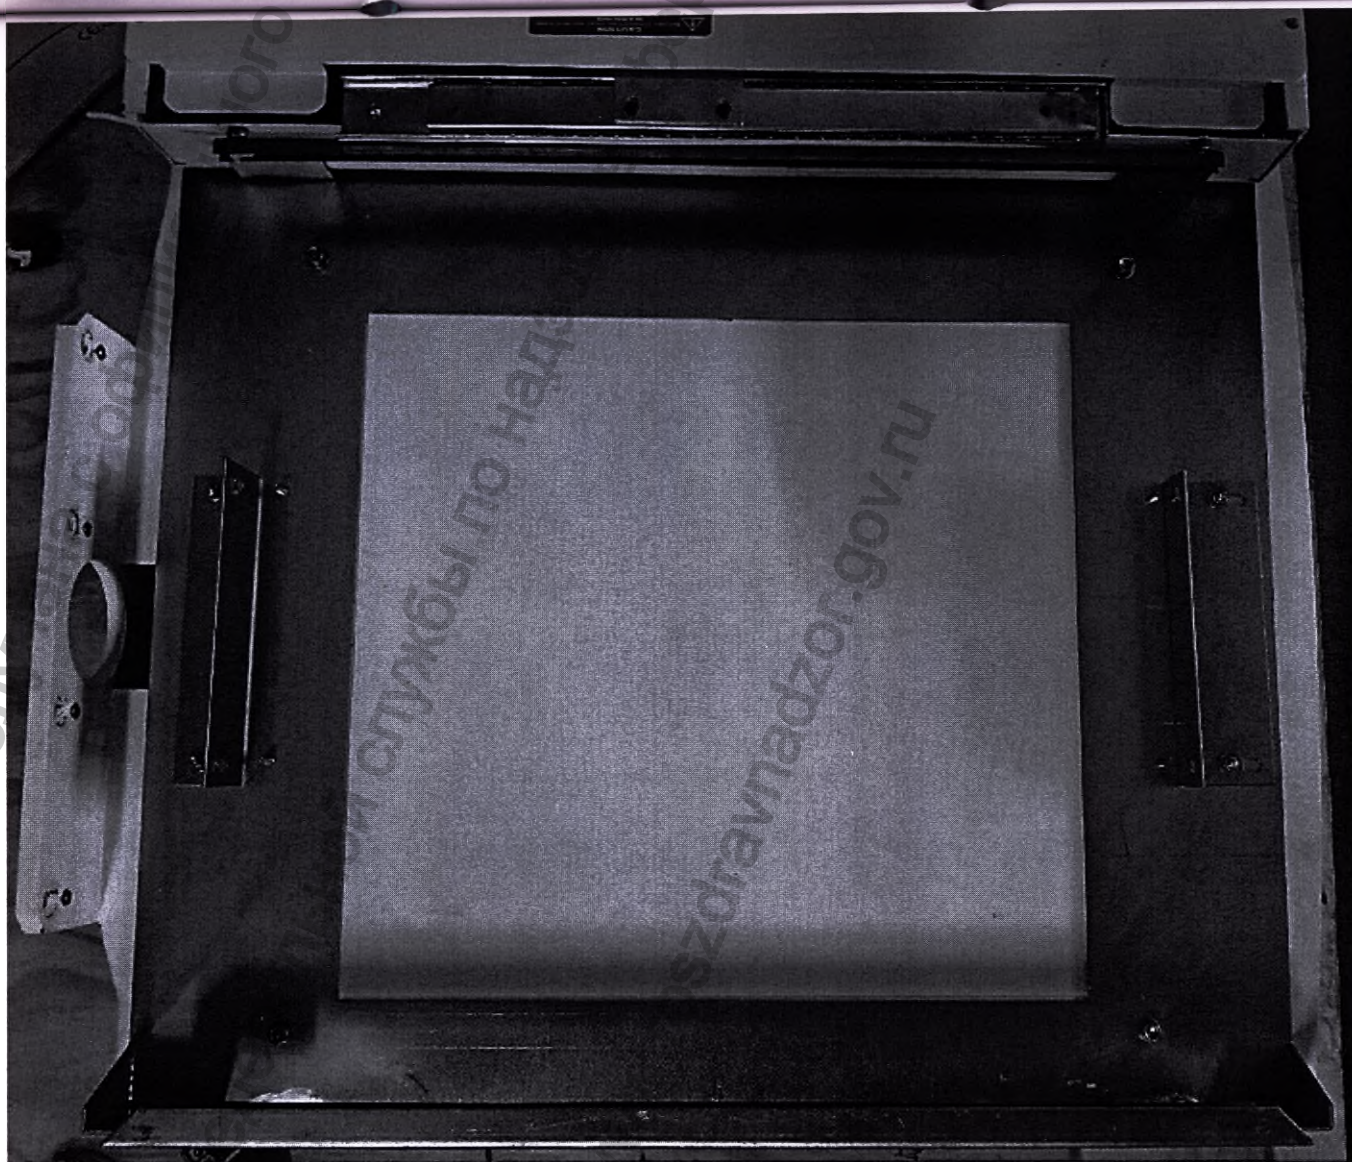

Адаптер для встроенного детектора URSKITFDX4343R,
производства фирмы Sedecal S.A., Испания



Комплект (пара) высоковольтных кабелей с наконечниками,
производства Varex Imaging Corporation , США
или Varex Imaging Corporation , Китай

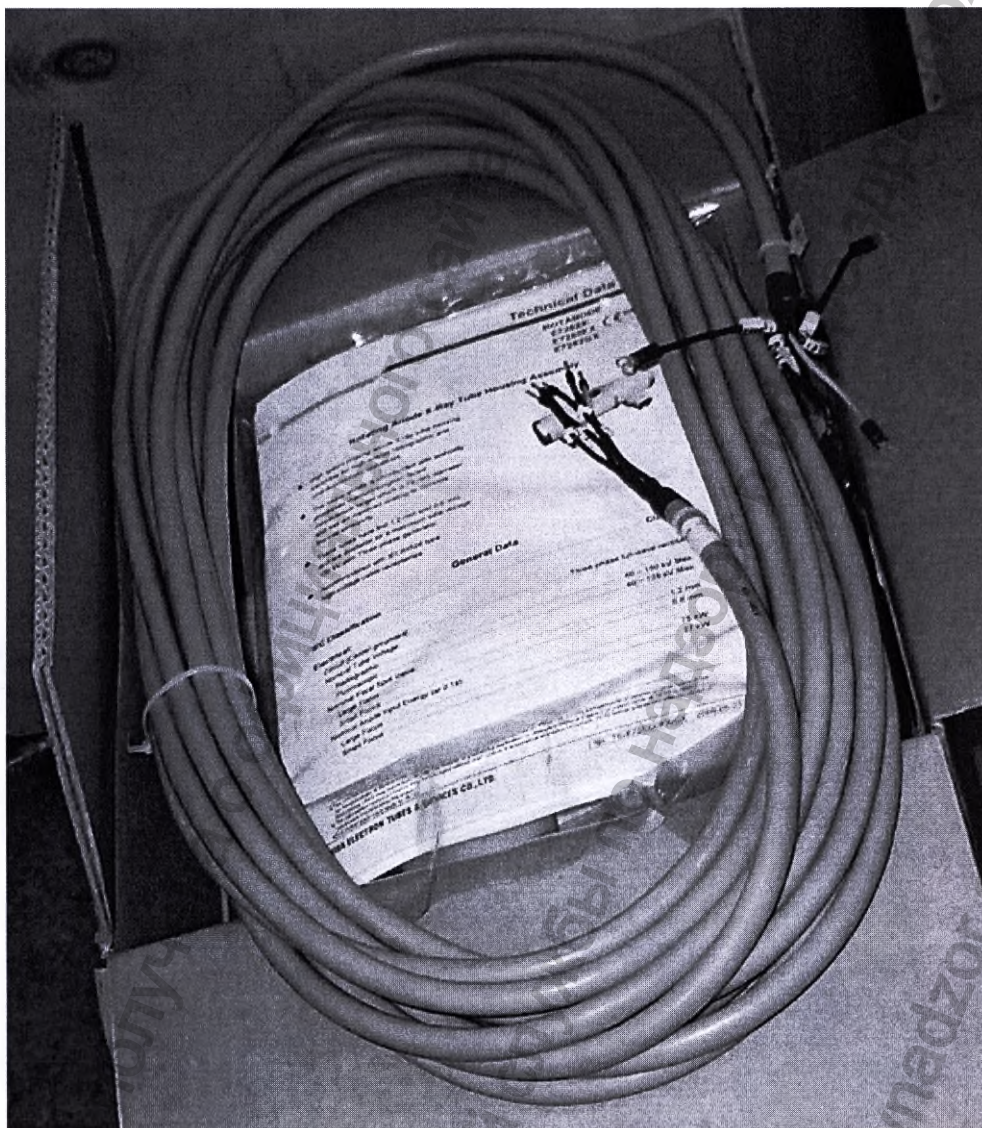


Комплект коммутирующих кабелей с соединительными элементами, производства фирмы Sedecal S.A., Испания




Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений "СОЛО ДР-МТ" производства АО "МТЛ", Россия




**Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога
«ДИАРМ-МТ-Плюс» производства АО «МТЛ», Россия**

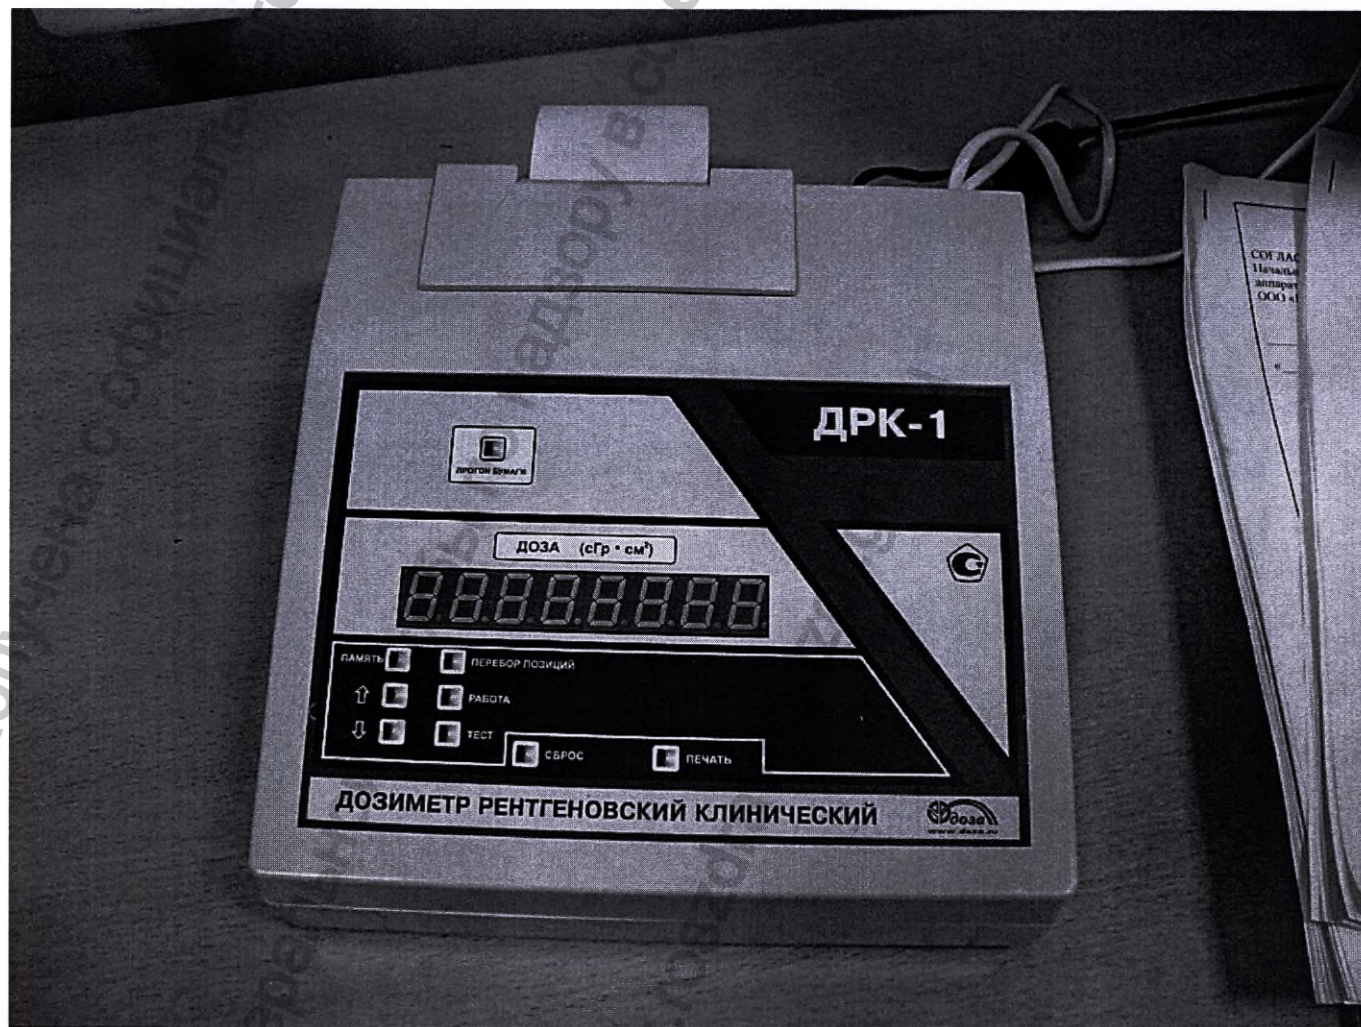

Дозиметр рентгеновского излучения
клинический ДРК-1
производства ООО НПП «Доза», Россия

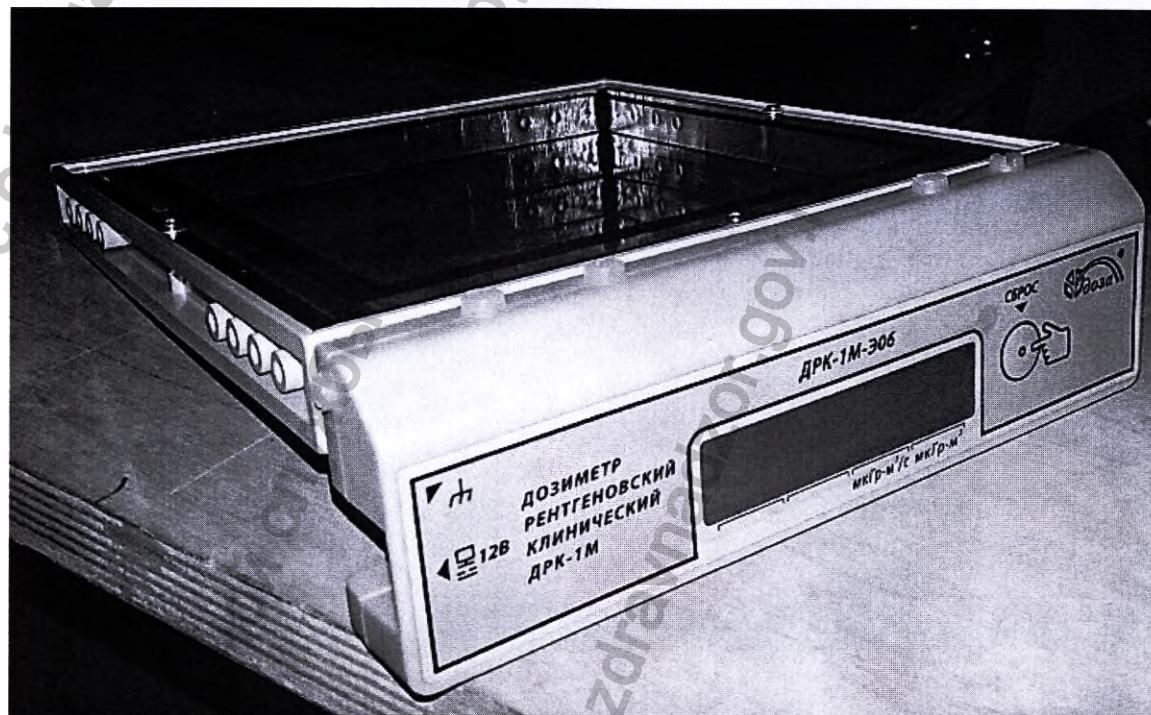

Дозиметр рентгеновского излучения клинический
ДРК-1М
производства НПП «Доза», Россия

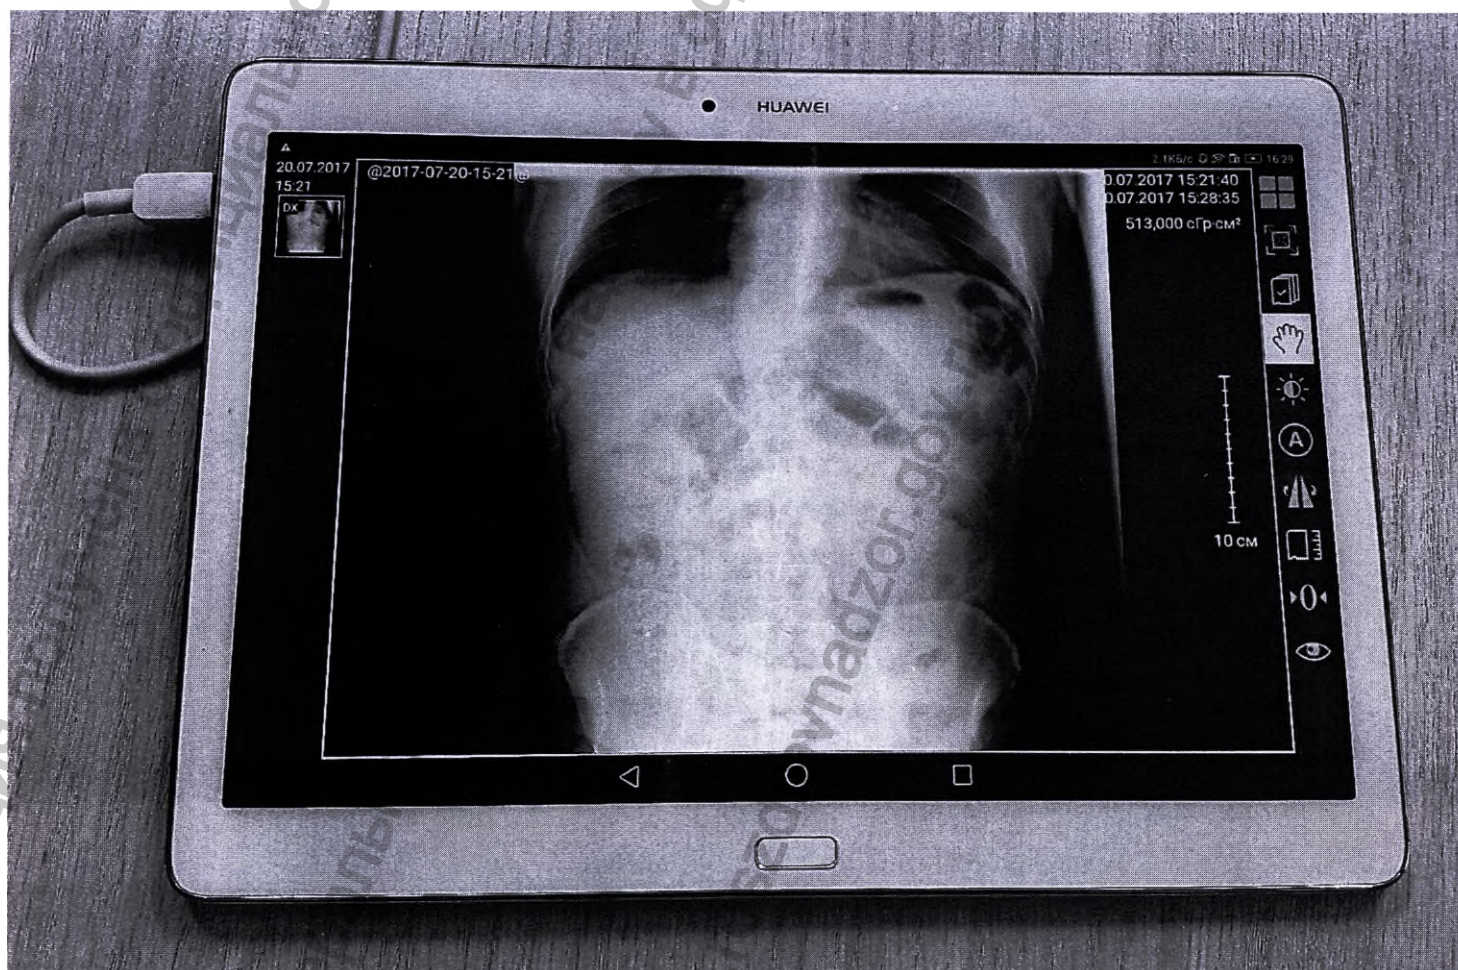


Просмотровая станция врача-рентгенолога
производства АО «МТЛ», Россия



Портативная медицинская рабочая станция
производства АО «МТЛ», Россия




Программный пакет «ИнтеГРИС CS»,
производства ООО «Лаборатория
Инноваций МТ», Россия

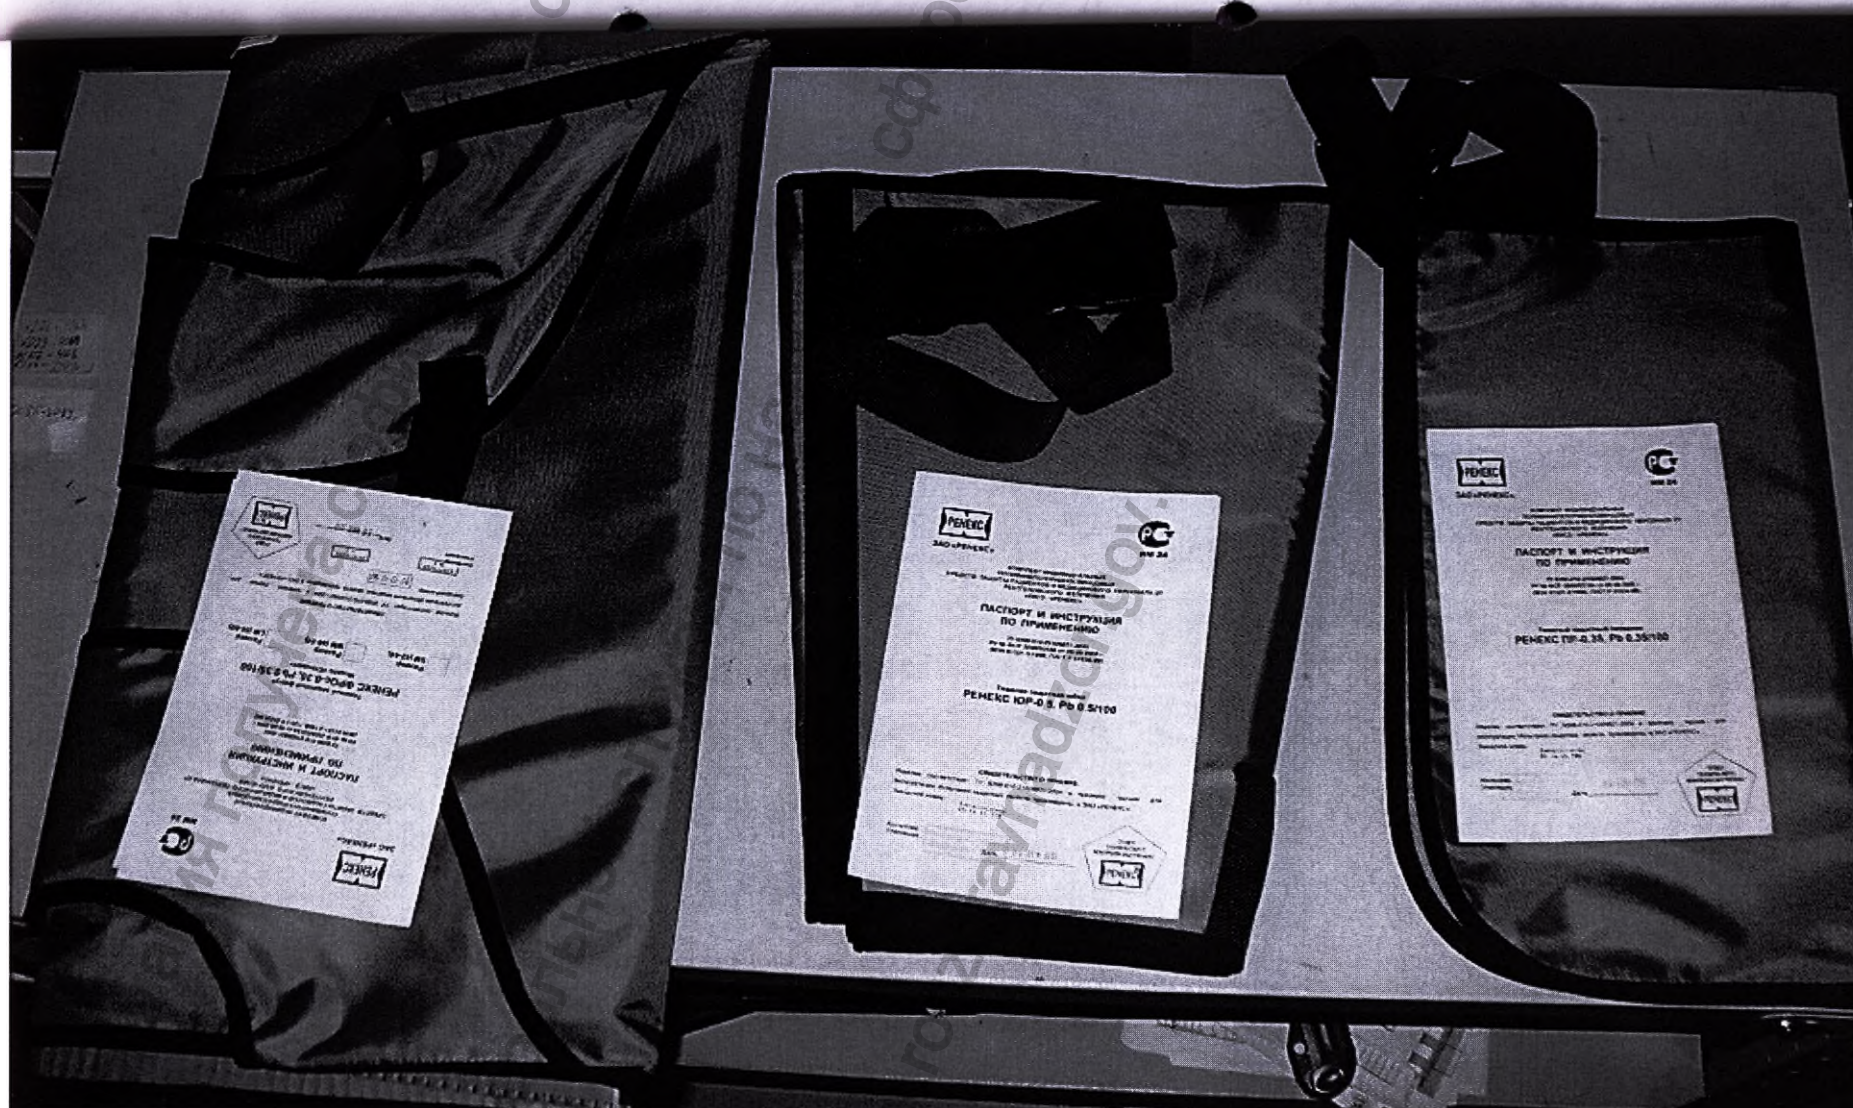

Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты
пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения
КИСЗ-«РЕНЕКС»

производства ЗАО «РЕНЕКС», Россия

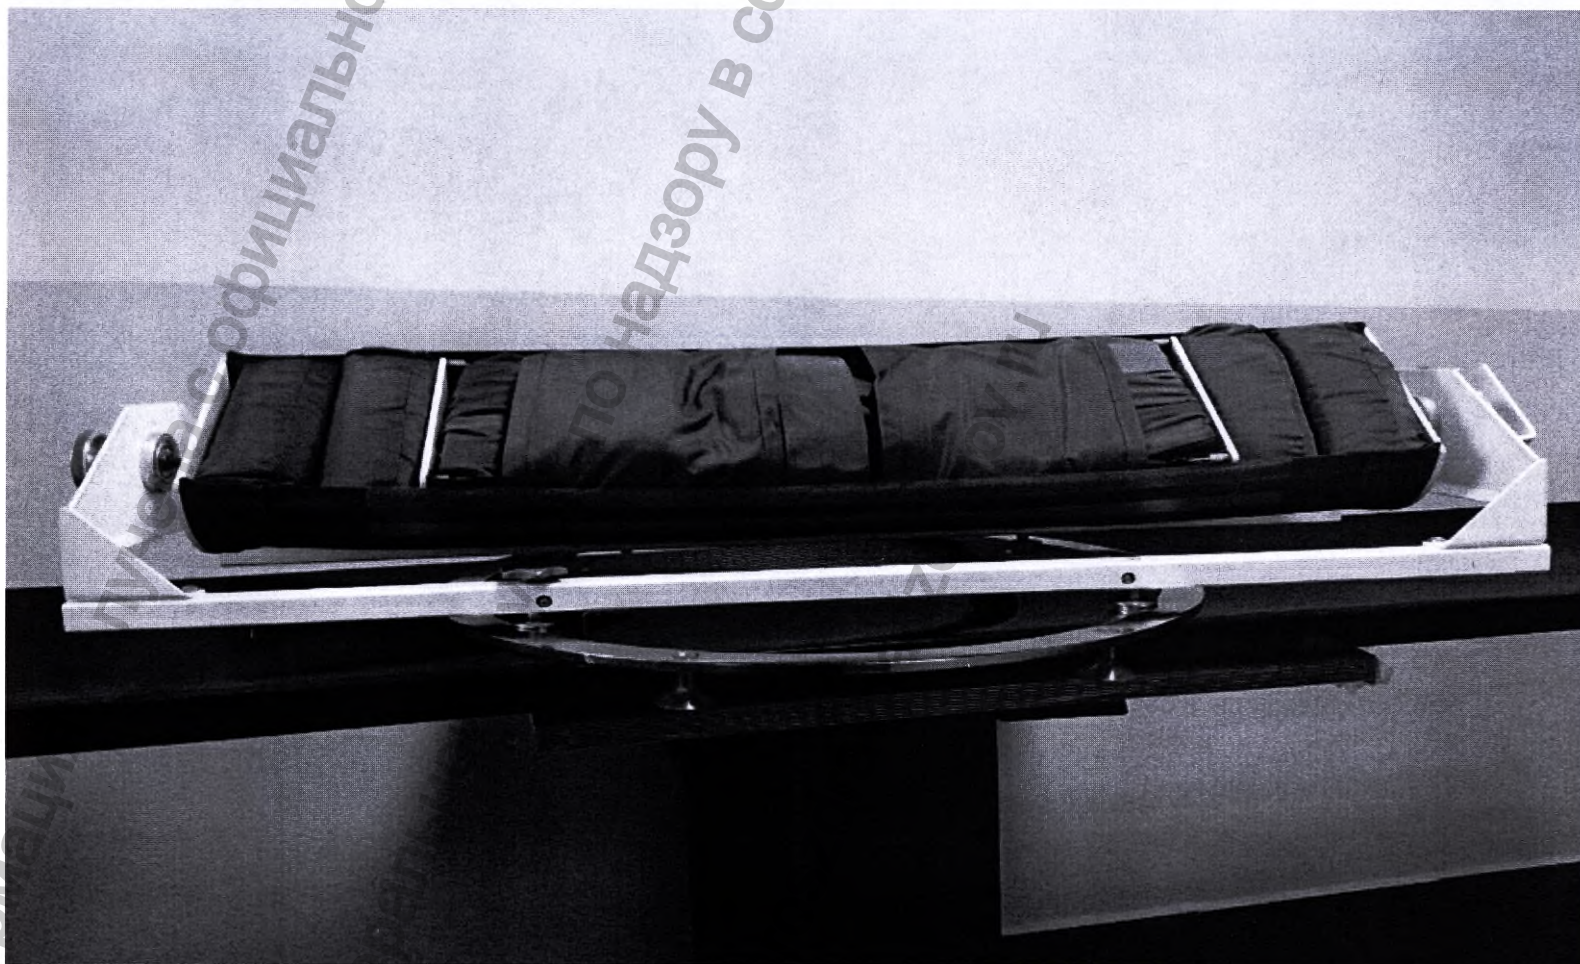

Люлька детская двойного поворота передвижная для
полипозиционных исследований ЛДДП-1

производства ООО «СпектрАп», Россия



Крепление детское универсальное производства ИП Давлетов Д.Я., Россия

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



ИК-пульт дистанционного управления
рентгенографическим штативом,
производства фирмы Sedecal S.A.,
Испания




Рентгенопрозрачный стол-каталка
производства Sedecal S.A., Испания



Беспроводная кнопка включения экспозиции
производства АО «МТЛ», Россия



Беспроводная педаль включения экспозиции, производства
АО «МТЛ», Россия

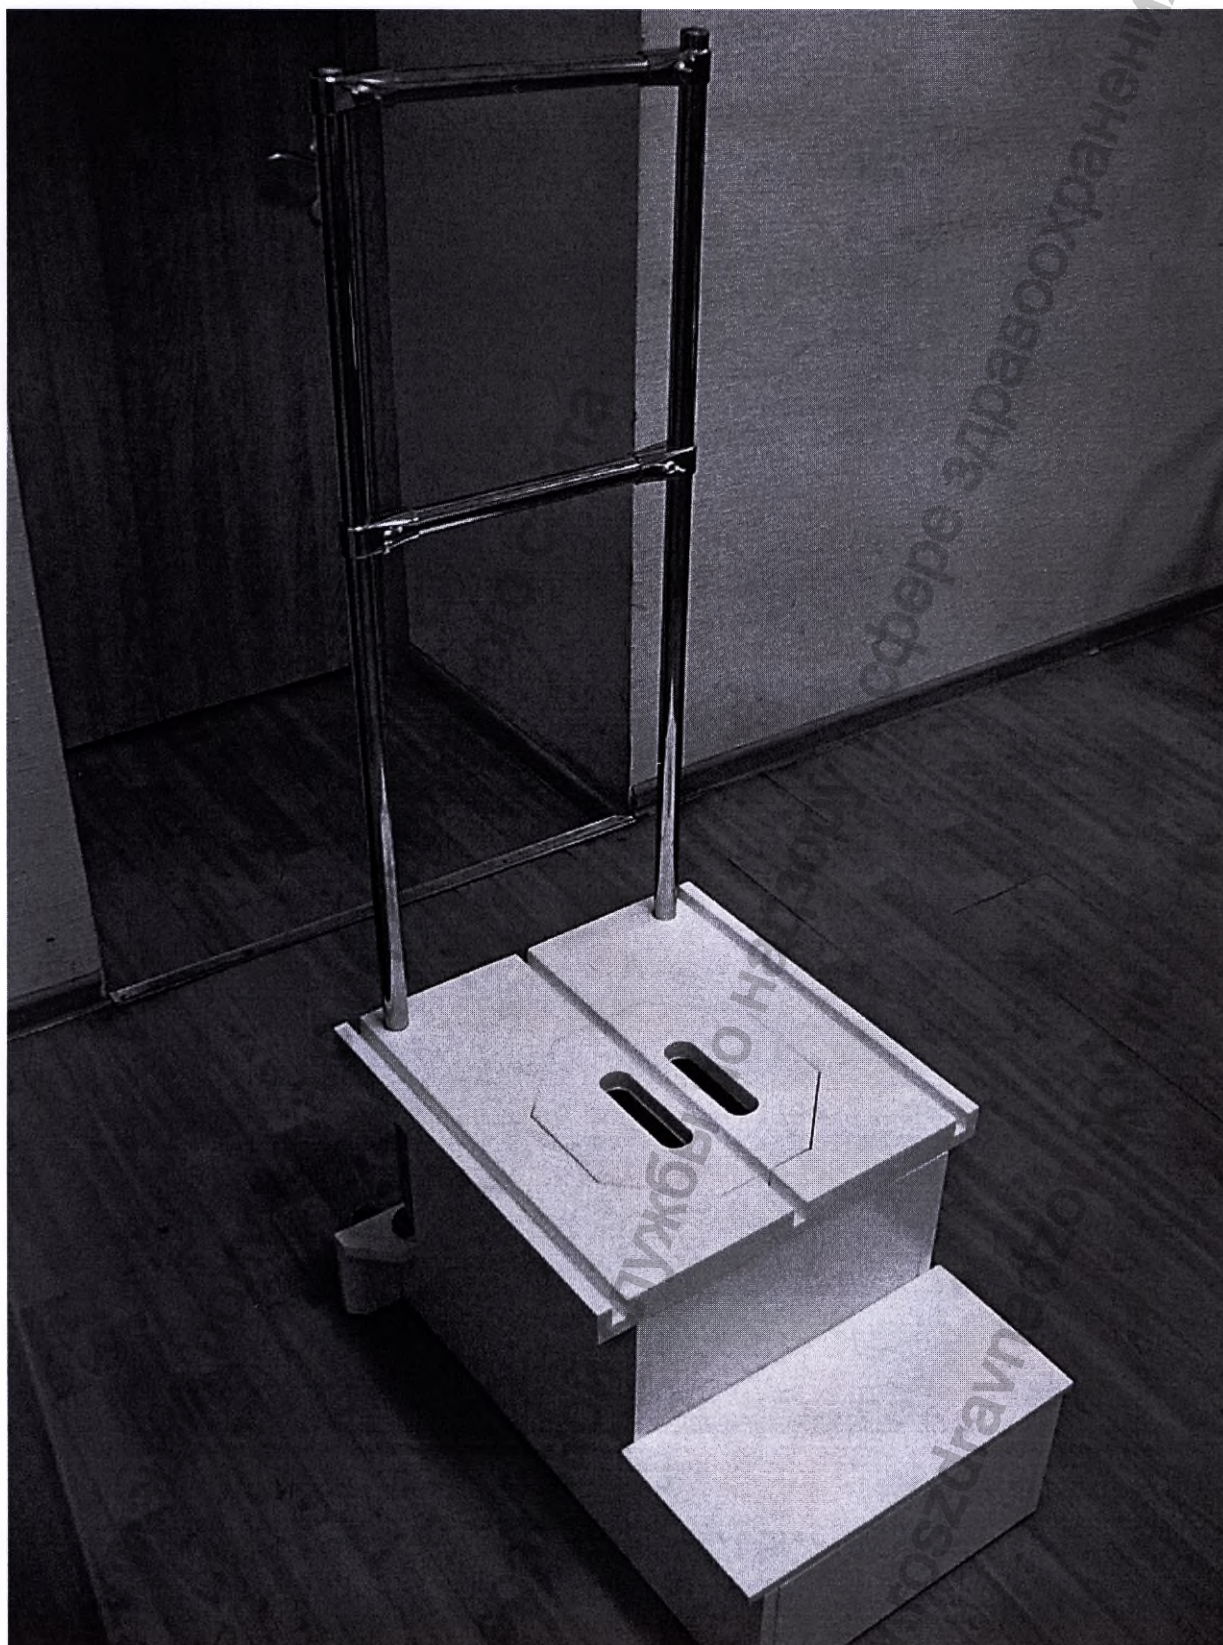

Многофункциональное устройство фиксации МУФ-МТ,
производства АО «МТЛ», Россия



**Вводно-распределительное
устройство (ВРУ)**
производства ООО «АйТек», Россия

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере


www.roszdravnadzor.ru



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 44 листов
Генеральный директор
А.И. Исаев



**Макеты маркировки и упаковки
медицинского изделия
Аппарат универсальный
рентгенографический диагностический
«УнивеРС-Флюорограф-МТ»,
производства
АО «МТЛ», Россия**

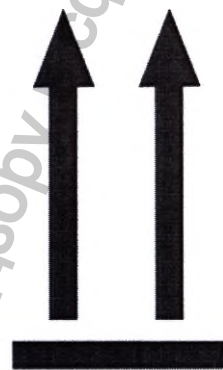



Аппарат универсальный рентгенографический диагностический «УнивеРС-Флюорограф-МТ»

Заводской номер:

Год и месяц упаковывания:

Место /2

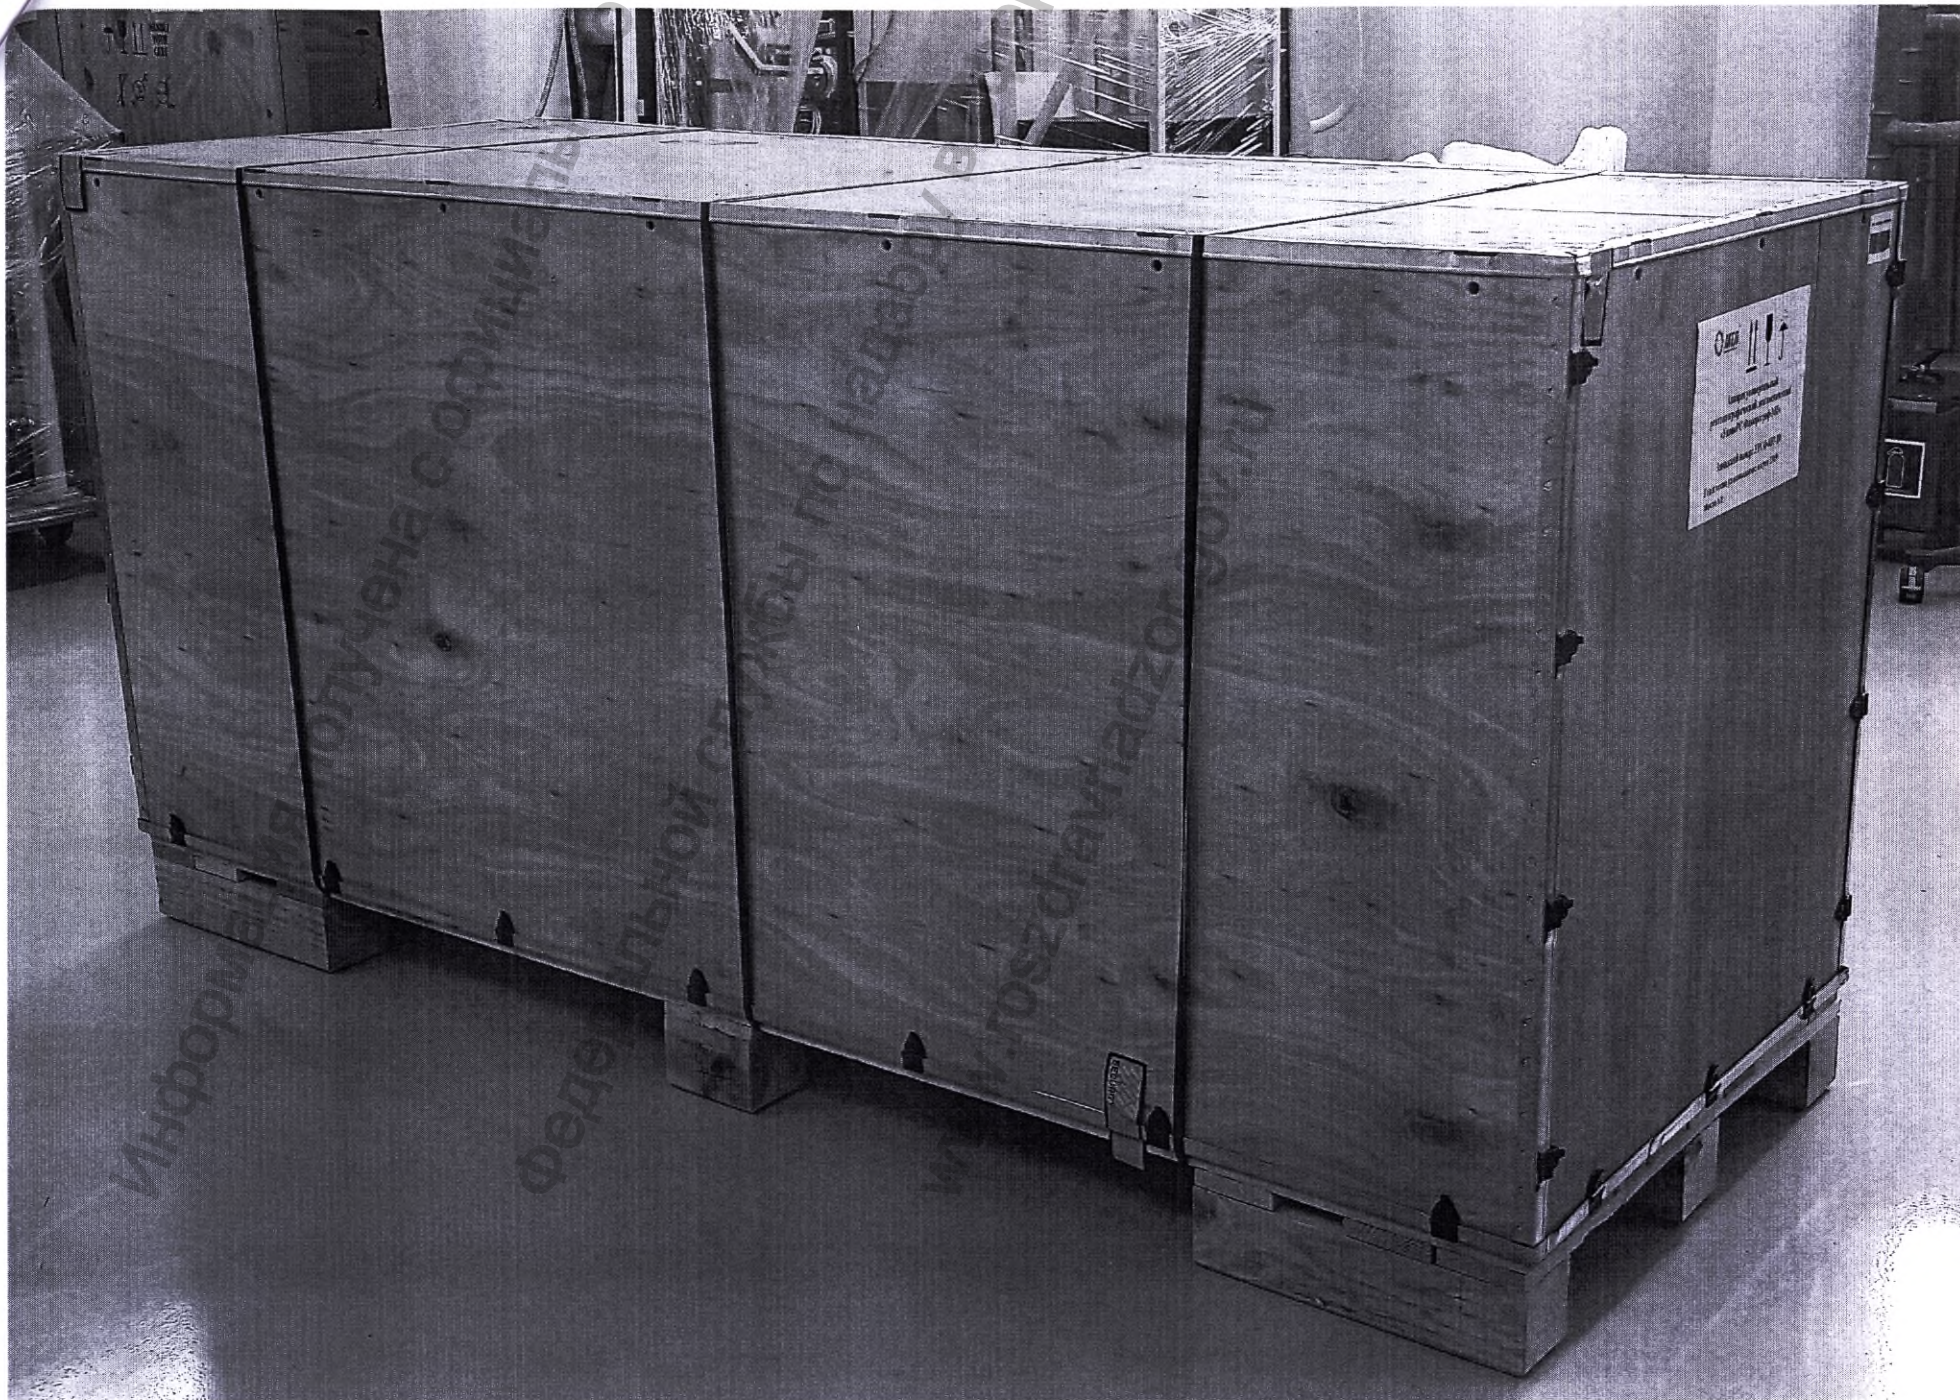

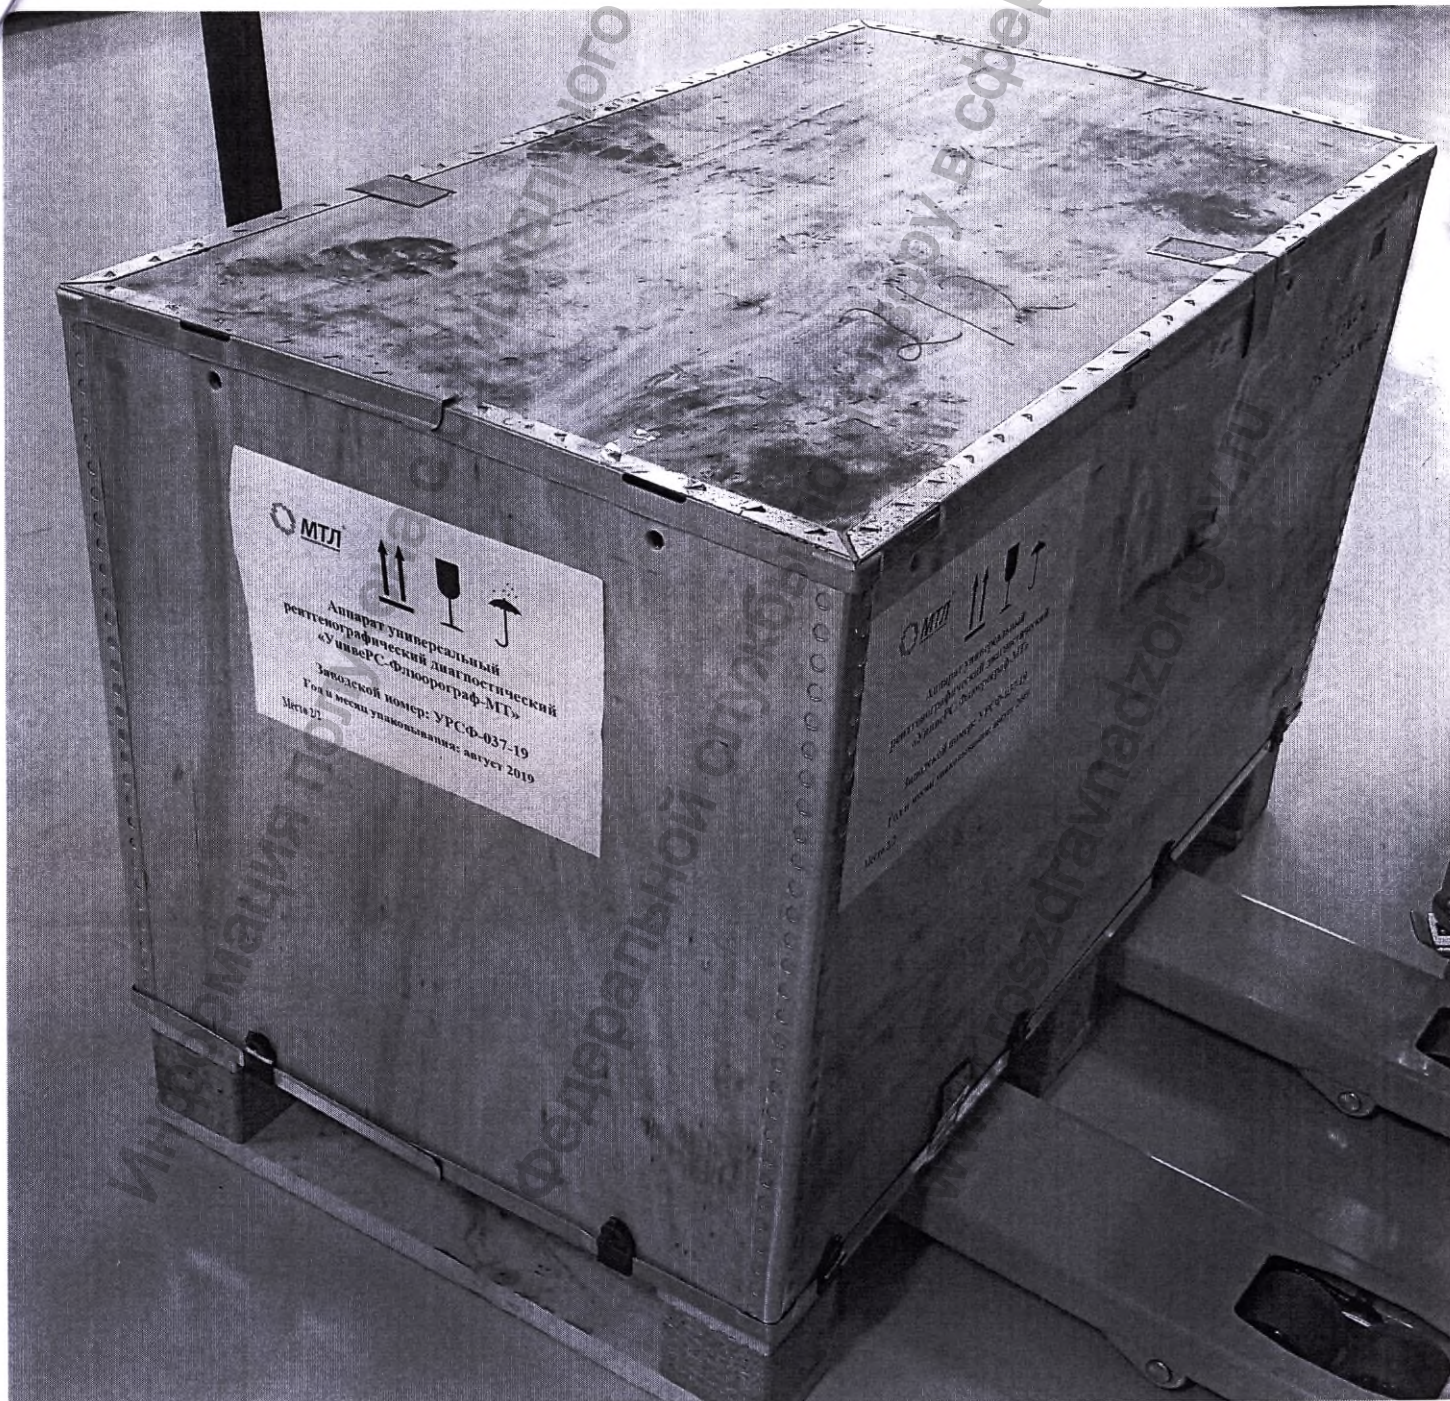

Макет маркировки изделия

АО «МТЛ»	
Аппарат универсальный рентгенографический диагностический «УнивеРС-Флюорограф-МТ»	
Исполнение «УнивеРС-Флюорограф-МТ»-	Потребляемая мощность: ___ кВА
Зав. номер УРСФ- -	Питание: 3 ~ 380 В 50 Гц
ТУ 26.60.11-057-47245915-2017	Выходная мощность: ___ кВт
Дата выпуска ..20	Класс I 
ЕАС 	
Сделано в России	

Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения наносится методом стикерования.

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.roszdravnadzor.gov.ru

