Общество с ограниченной ответственностью

«Центр сертификации и регистрации медицинских изделий»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЦСРМИ»,

_____Зарубина Е.А.
М.П.
«27» ноября 2018 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex в различных вариантах исполнения (Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., China)

2018

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

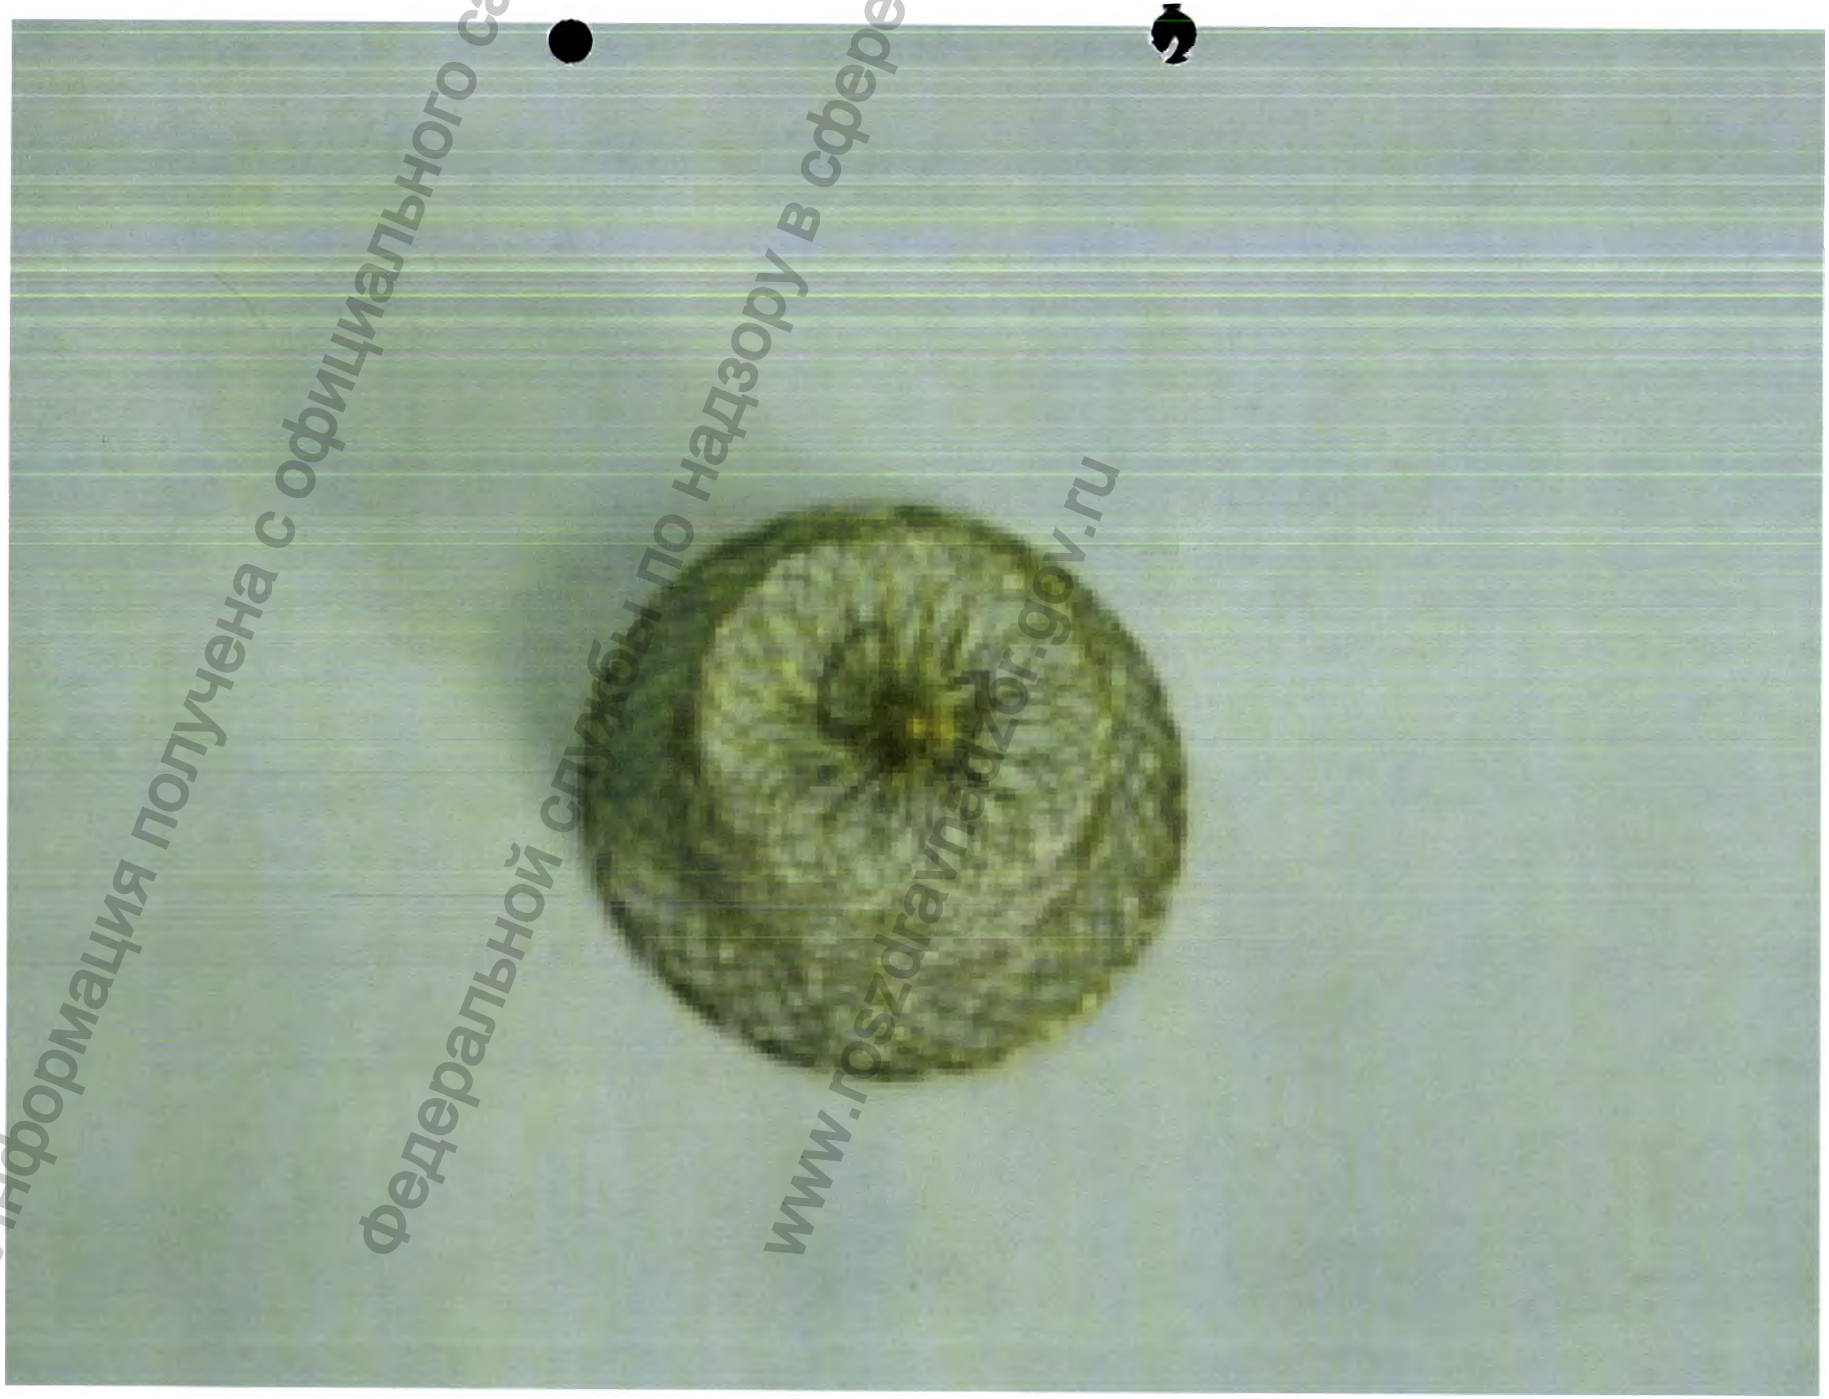

Окклюдер CeraFlex (вид спереди).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

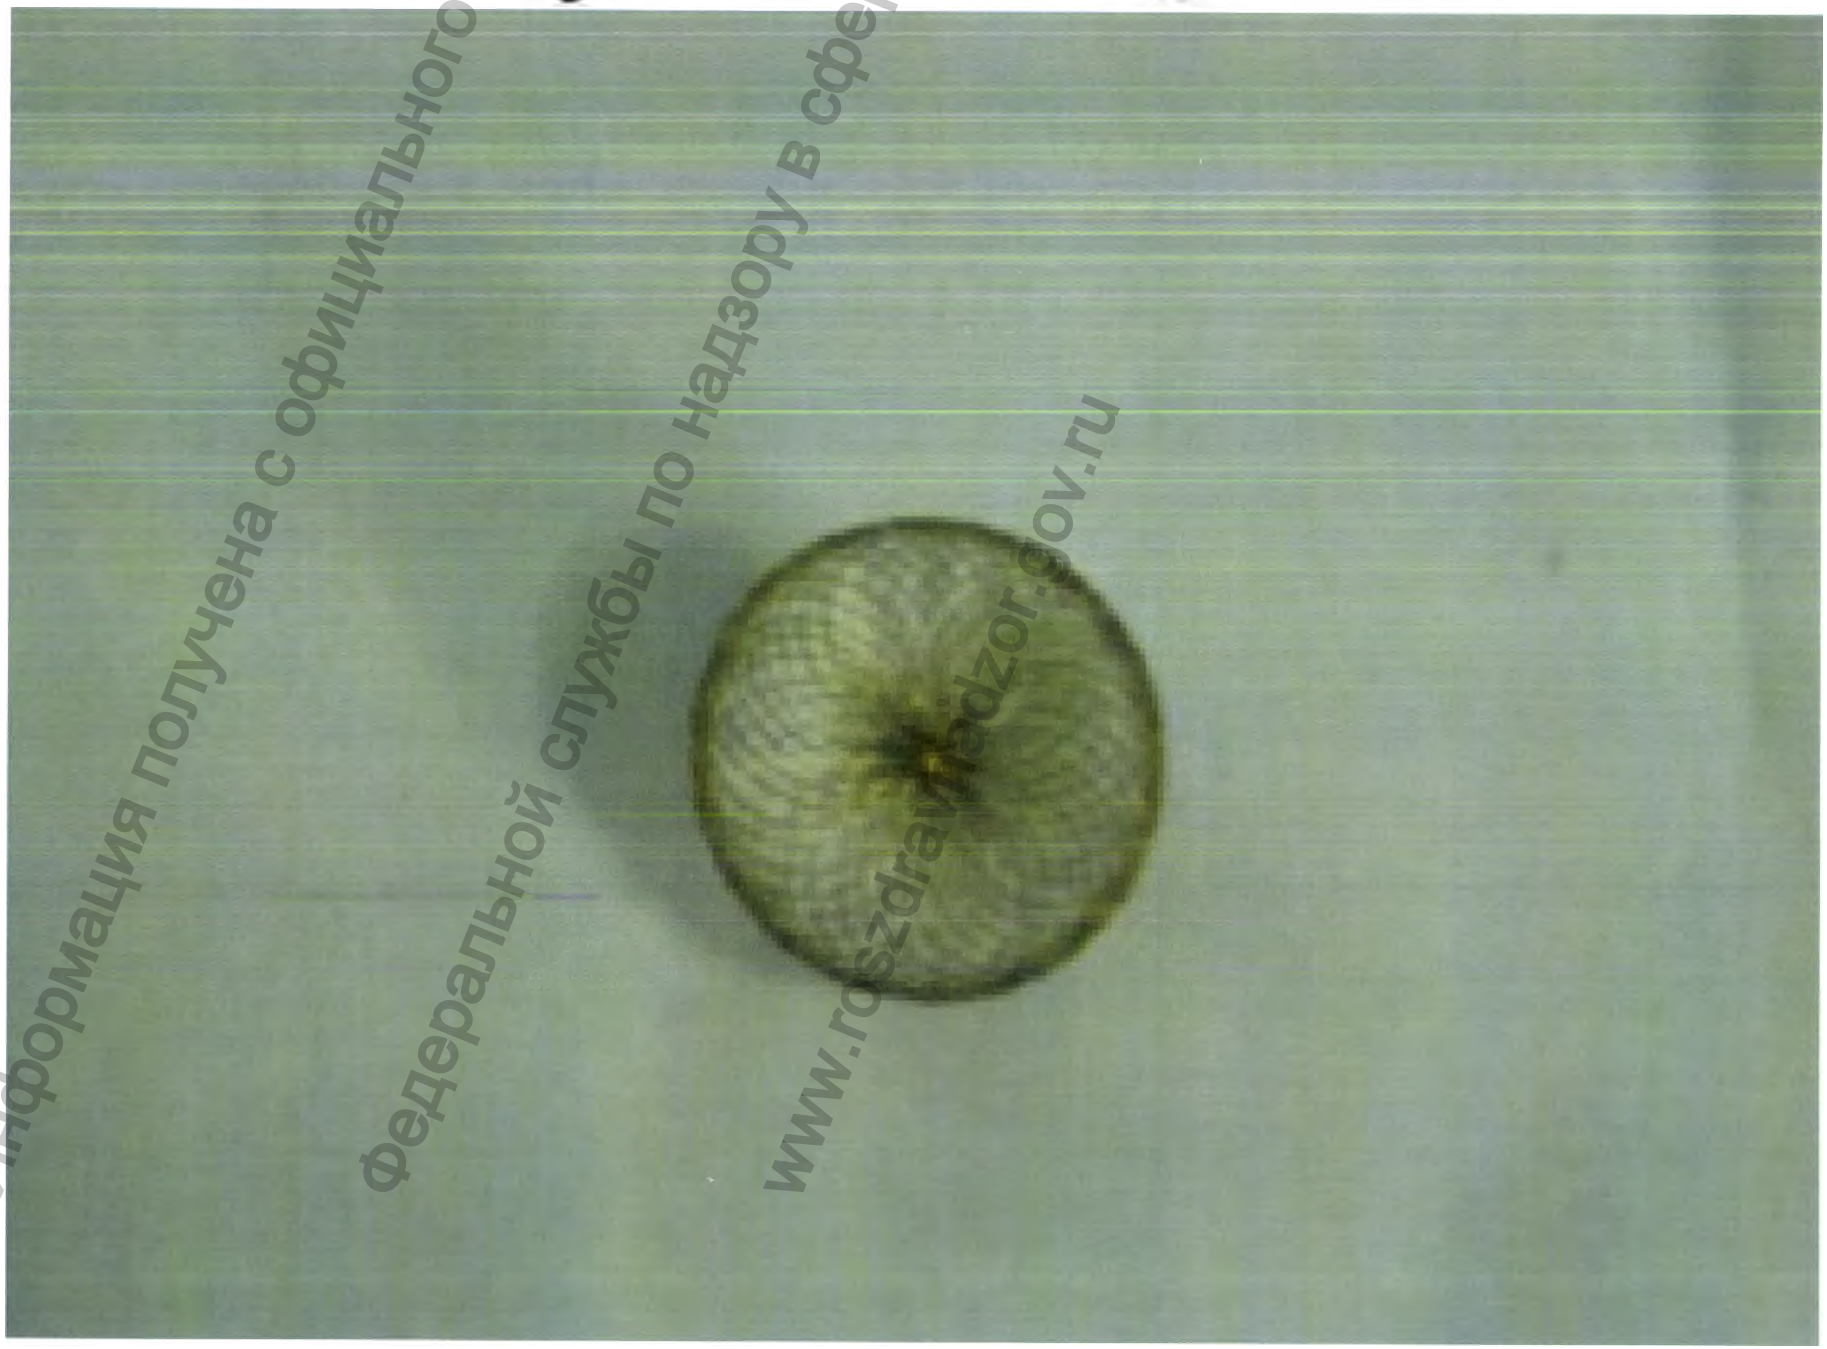

Окклюдер CeraFlex (вид сзади).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

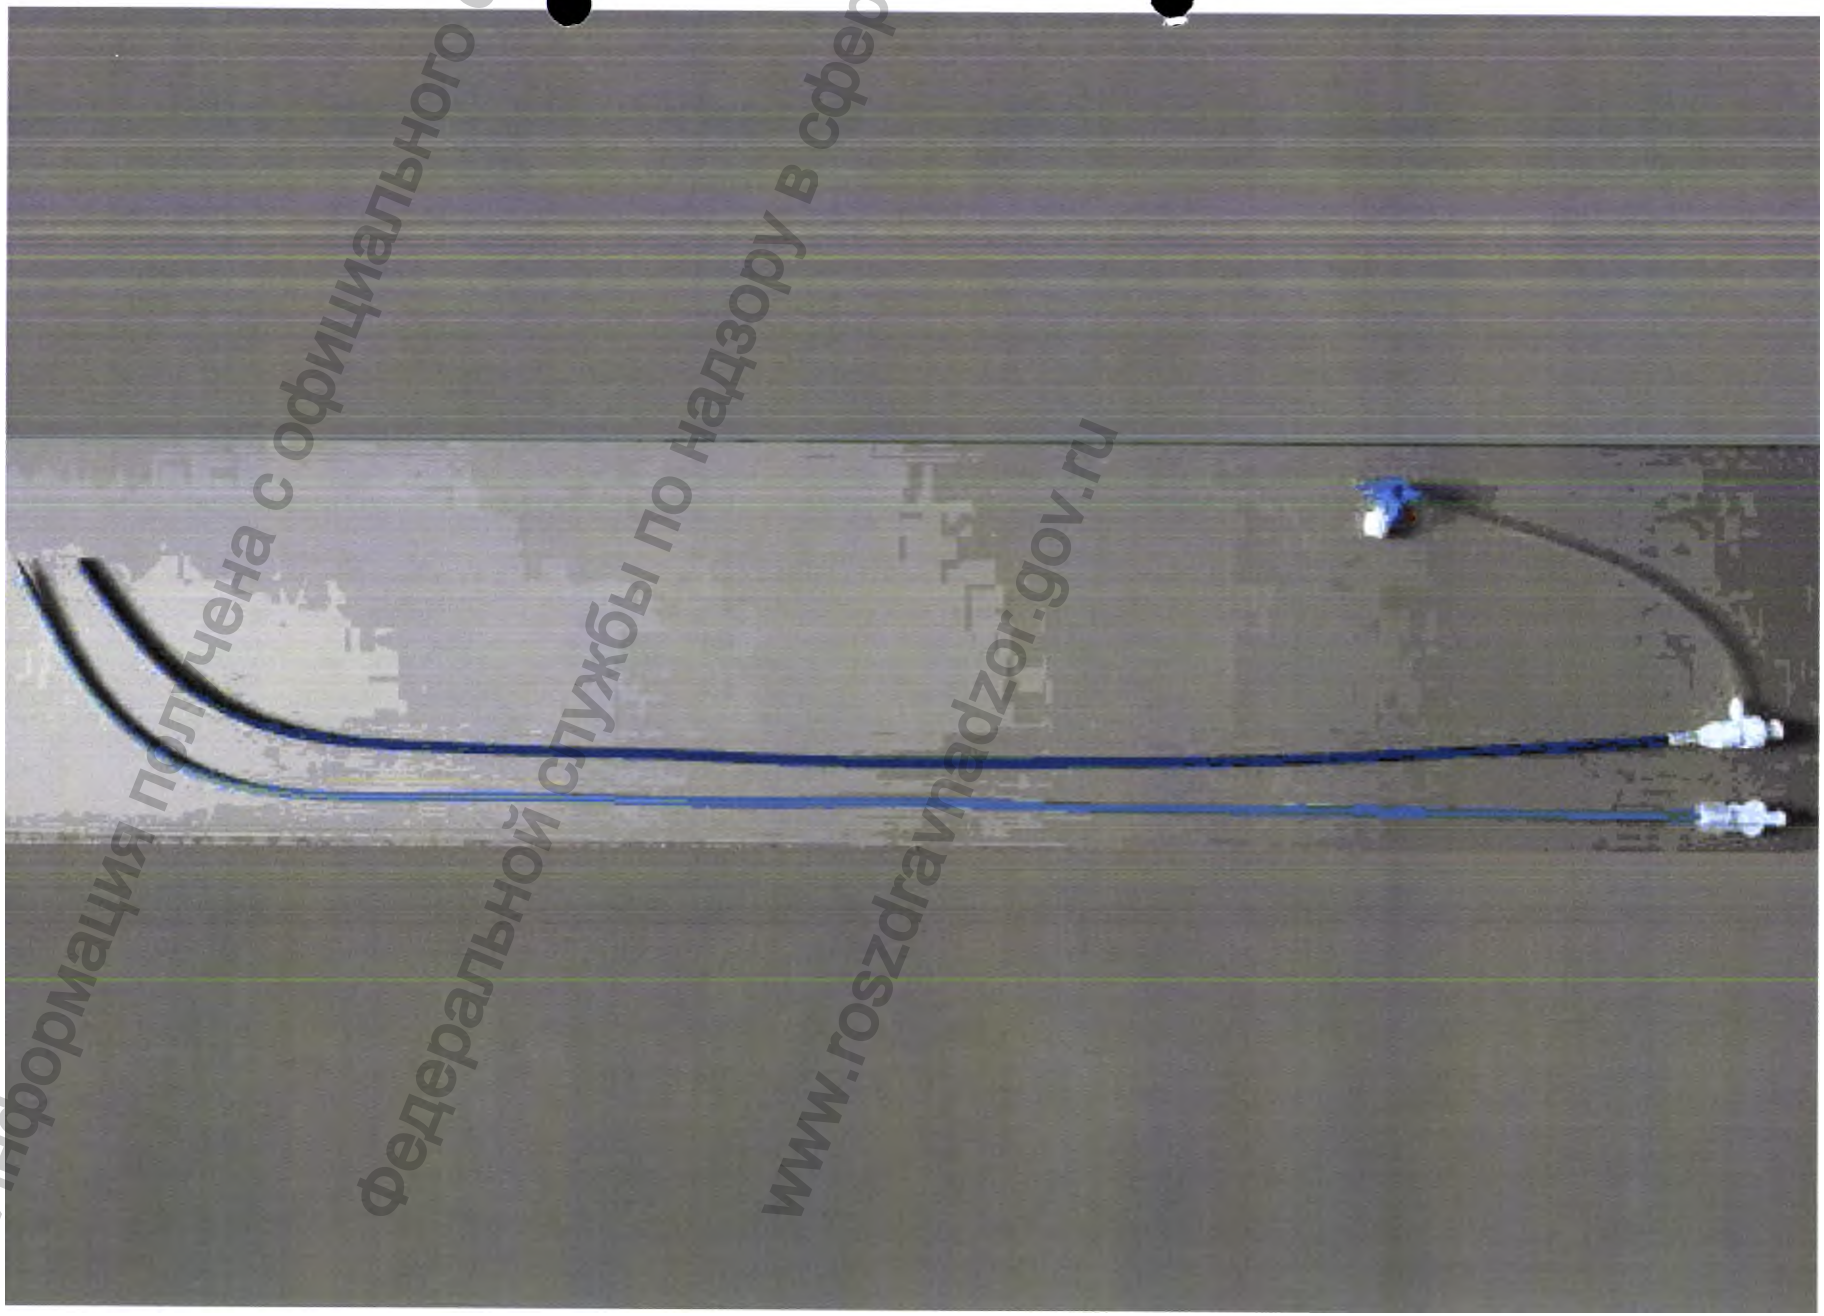

Интродьюсер SteerEase; Расширитель.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

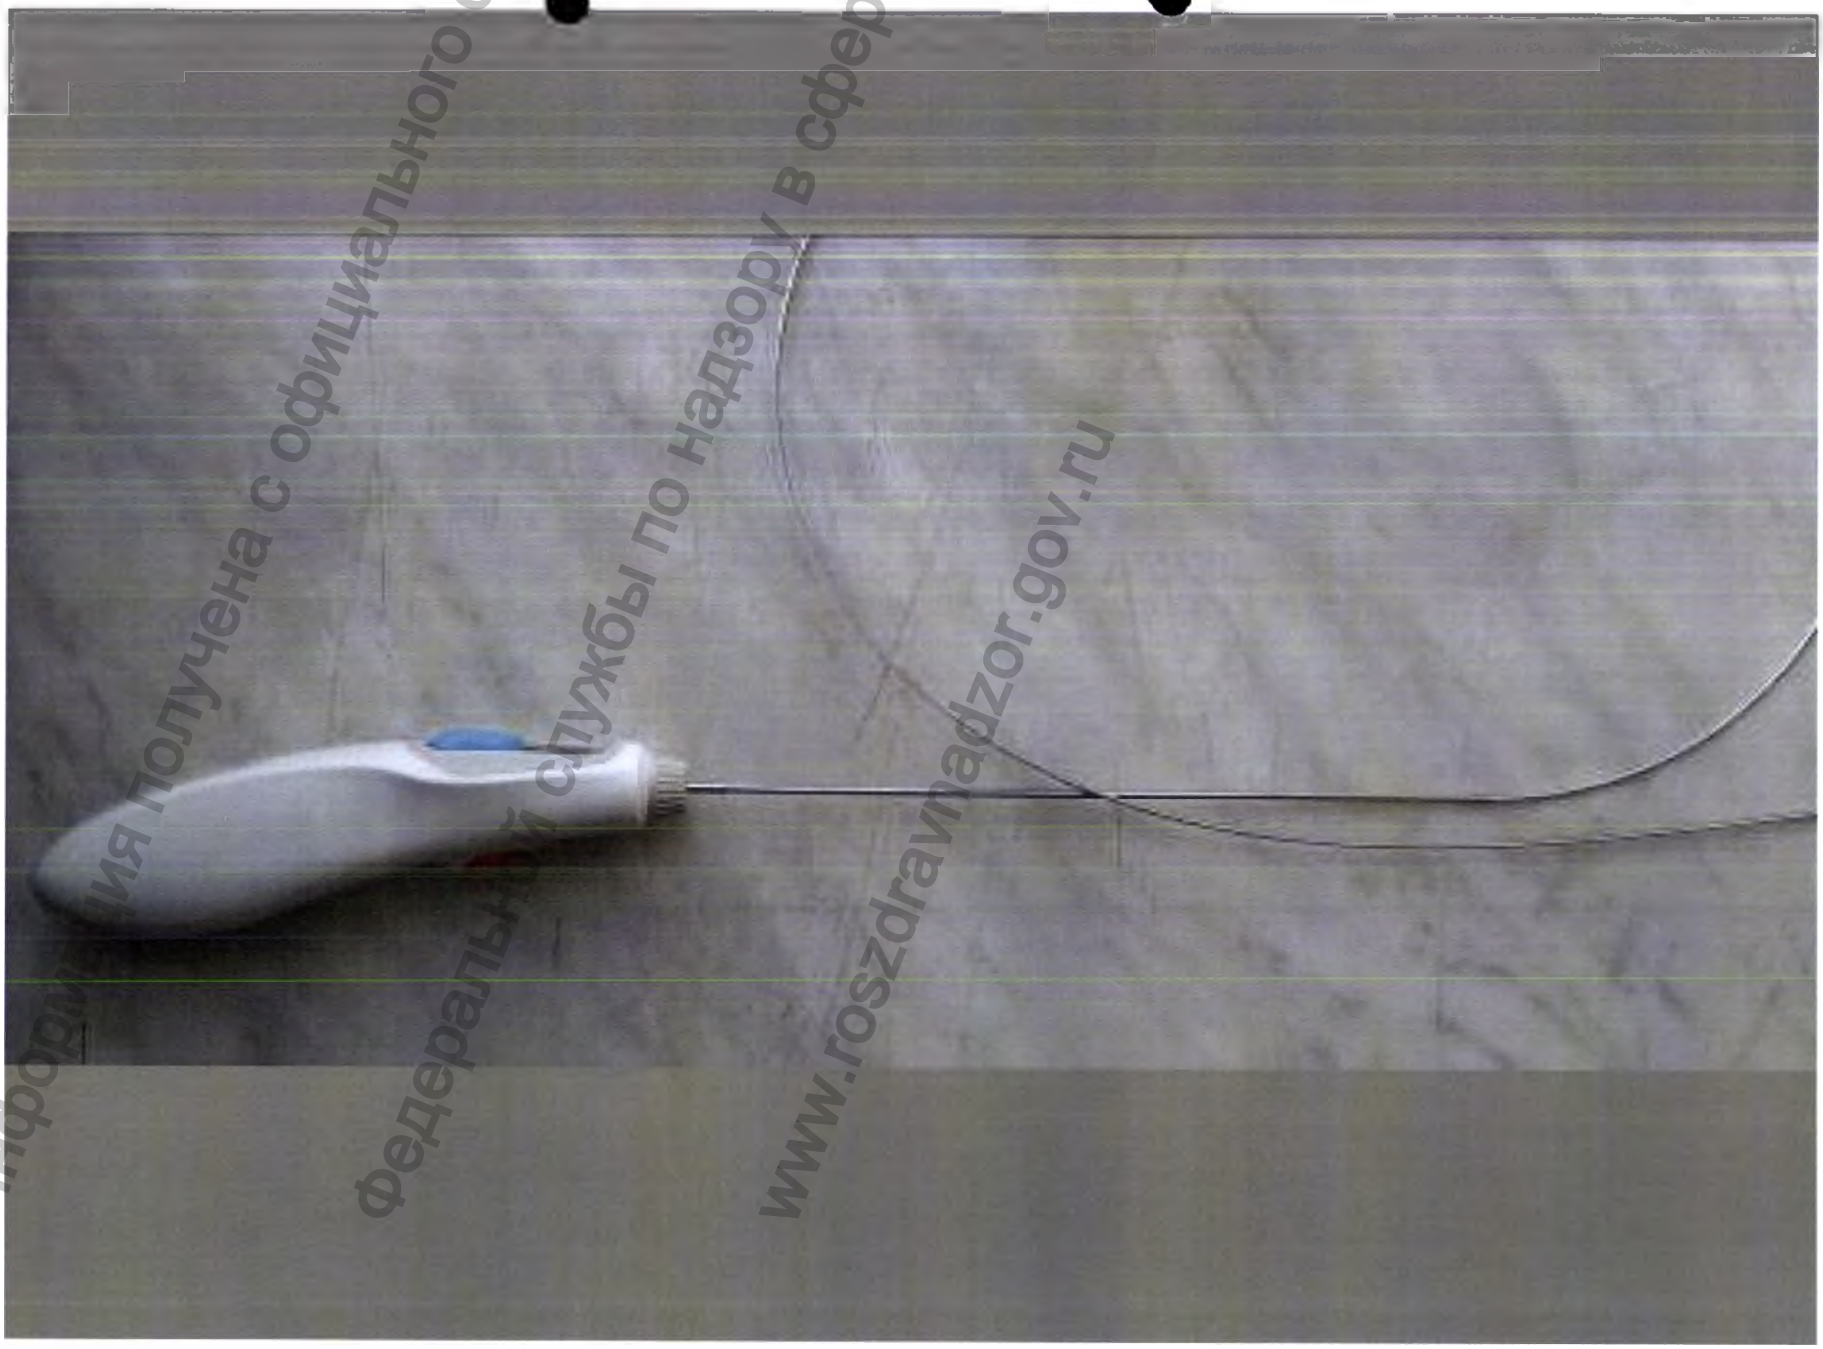

Кабель доставки с пластиковыми тисками/рукояткой (проксимально).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

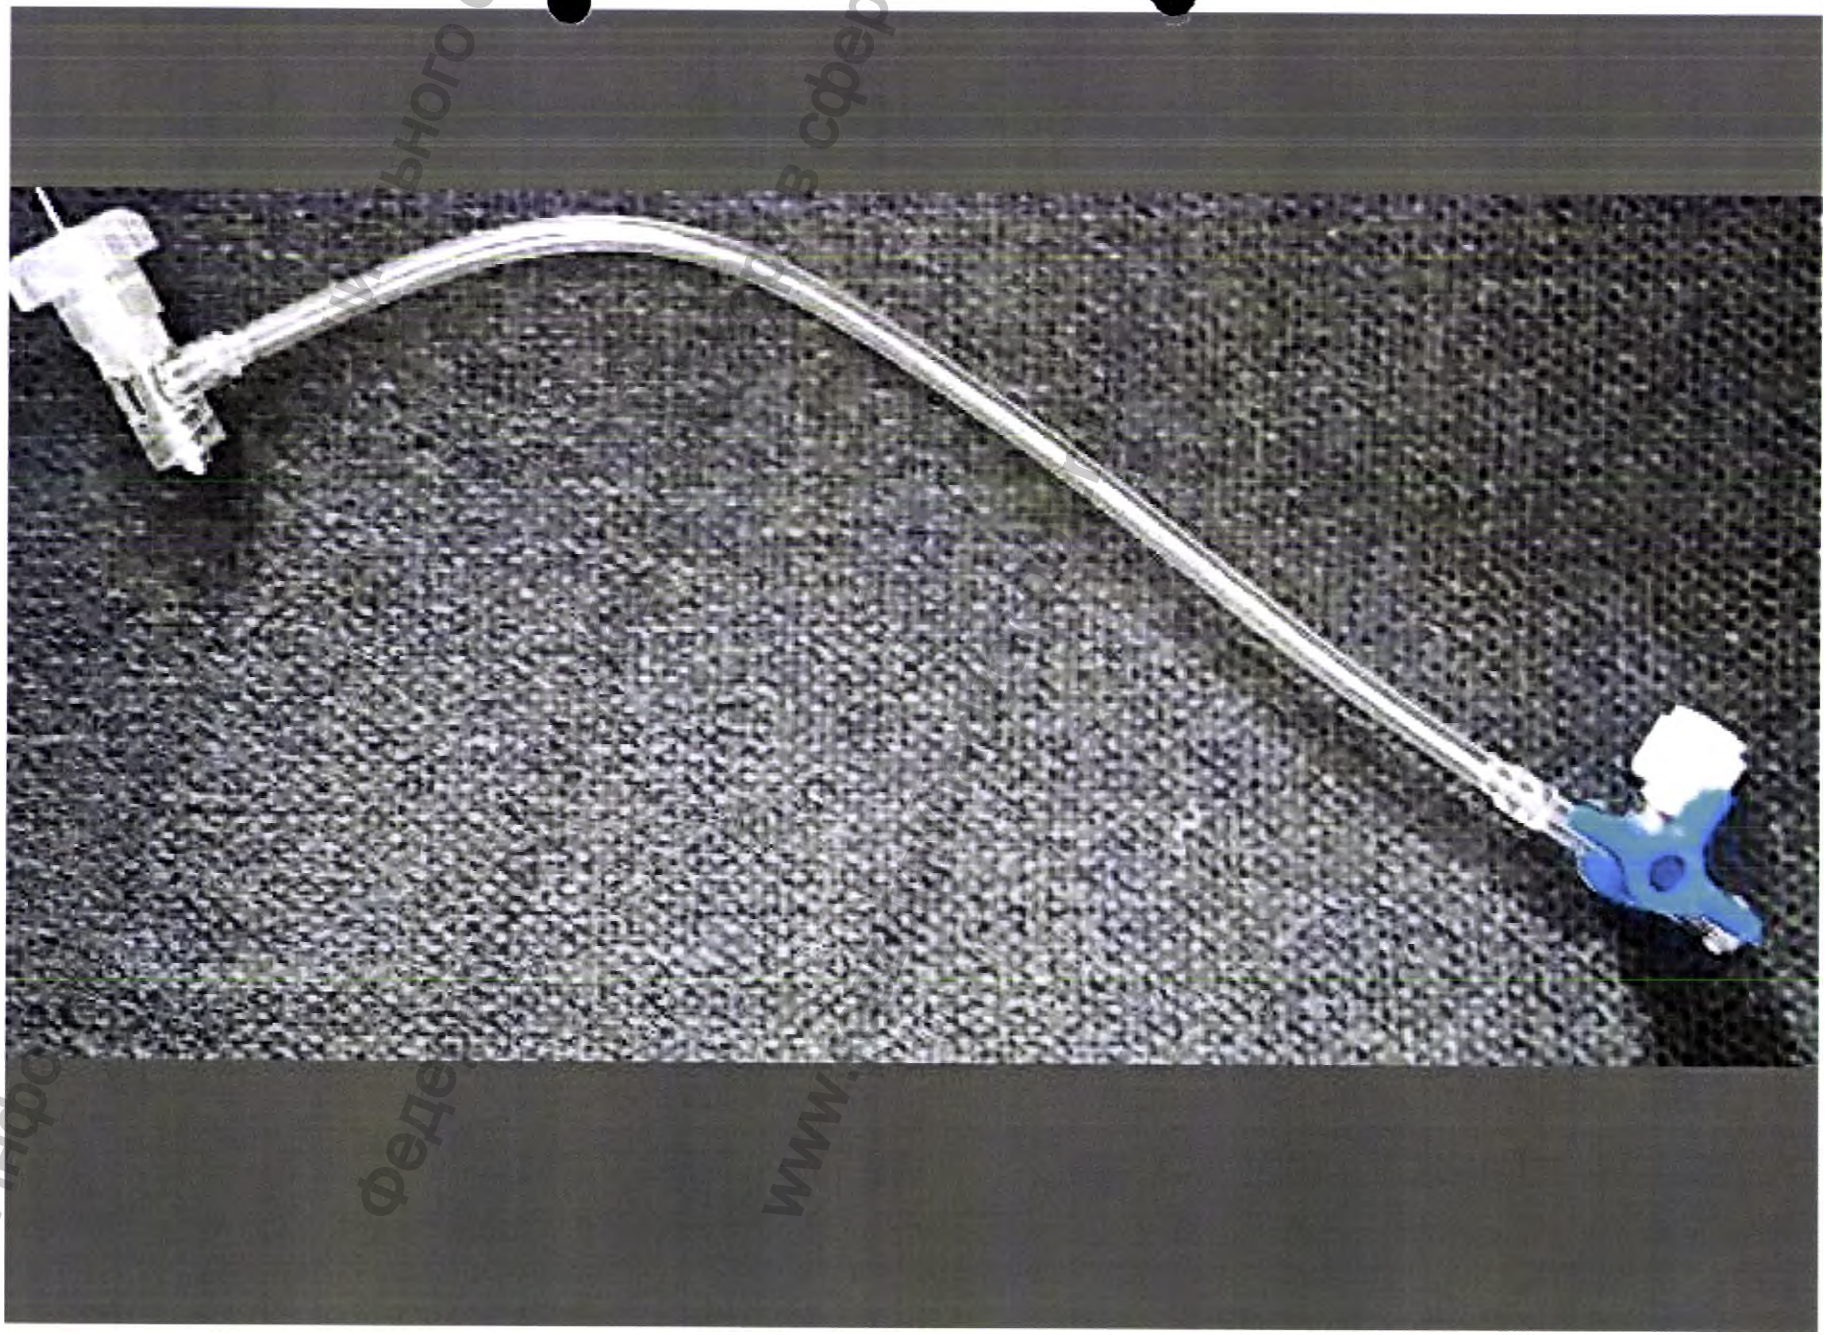

Гемостатический клапан.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

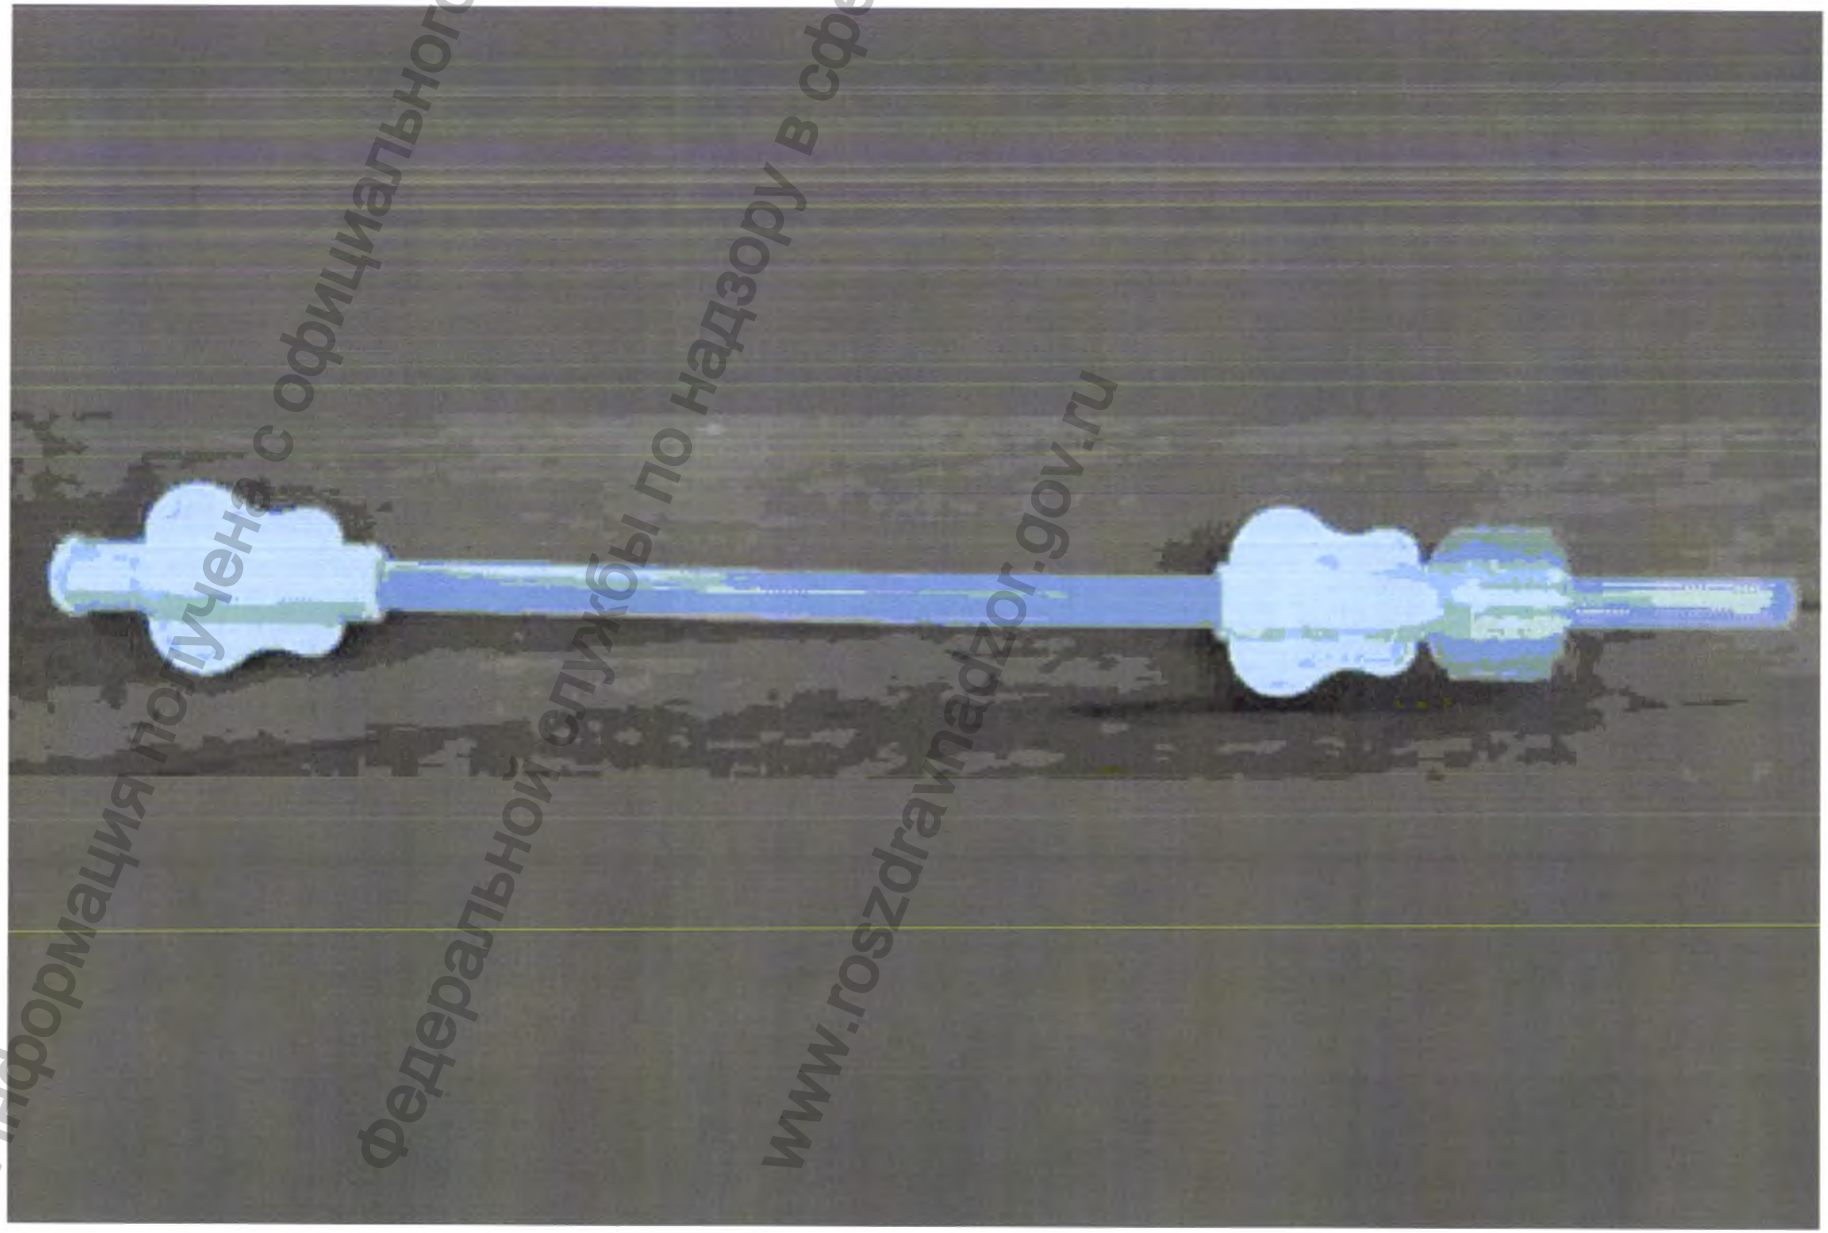

Загрузчик.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

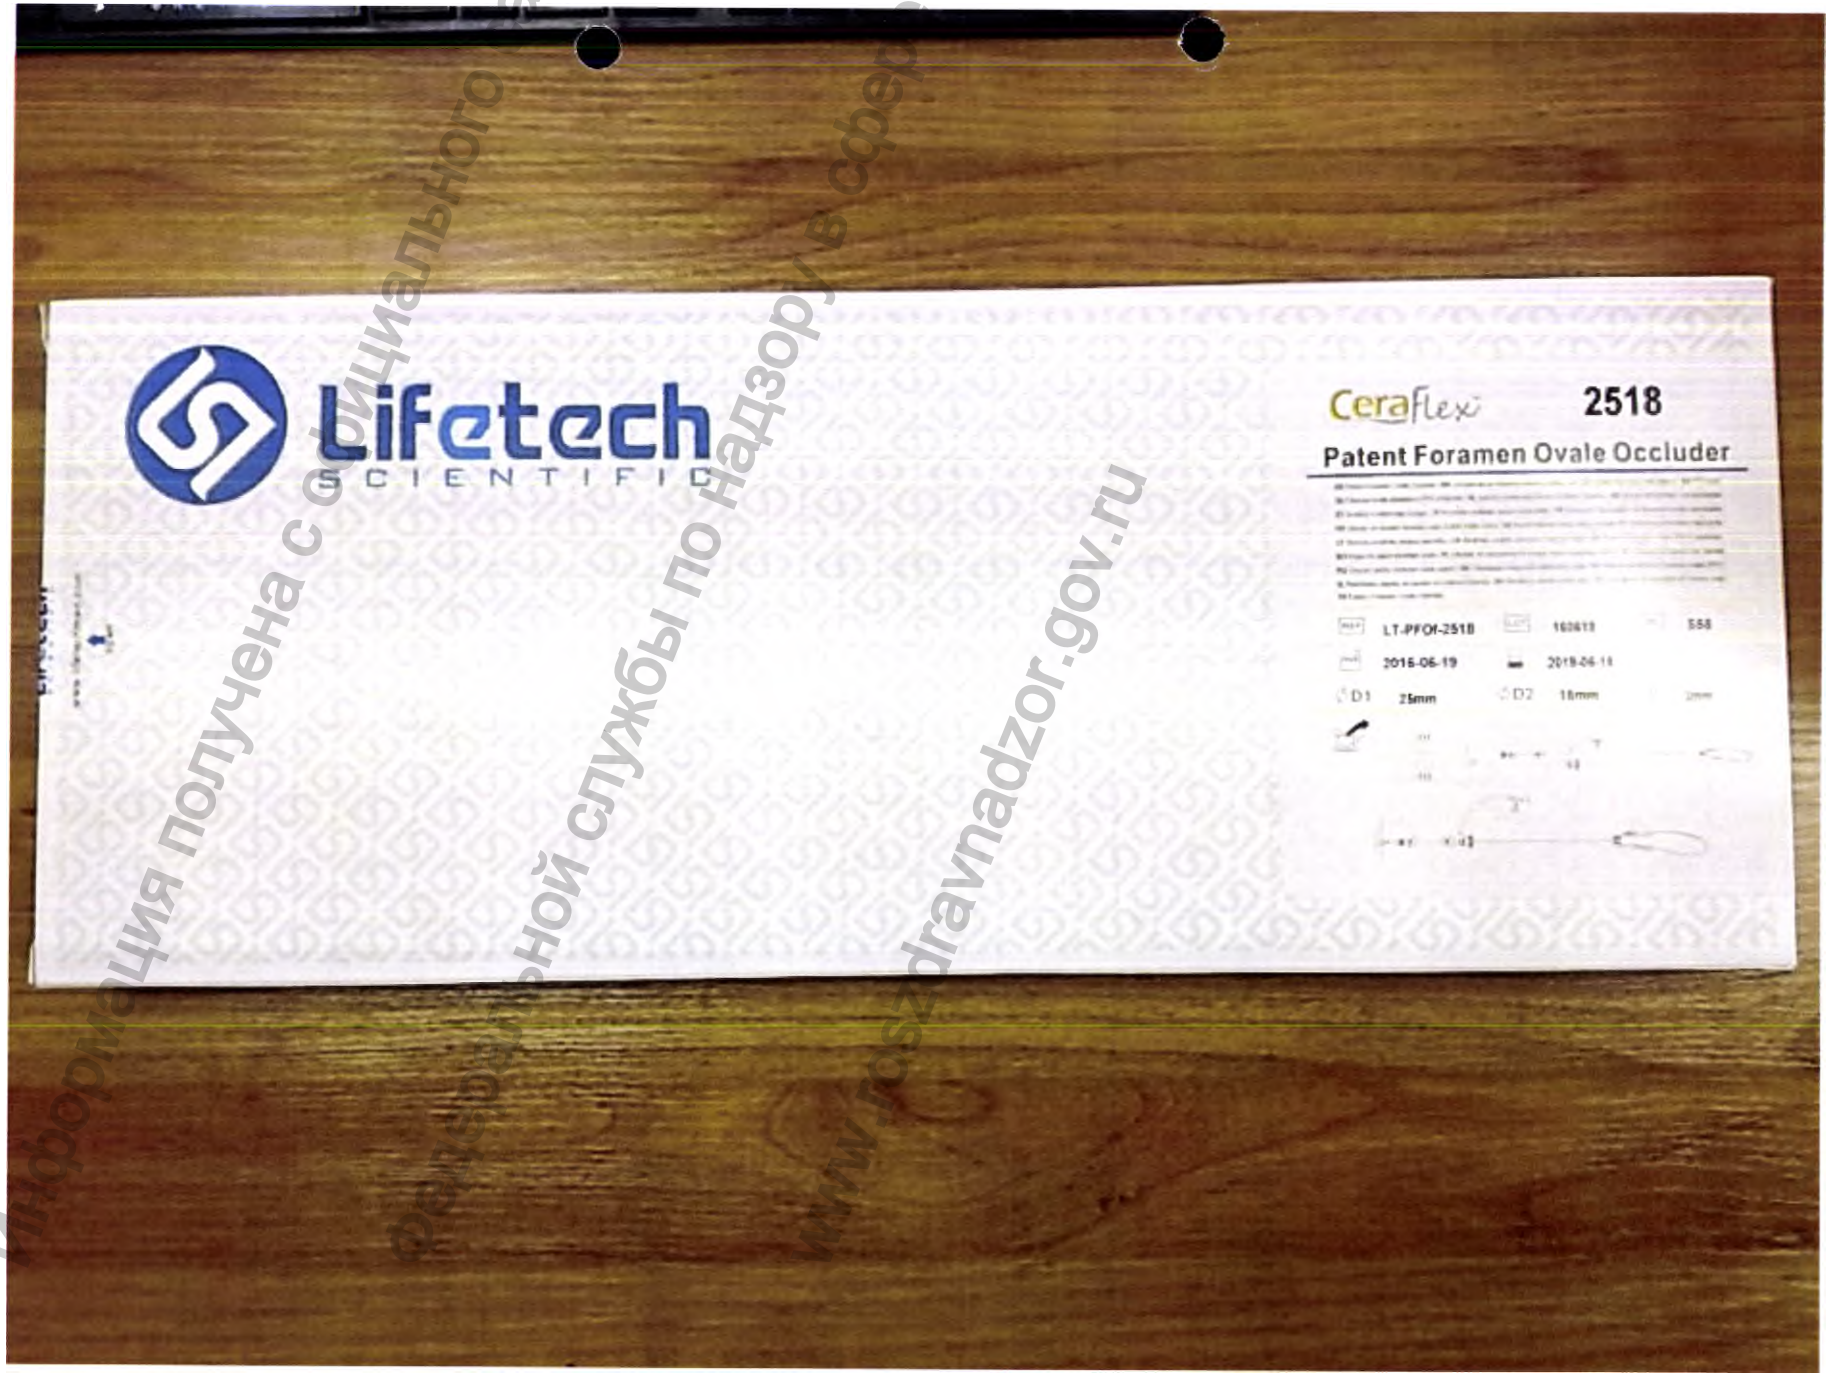

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 558), (упаковка вторичная, вид спереди).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 558), (упаковка вторичная, вид сбоку).

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

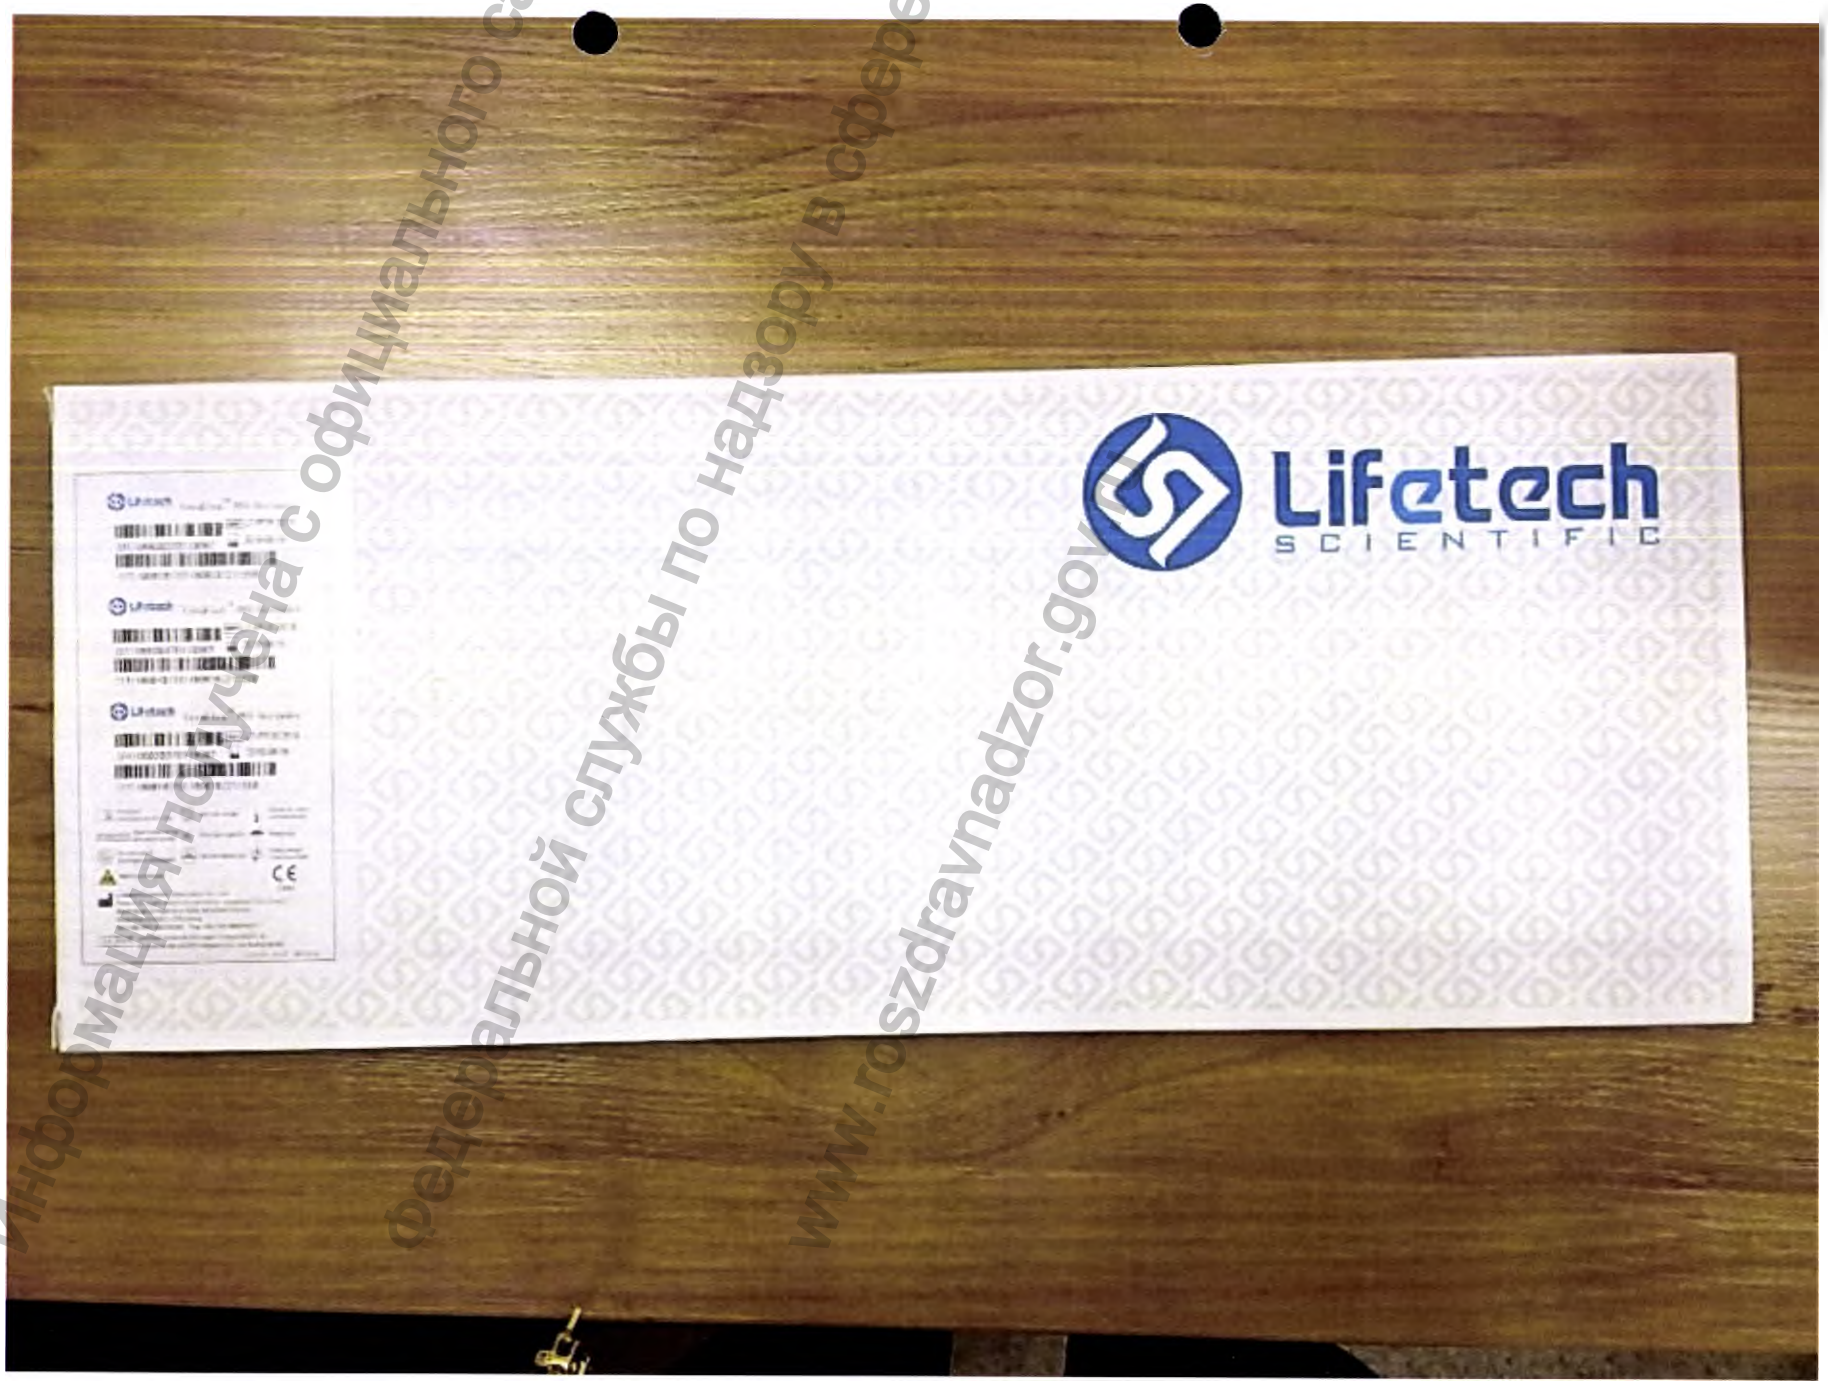

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 558), (упаковка вторичная, вид сзади).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 558), (упаковка первичная, внешний вид изделия).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 558), (руководство пользователя).

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

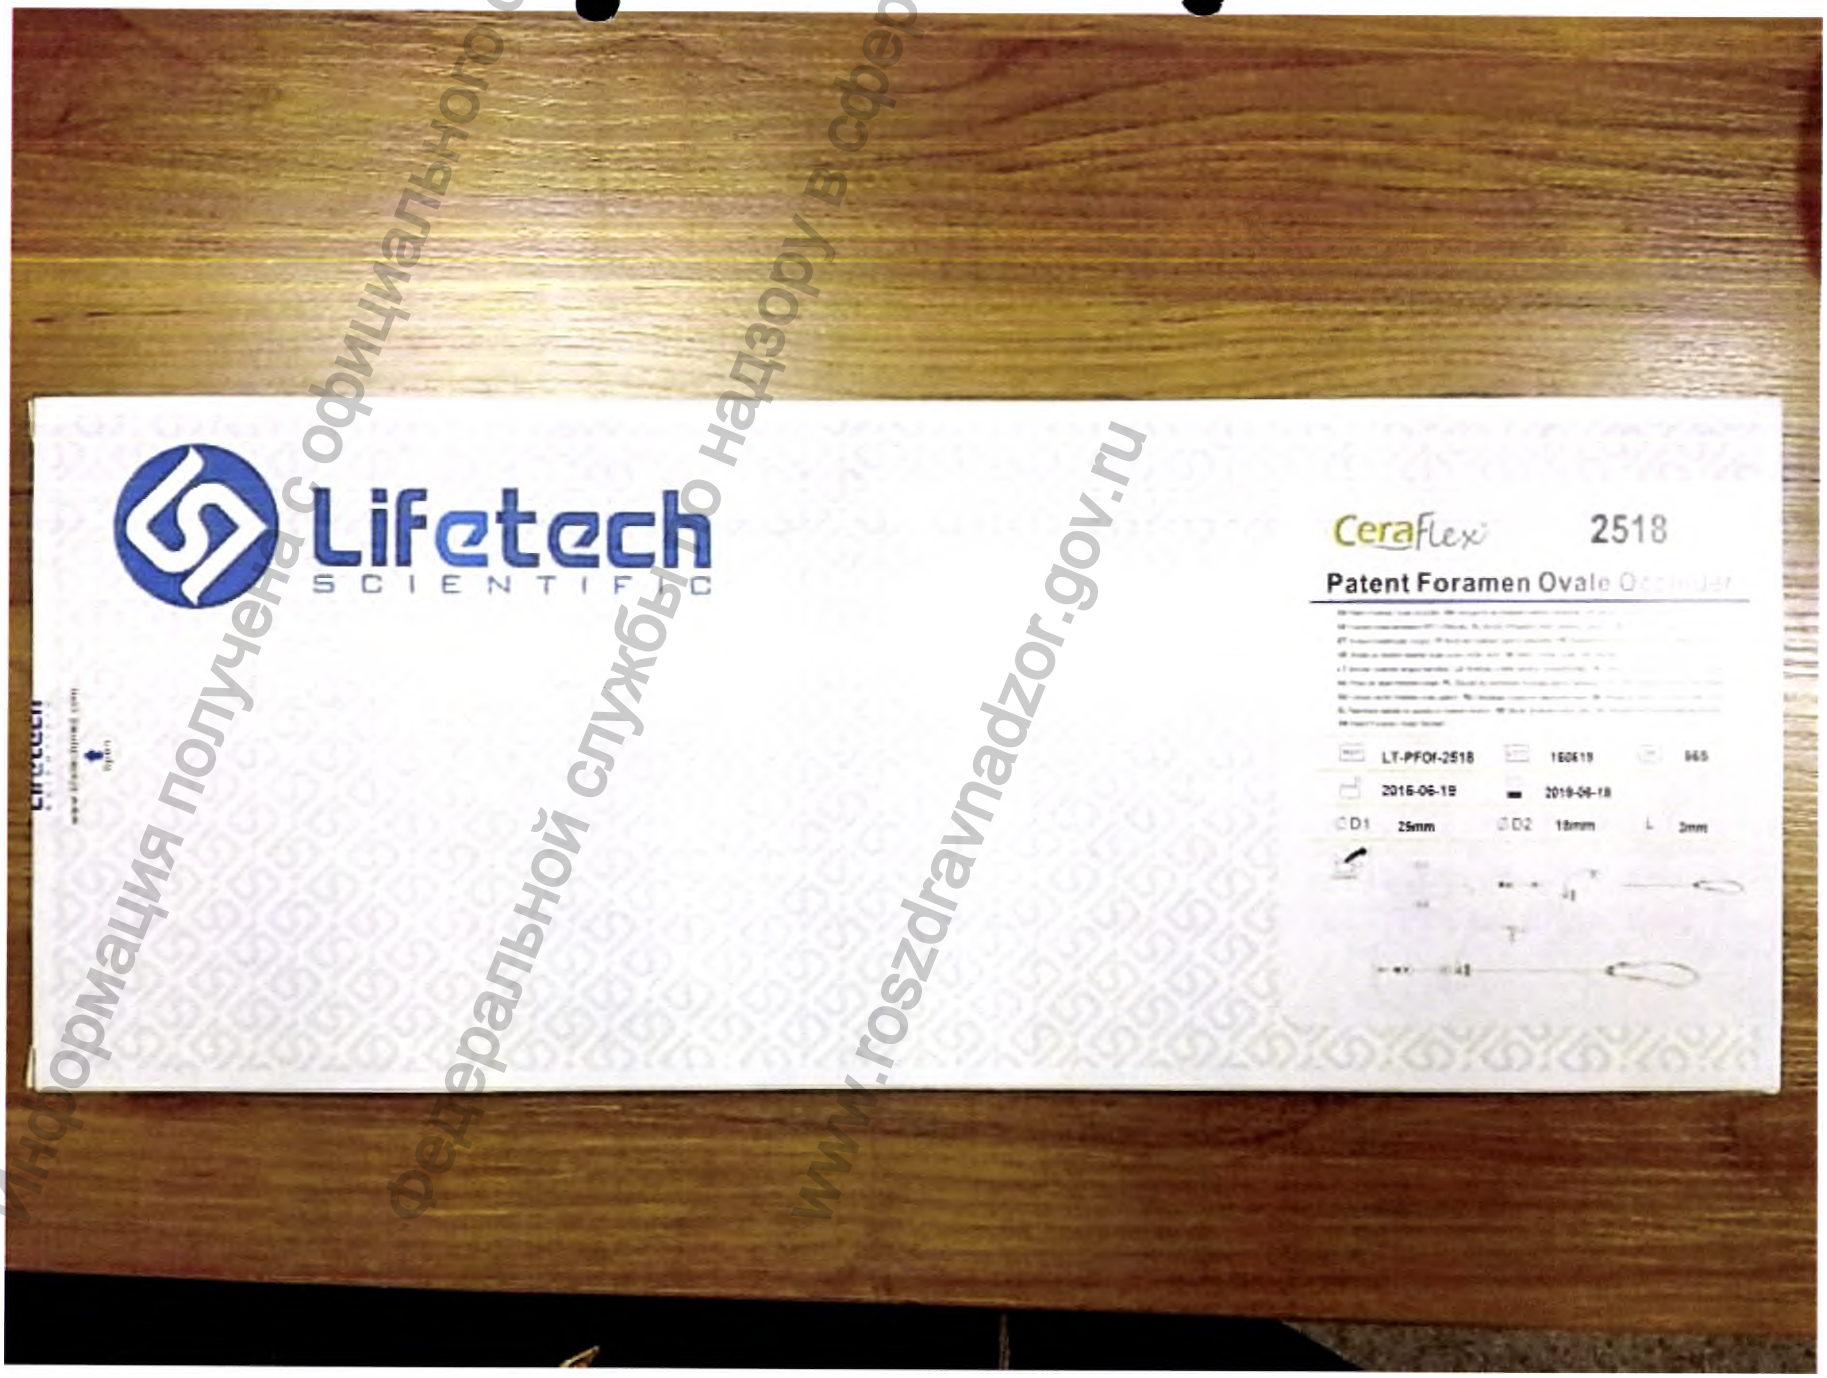

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 565), (упаковка вторичная, вид спереди).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 565), (упаковка вторичная, вид сбоку).

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 565), (упаковка вторичная, вид сзади).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 565), (упаковка первичная, внешний вид изделия).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 565), (руководство пользователя).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 501), (упаковка вторичная, вид спереди).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 501), (упаковка вторичная, вид сбоку).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 501), (упаковка вторичная, вид сзади).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 501), (упаковка первичная, внешний вид изделия).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 501), (руководство пользователя).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 497), (упаковка вторичная, вид спереди).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

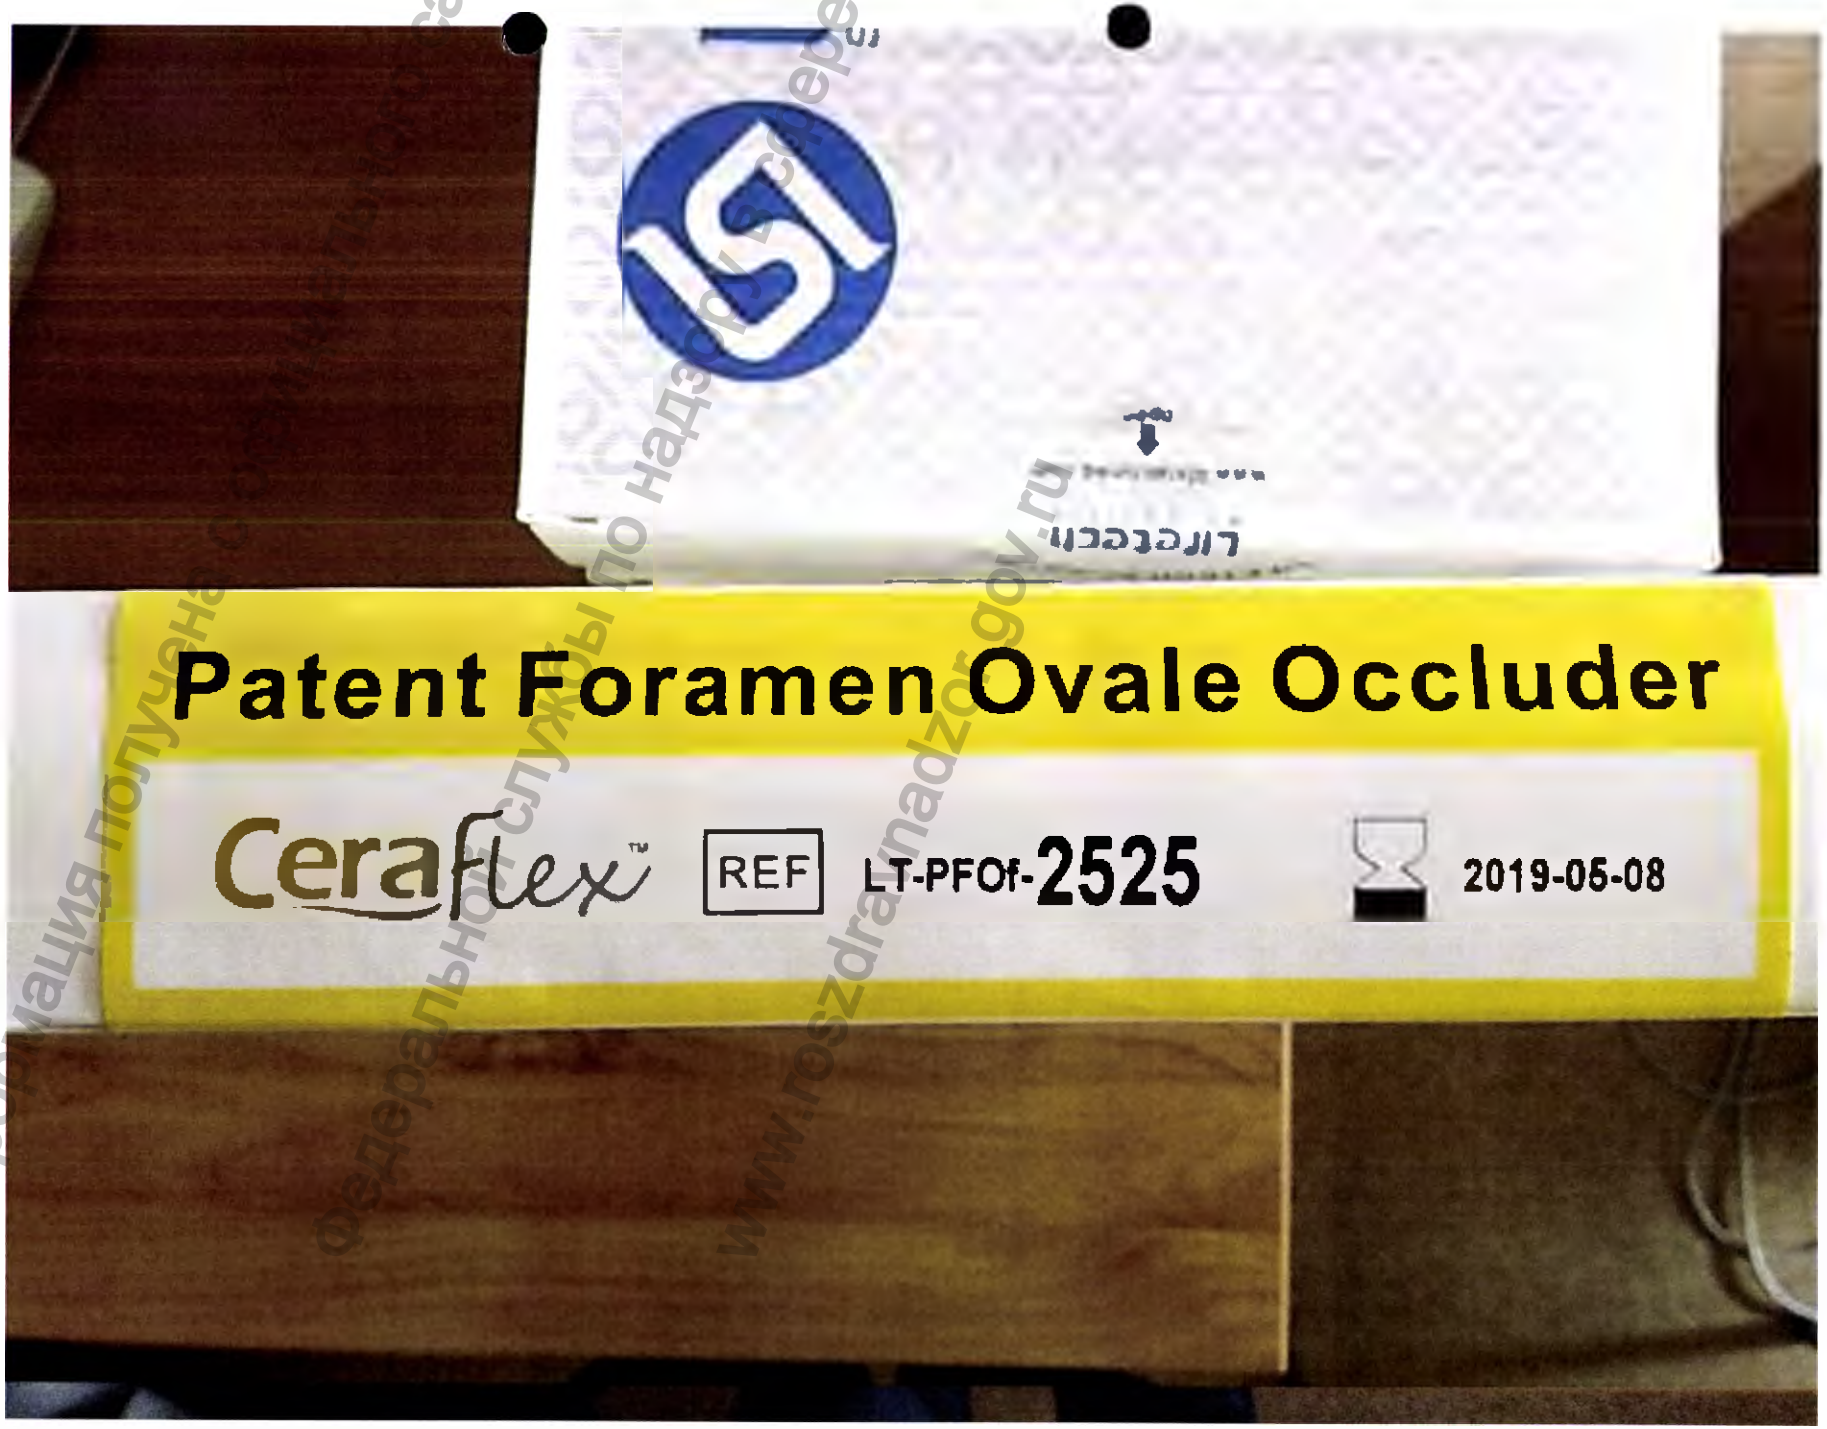

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 497), (упаковка вторичная, вид сбоку).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 497), (упаковка вторичная, вид сзади).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 497), (упаковка первичная, внешний вид изделия).

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex (LOT 497), (руководство пользователя).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Проект маркировки стерильной упаковки окклюдера

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

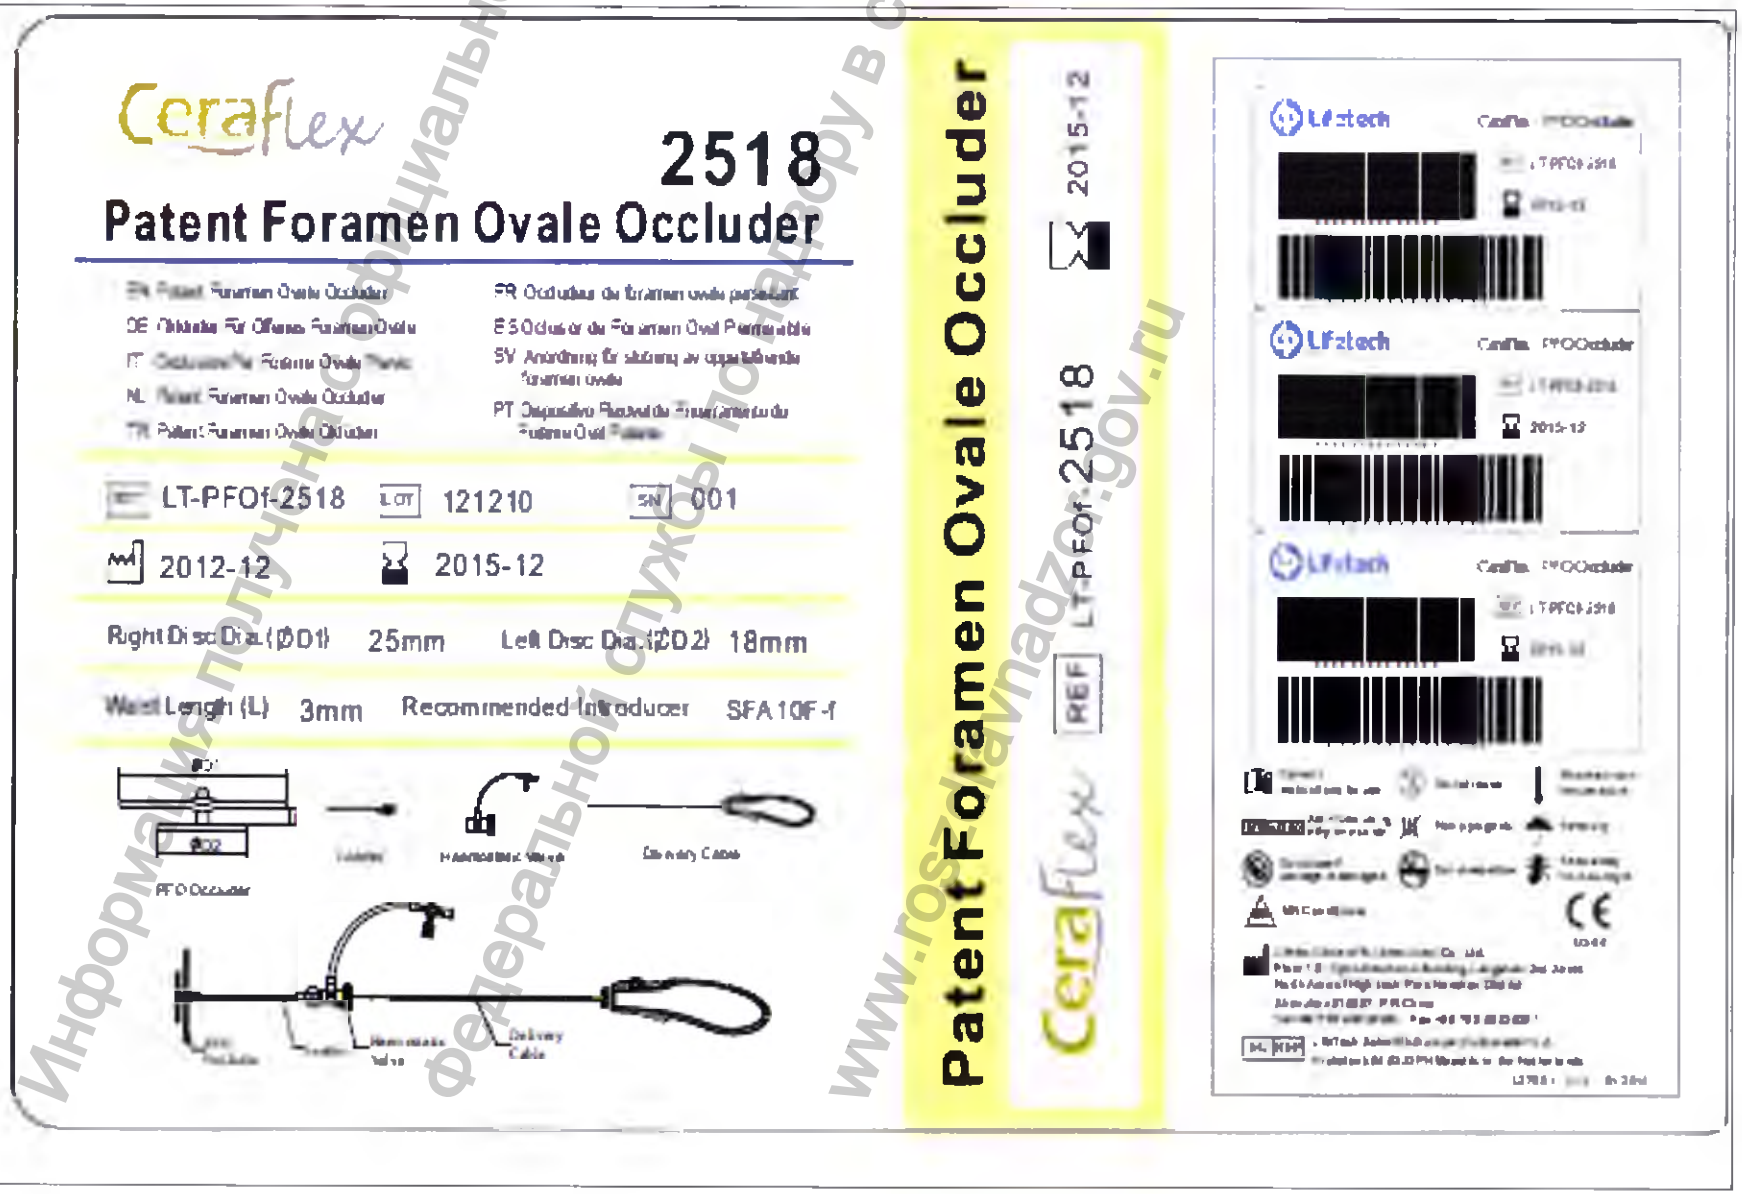

Проект маркировки пользовательской упаковки окклюдера

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Артикул: см. на упаковке **Лот номер:** см. на упаковке **Годен до:** см. на упаковке

Система для закрытия открытого овального отверстия (ООО) CeraFlex в различных вариантах исполнения

Размер: -

Номер и дата РУ:

Назначение: Система предназначена для проведения закрытия открытого овального отверстия нехирургическим путем.

Дата изготовления: см. на упаковке

«Лайфтек Сайнтифик (Шэньчжэнь)», Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., Floor 1-5, Cybio Electronic Building, Langshan 2nd Street, North Area of High-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, 518057, P.R. China

Представитель производителя в РФ: ООО «ЦСРМИ», Россия, 123308, Москва, ул. Мневники, д. 3, корп. 1

Место производства:

«Лайфтек Сайнтифик (Шэньчжэнь)», Lifetech Scientific (Shenzhen) Co., Ltd., Floor 1-5, Cybio Electronic Building, Langshan 2nd Street, North Area of High-tech Park, Nanshan District, Shenzhen, 518057, P.R. China

АПИРОГЕННО

НЕТОКСИЧНО

Проскт стикера на русском языке.

Информация получена официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 30 листа (ов)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru