

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

УСТРОЙСТВО МАССАЖНОЕ
«БЬЮТИЛАЙЗЕР ТЕРАПИ» (BEAUTYLIZER THERAPY)
ПО ТУ 32.50.21-005-51045777-2018


Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению), с указанием товарного знака и иных средств индивидуализации медицинского изделия в случае их нанесения на упаковку медицинского изделия


Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-2018, варианты исполнения:

- I. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Пульс» (Beautylizer Therapy Pulse), в составе:
- 1. Блок основной 1 шт.
- 2. Вакуумно-роликовая манипула для тела 1 шт.
- 3. Вакуумно-роликовая манипула для лица 1 шт.
- 4. Гибкий соединительный шланг 1 шт.
- 5. Кабель питания (сетевой шнур) 1 шт.
- 6. Костюм эндермологический, единый размер (one size) 10 шт.
- 7. Паспорт на медицинское изделие 1 шт.
- 8. Потребительская тара (упаковка) 1 шт.
- II. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Сфирс» (Beautylizer Therapy Spheres), в составе:
- 1. Блок основной 1 шт.
- 2. Манипула для виброкомпрессии, в составе:
- 2.1. Блок манипулы 1 шт.
- 2.2. Роллер с твердостью сфер 70 не более 2 шт.
- 2.3. Роллер с твердостью сфер 80 (при необходимости) 1 шт.
- 3. Кабель питания (сетевой шнур) 1 шт.
- 4. Паспорт на медицинское изделие 1 шт.
- 5. Потребительская тара (упаковка) 1 шт.
- III. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Сфирс» (Beautylizer Therapy Spheres), в составе:
- 1. Блок основной 1 шт.
- 2. Манипула для виброкомпрессии, в составе:
- 2.1. Блок манипулы 1 шт.
- 2.2. Роллер с твердостью сфер 80 не более 2 шт.
- 2.3. Роллер с твердостью сфер 70 (при необходимости) 1 шт.
- 3. Кабель питания (сетевой шнур) 1 шт.
- 4. Паспорт на медицинское изделие 1 шт.
- 5. Потребительская тара (упаковка) 1 шт.
- IV. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Космосфирс» (Beautylizer Therapy Cosmospheres), в составе:
- 1. Блок основной 1 шт.
- 2. Манипула для виброкомпрессии, в составе:
- 2.1. Блок манипулы 1 шт.
- 2.2. Роллер с твердостью сфер 70 не более 2 шт.
- 2.3. Роллер с твердостью сфер 80 (при необходимости) 1 шт
- 3. Кабель питания (сетевой шнур) 1 шт.
- 4. Паспорт на медицинское изделие 1 шт.
- 5. Потребительская тара (упаковка) 1 шт.
- V. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Космосфирс» (Beautylizer Therapy Cosmospheres), в составе:
- 1. Блок основной 1 шт.
- 2. Манипула для виброкомпрессии, в составе:
- 2.1. Блок манипулы 1 шт.
- 2.2. Роллер с твердостью сфер 80 не более 2 шт.
- 2.3. Роллер с твердостью сфер 70 (при необходимости) 1 шт.
- 3. Кабель питания (сетевой шнур) 1 шт.
- 4. Паспорт на медицинское изделие 1 шт.
- 5. Потребительская тара (упаковка) 1 шт.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

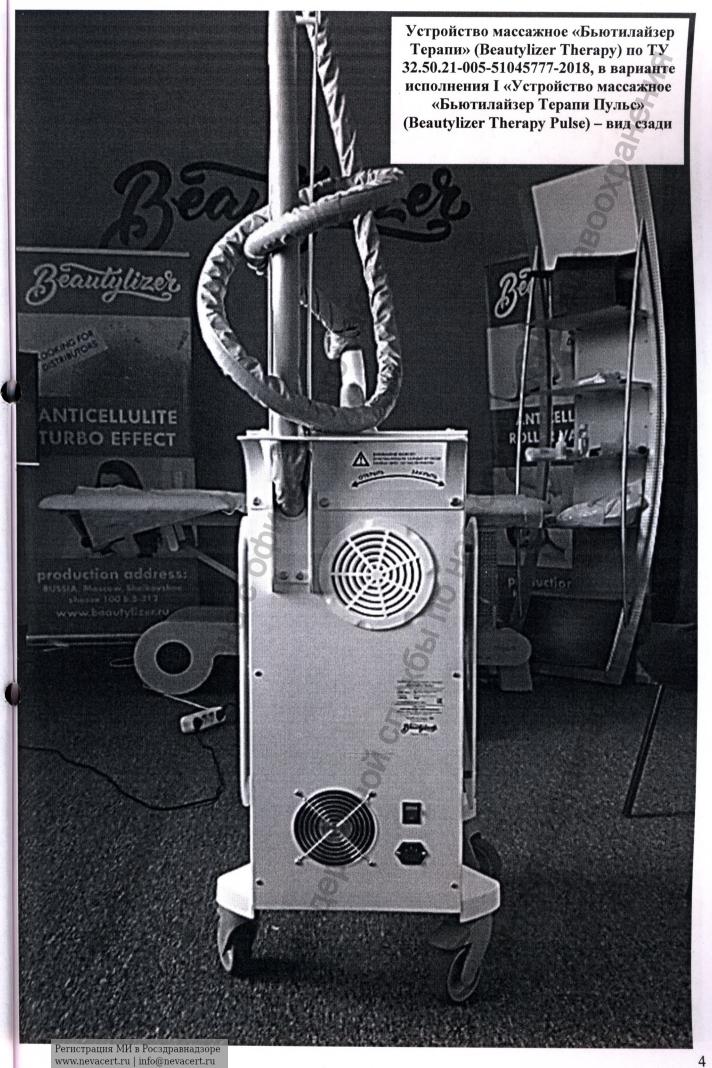

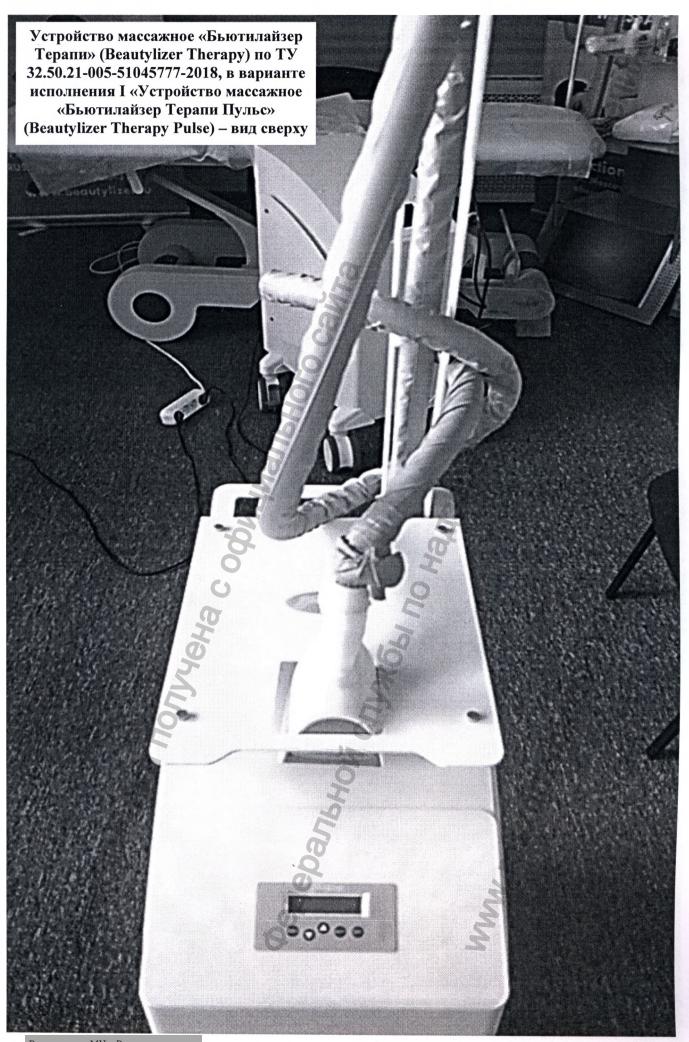

Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru





Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-2018, в варианте исполнения I «Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Пульс» (Beautylizer Therapy Pulse) – Гибкий соединительный шланг






Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-2018, в варианте исполнения I «Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Пульс» (Beautylizer Тherapy Pulse) – Костюм эндермологический, единый размер (one size) www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-2018, в варианте исполнения II «Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Сфирс» (Beautylizer Therapy Spheres) – вид сбоку





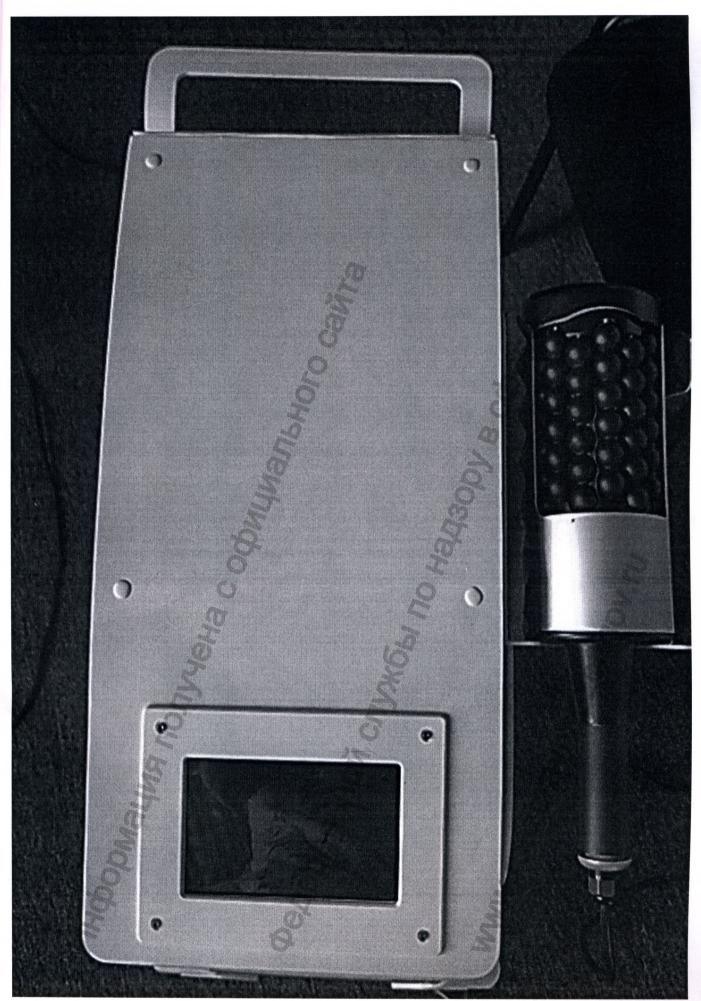

Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-2018, в варианте исполнения П «Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Сфирс» (Beautylizer Регистрация МИ в Росздраввалорея) — вид сверху с манипулой для виброкомпрессии и роллером


www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-2018, в варианте исполнения II «Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Сфирс» (Beautylizer Therapy Spheres)





Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-2018, в варианте исполнения IV. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Космосфирс» Регистрация МИ в Росздравнадзоре у Cosmospheres) — вид сверху, блок основной с манипулой для виброкомпрессии и роллером

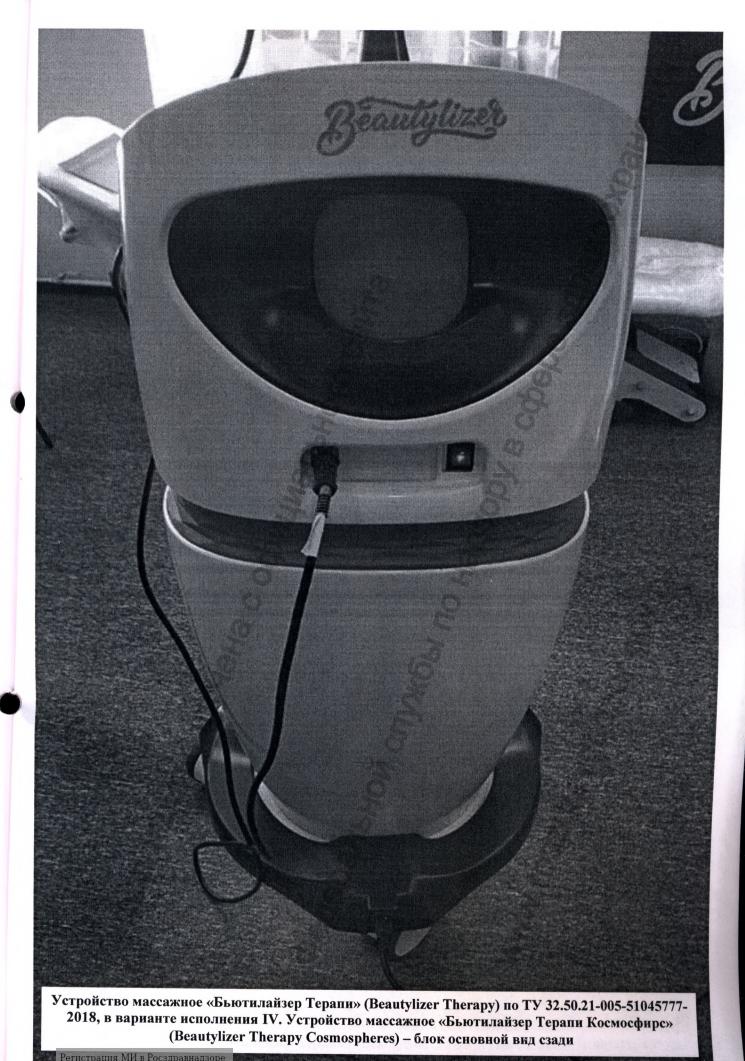



Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи» (Beautylizer Therapy) по ТУ 32.50.21-005-51045777-Регистрация МИ в Росздравила феwww.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

І. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Пульс» (Beautylizer Therapy Pulse)

Режим работы - повторно-кратковременный (работа 60-90 мин, перерыв 10-15 мин)

ПИТАНИЕ

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ

~220В 50Гп

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

МОШНОСТЬ

1500 BT

07.2018

током і

Дата выпуска:

ТУ 32.50.21-005-51045777-2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Экономические

Электрорешения» 105523 г. Москва,

Щелковское шоссе, д. 100, корп. 5, оф. 311

Заводской номер:

1807002

II. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Сфирс» (Beautylizer Therapy Spheres)

Режим работы – повторно-кратковременный (работа 60-90 мин, перерыв 10-15 мин)

ПИТАНИЕ ~220В 50Гп

300 BT

КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

мошность

ТОКОМ І

Дата выпуска: 01.2019

ТУ 32.50.21-005-51045777-2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «Экономические

Электрорешения» 105523 г. Москва,

Щелковское шоссе, д. 100, корп. 5, оф. 311

Заводской номер:

1804306

Пример маркировки на этикетке, прикрепляемой к изделию

І. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Пульс» (Beautylizer Therapy Pulse)



ООО «Экономические Электрорешения» 105523 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 5, оф. 311



07.2018

SN

1807002

ТУ 32.50. 21-005-51045777-2018

II. Устройство массажное «Бьютилайзер Терапи Сфирс» (Beautylizer Therapy Spheres)



ООО «Экономические Электрорешения» 105523 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 5, оф. 311



01.2019

SN

1804306

ТУ 32.50.21-005-51045777-2018

Пример маркировки на этикетке, прикрепляемой к упаковке

