

УТВЕРЖДАЮ»

Директор по регистрации, Россия и СНГ

ООО «Дентсплай Сирона»

Хаиндрава В.Г.

» 2021 г.



**Фотографическое изображение маркировки и русскоязычной
этикетки на МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


**Инструменты для системы дентальных имплантатов ASTRA TECH
Implant System, варианты исполнения: EV, Profile EV, TX,
многоразовые**

Информация получена с официального сайта



Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdrazhnadzor.gov.ru


Имплантовод EV 3.0 длинный (Implant Driver EV 3.0 Long)

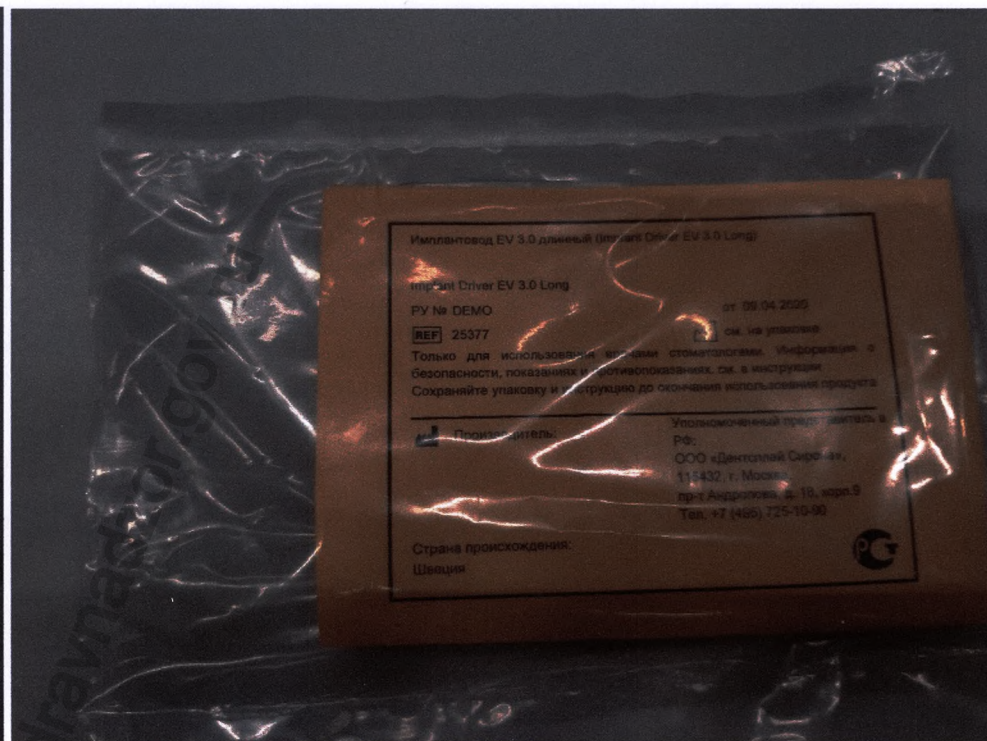

Ключ для установки абатмента Уни EV (Uni Driver EV)

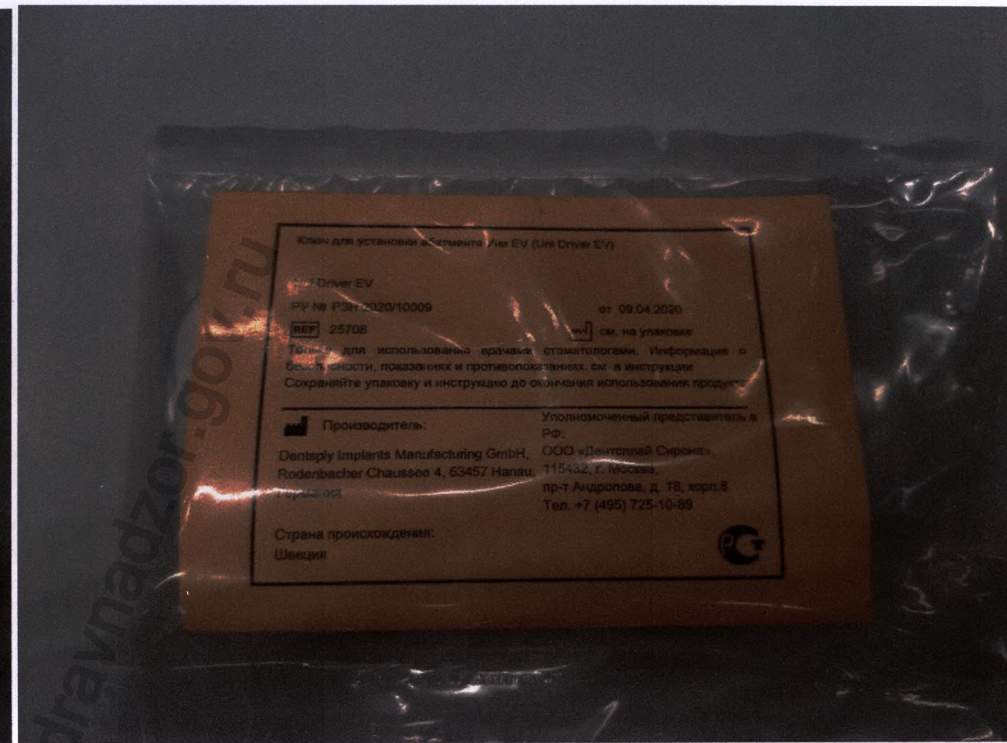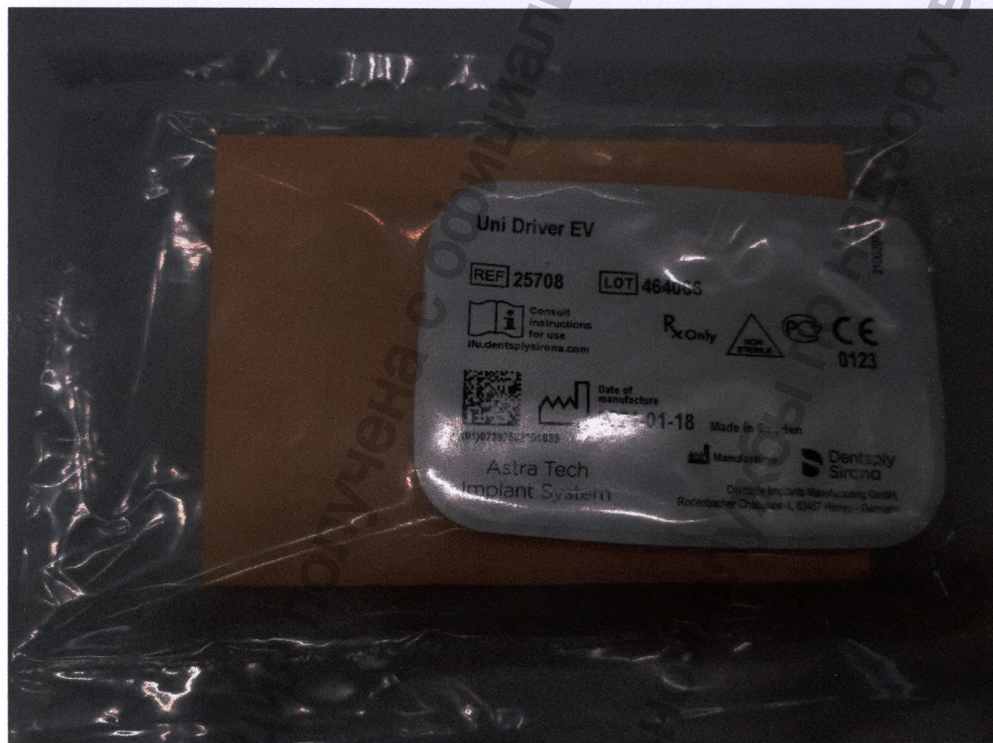


Отвертка шестигранная механическая EV короткая, 20 мм (Hex Driver EV Machine Short, 20 mm)

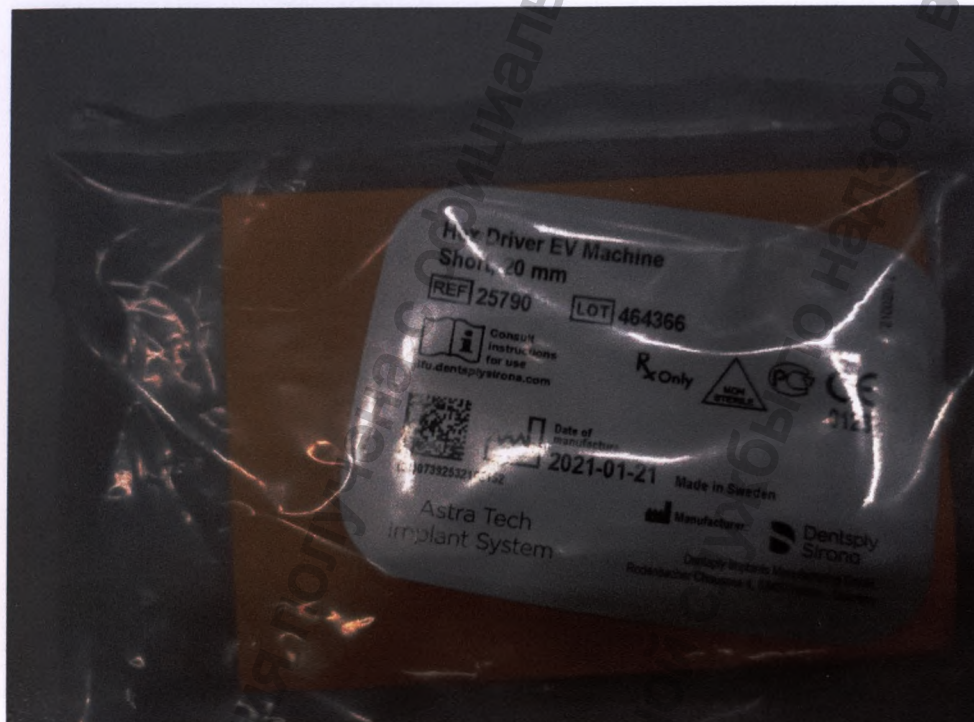

Ример костный EV Ø 7.0 (Bone Reamer EV Ø 7.0)



Индикатор направления EV (Direction Indicator EV)

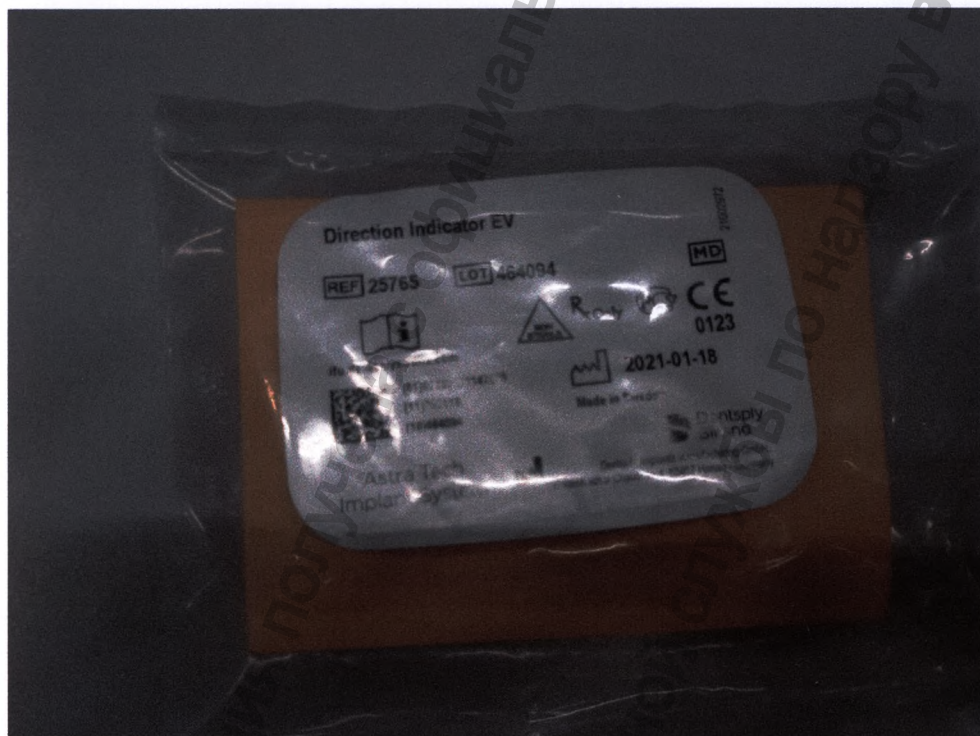



Сшито и скреплено печатью « 4 » лист

Директор по регистрации Россия и СНГ
ООО «Дентсплай Сирона»
Хаиндрава В.Г.

Дата: 15.04.2021 г.



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.goszdravnadzor.gov.ru