

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

Технические условия

ТУ 33.10.14-003-84354588-2017

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (белый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и _____
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.

Тел : (495) 645-04-74.

Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017

Объем – 4,5 л.

Номинальная нагрузка – 8,0 кг.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
375х205х130

Номер партии: МП-03-4,5-1117

Дата изготовления : 24.11.2017


РУ № _____

СС № _____


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Изделие в сборе)




МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение основного контейнера)

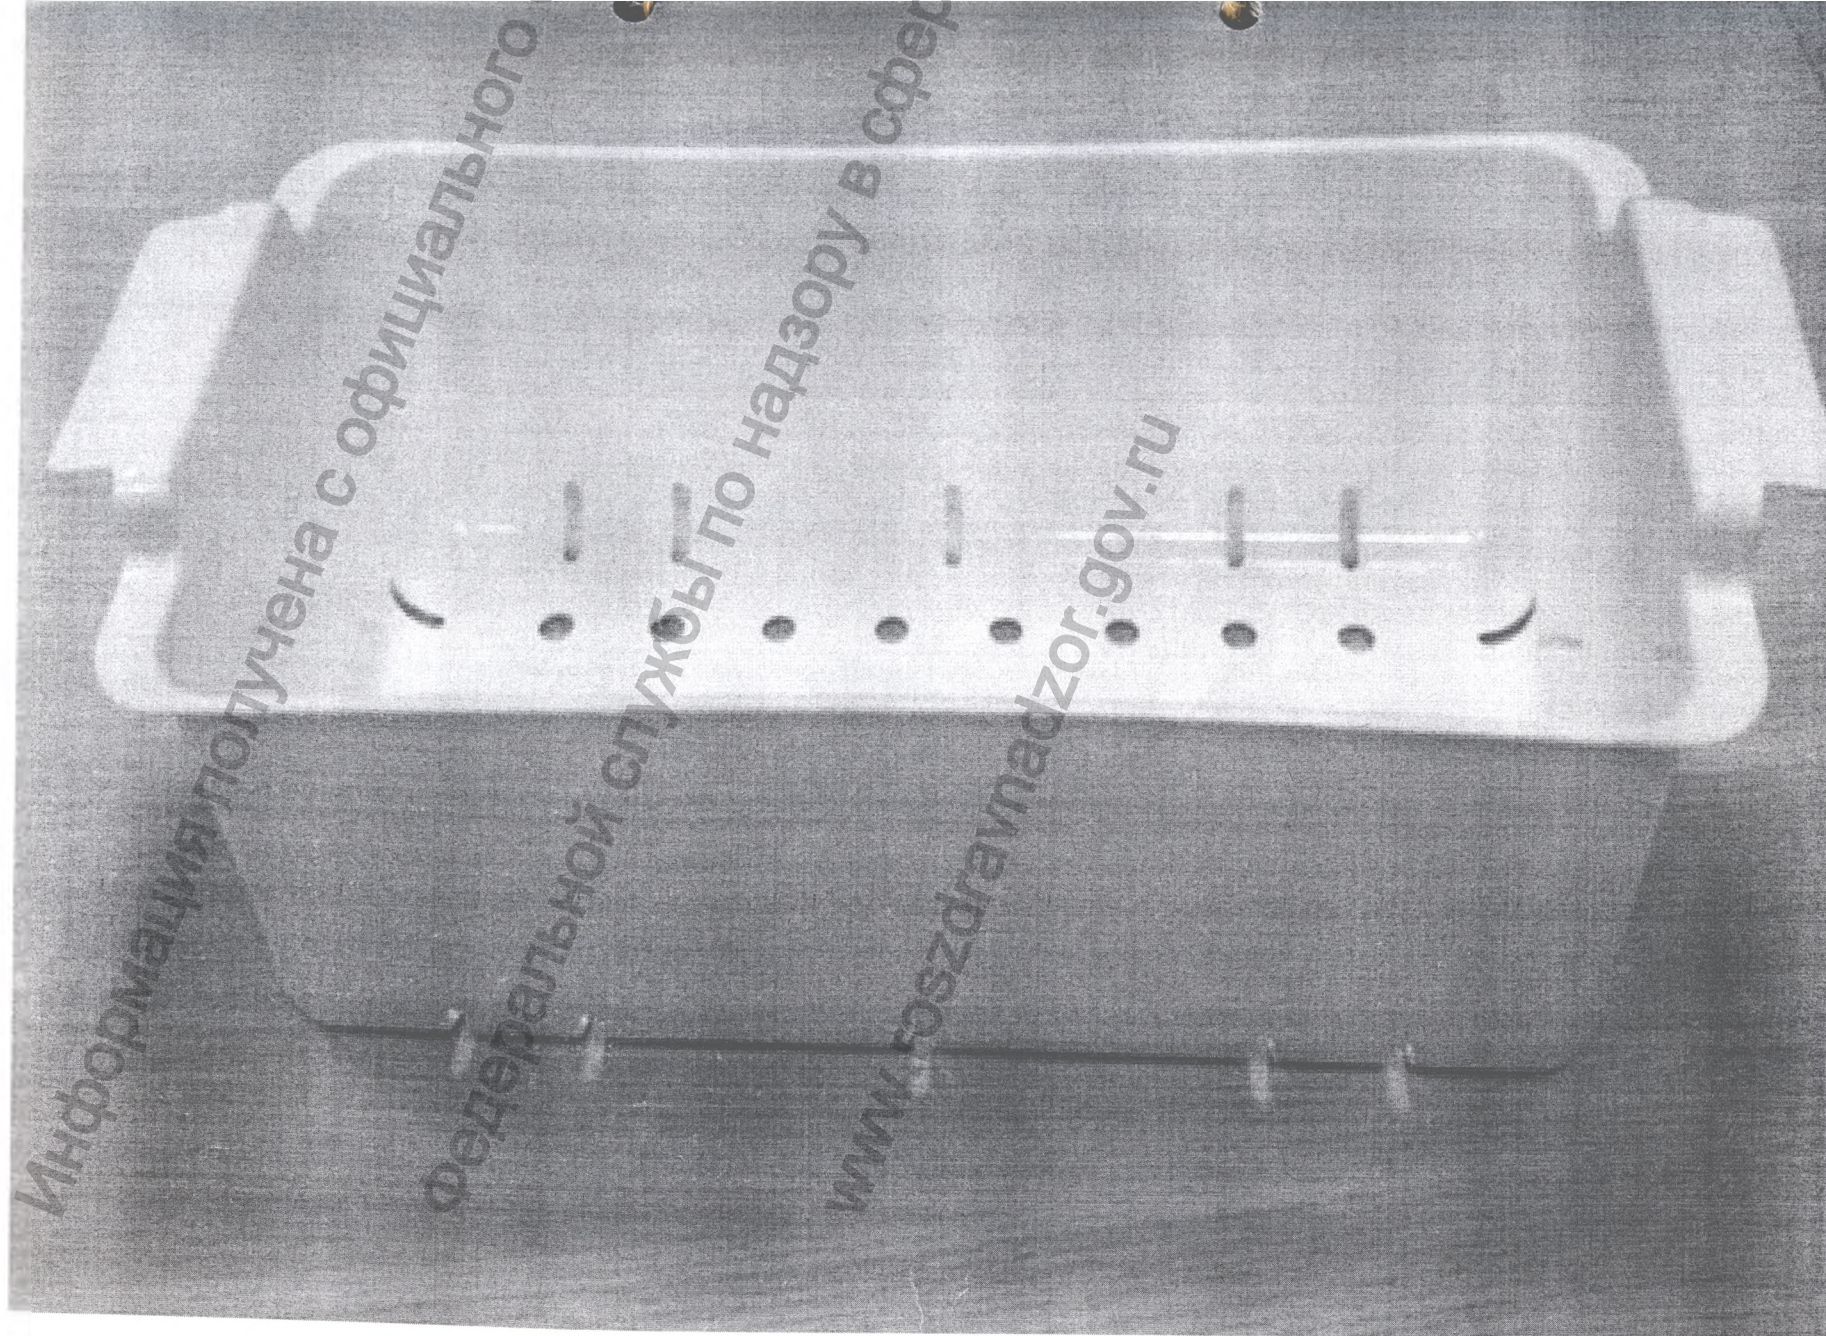


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение перфорированного контейнера- вкладки)

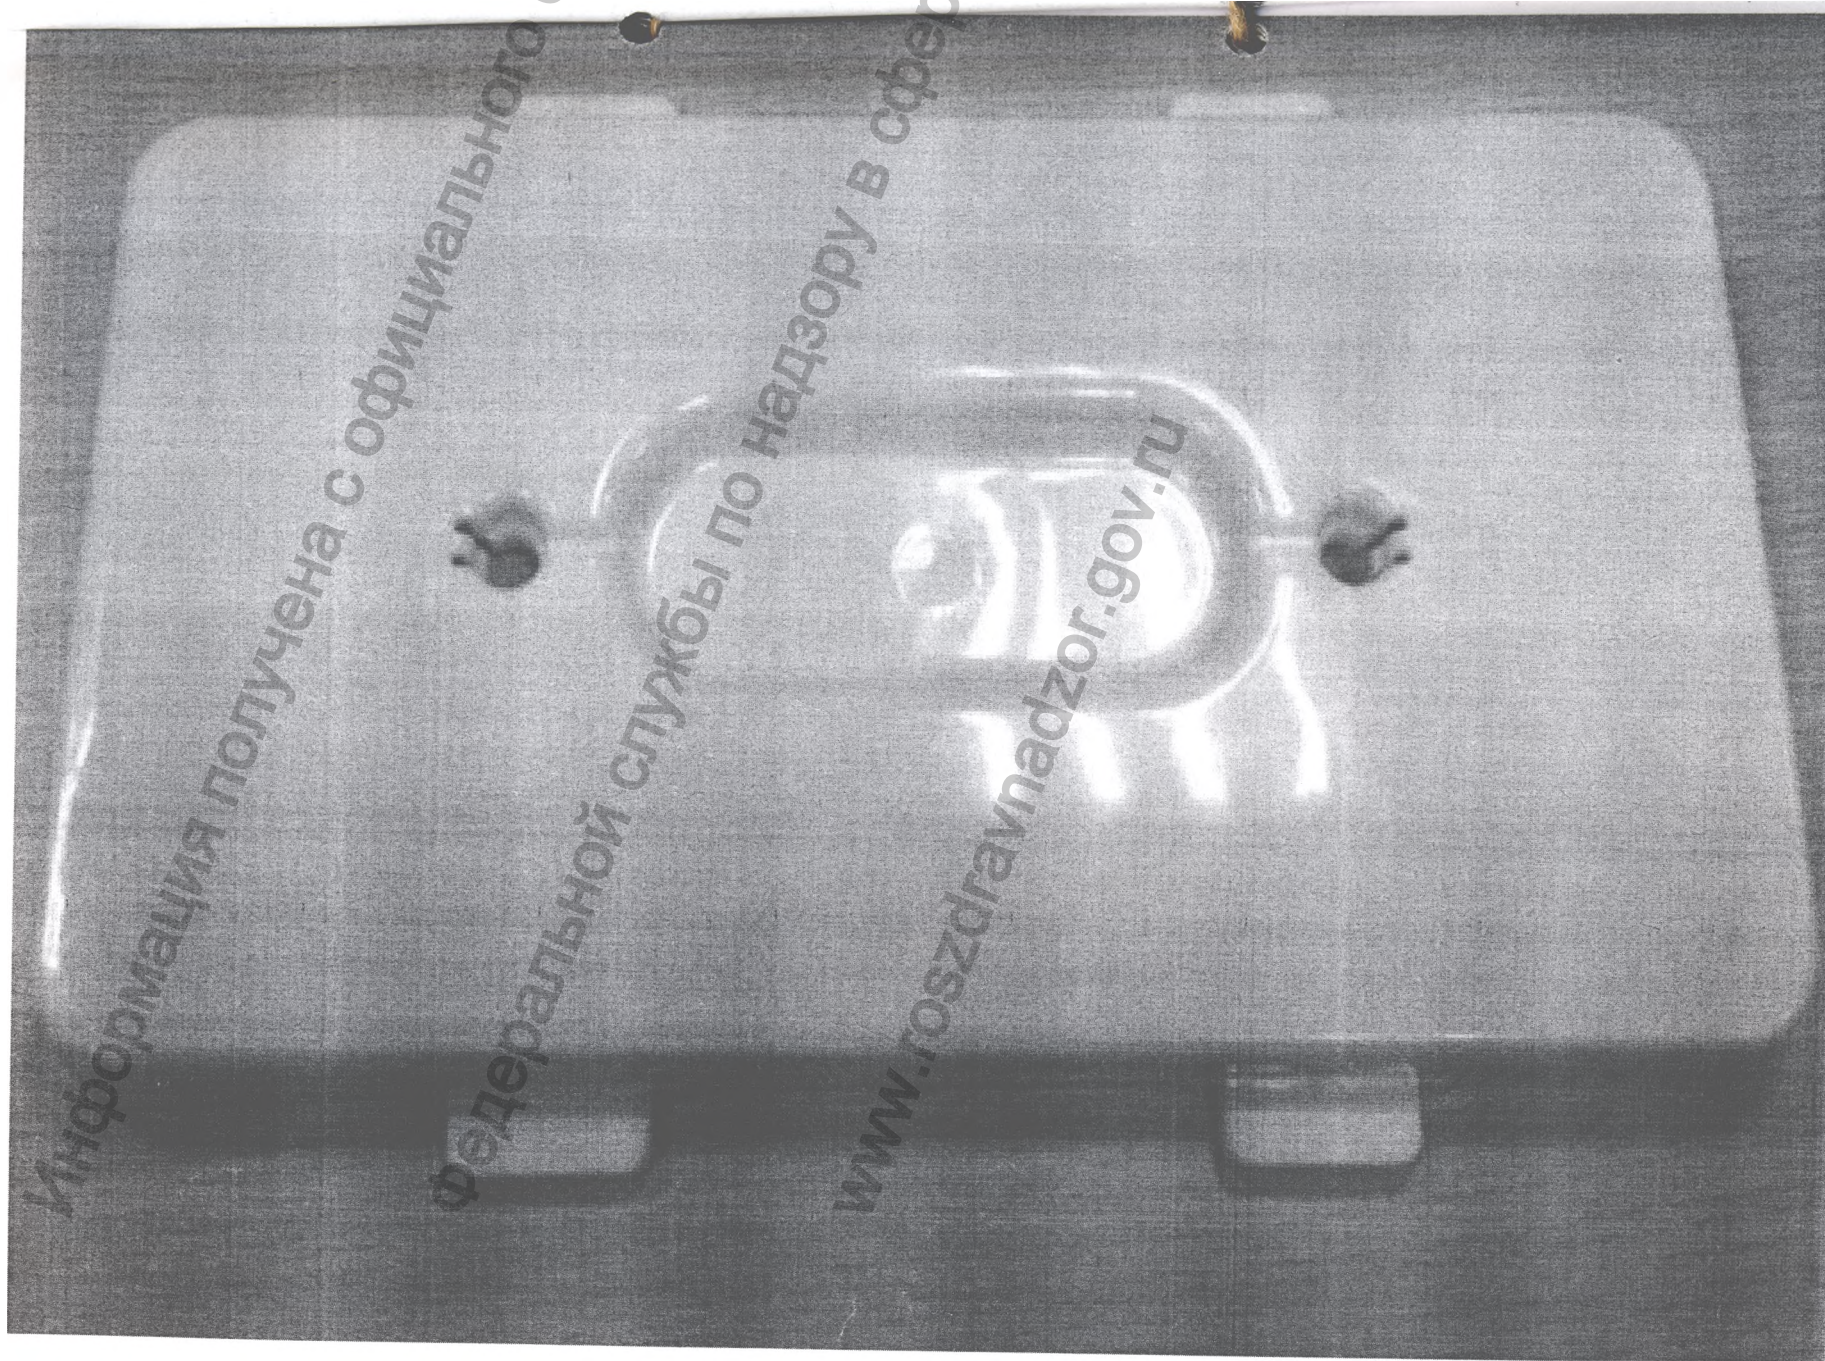


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение крышки контейнера)

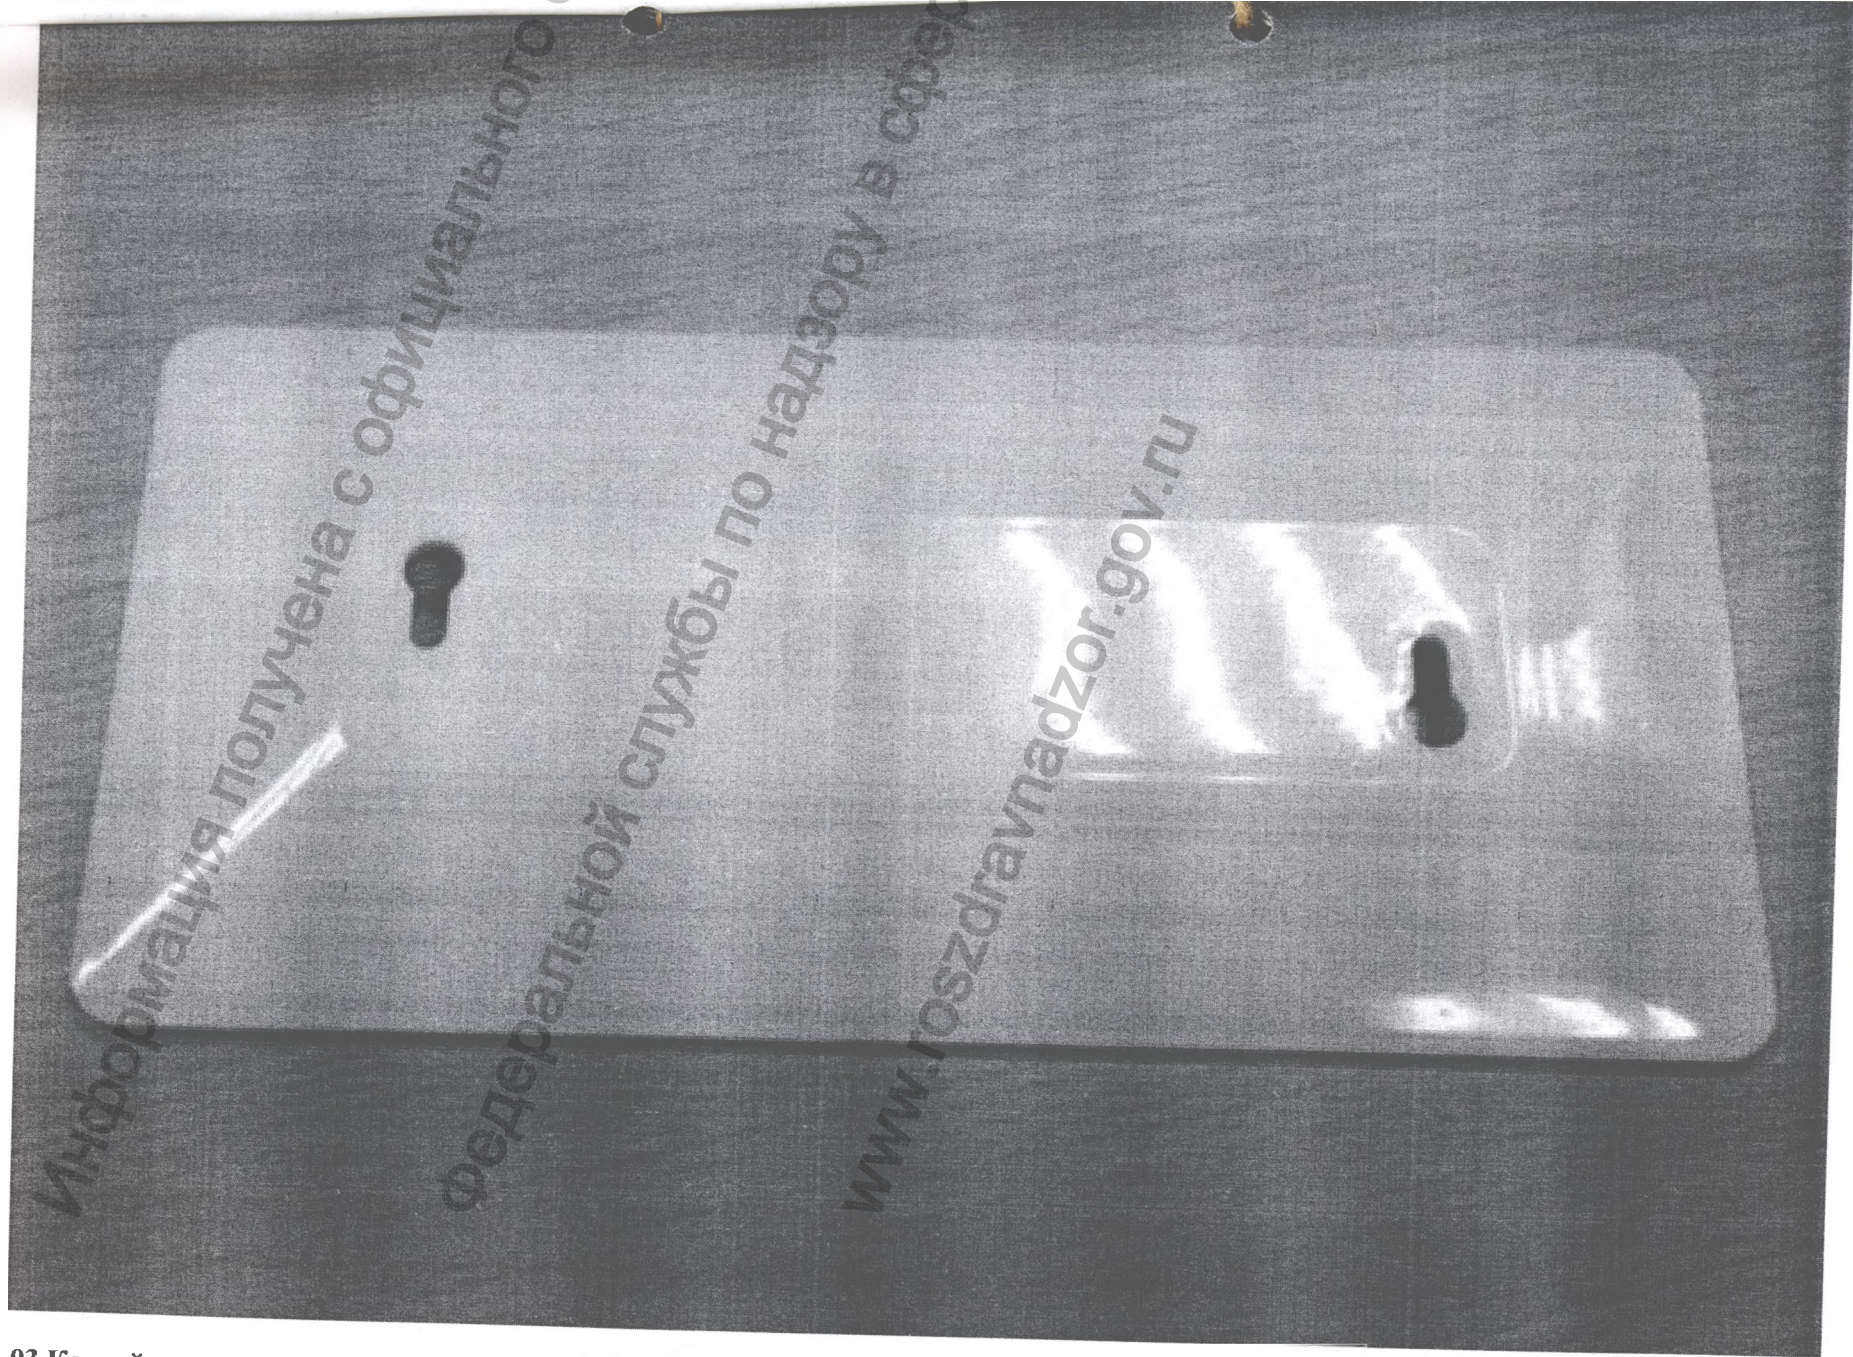


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение пресса контейнера)

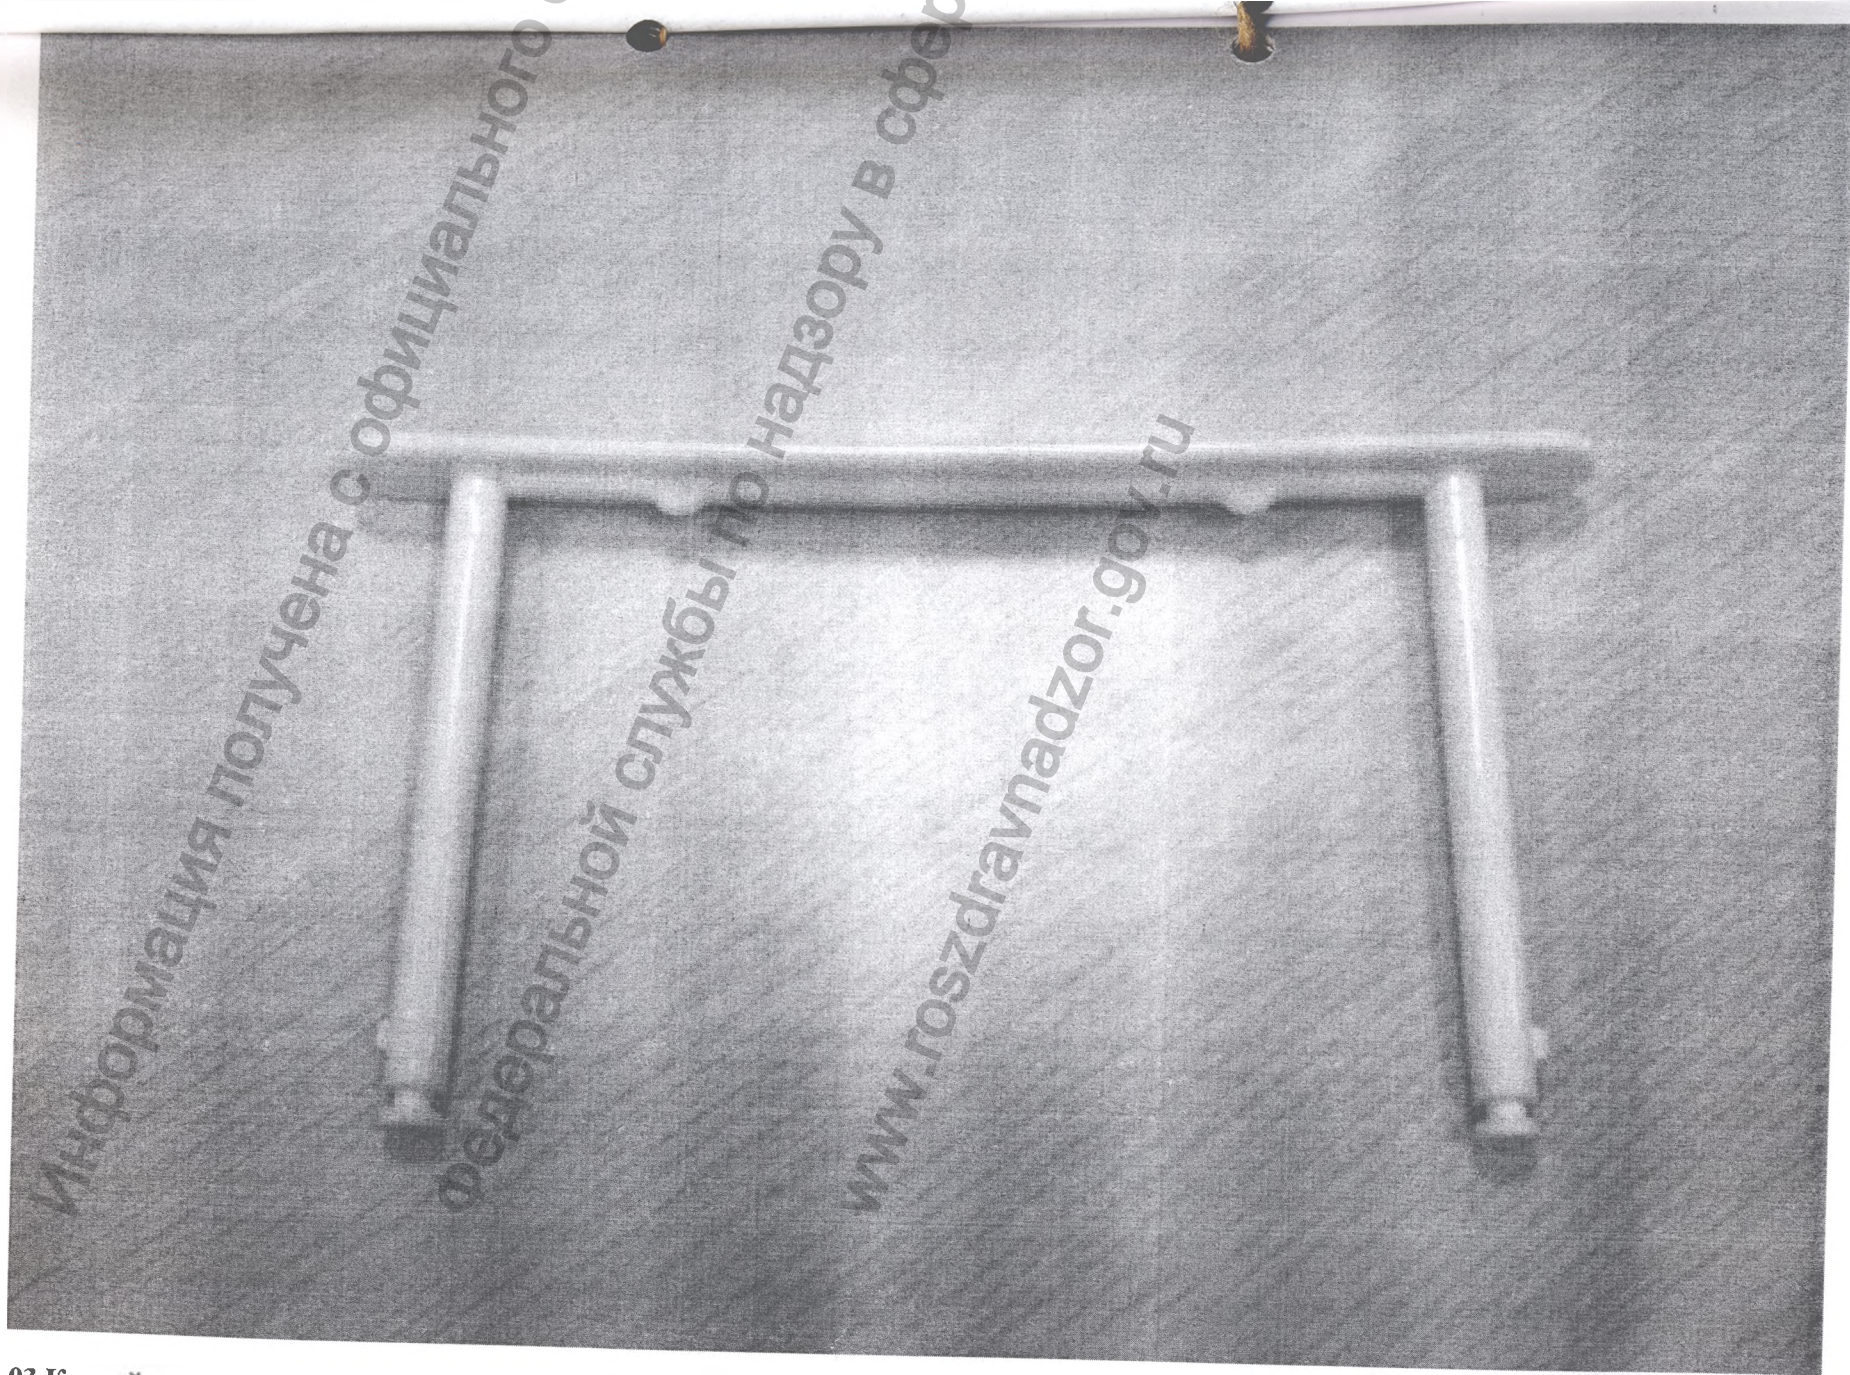

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л (Фотографическое изображение ручки контейнера)

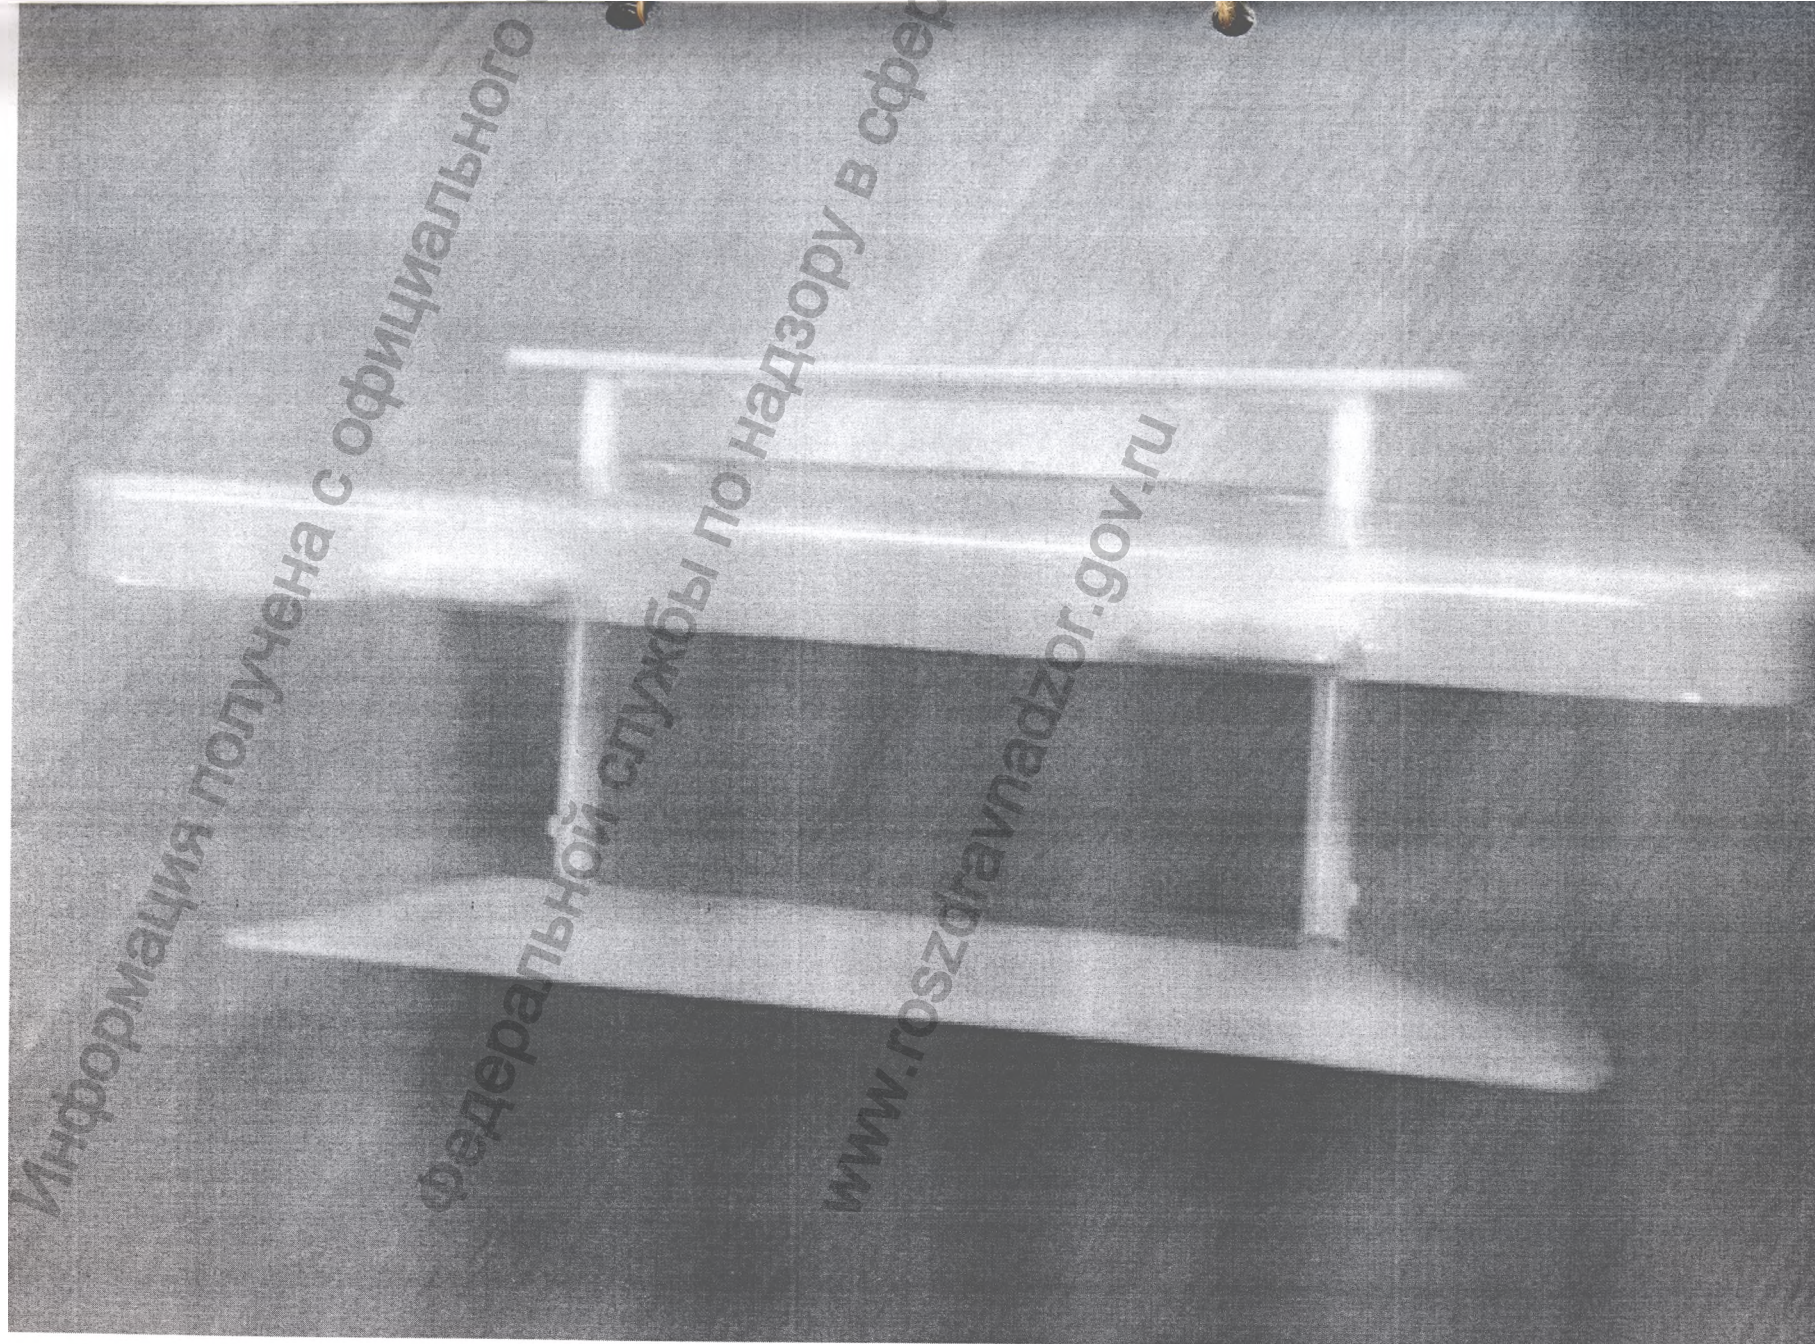


МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (белый), объемом 4,5 л. (Фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)

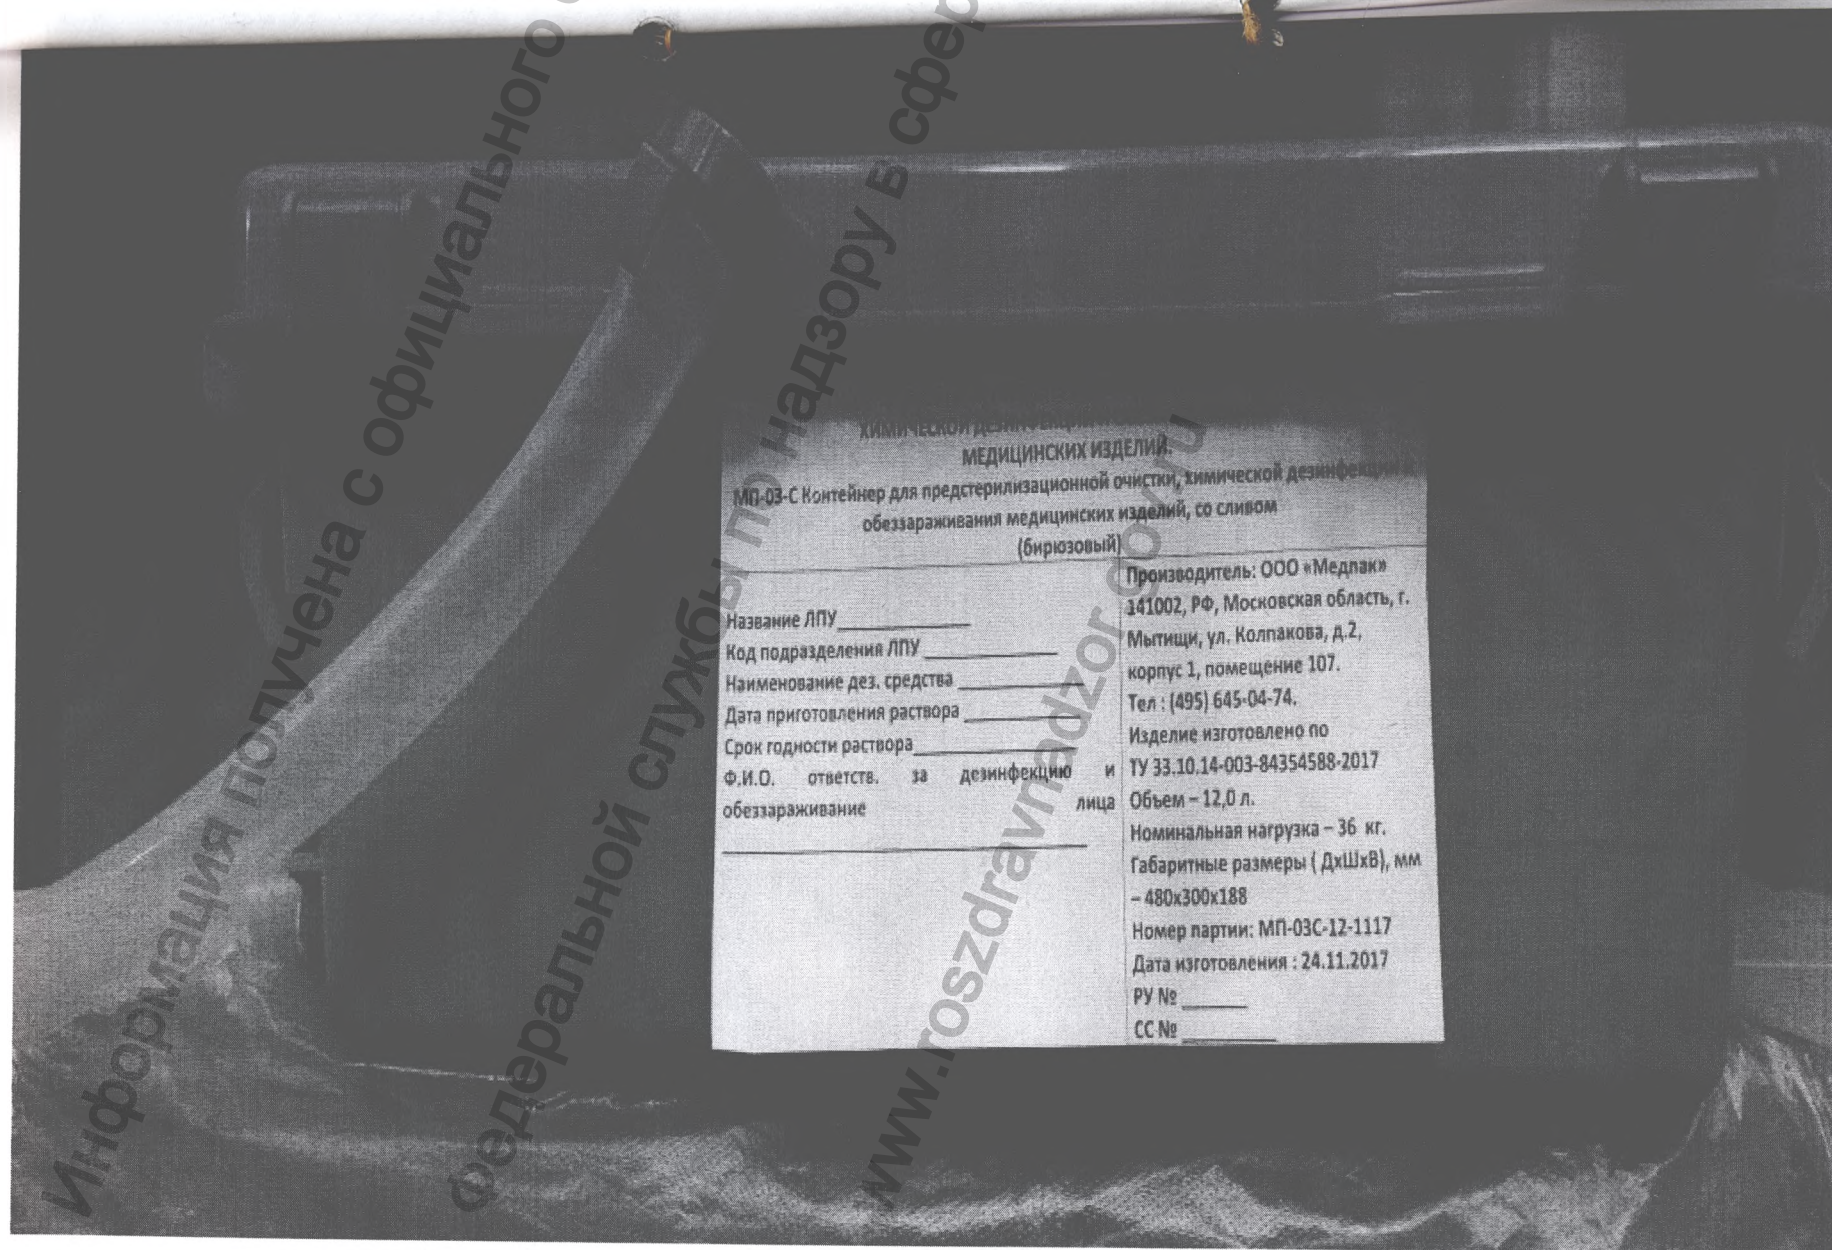


ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, со сливом
(бирюзовый)

Название ЛПУ _____	Производитель: ООО «Медпак»
Код подразделения ЛПУ _____	341002, РФ, Московская область, г.
Наименование дез. средства _____	Мытищи, ул. Колпакова, д.2,
Дата приготовления раствора _____	корпус 1, помещение 107.
Срок годности раствора _____	Тел : (495) 645-04-74.
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и _____	Изделие изготовлено по
обеззараживание _____	ТУ 33.10.14-003-84354588-2017
	Объем – 12,0 л.
	Номинальная нагрузка – 36 кг.
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	– 480х300х188
	Номер партии: МП-03С-12-1117
	Дата изготовления : 24.11.2017
	РУ № _____
	СС № _____


МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой), объемом 7,5 л. (Изделие в сборе)

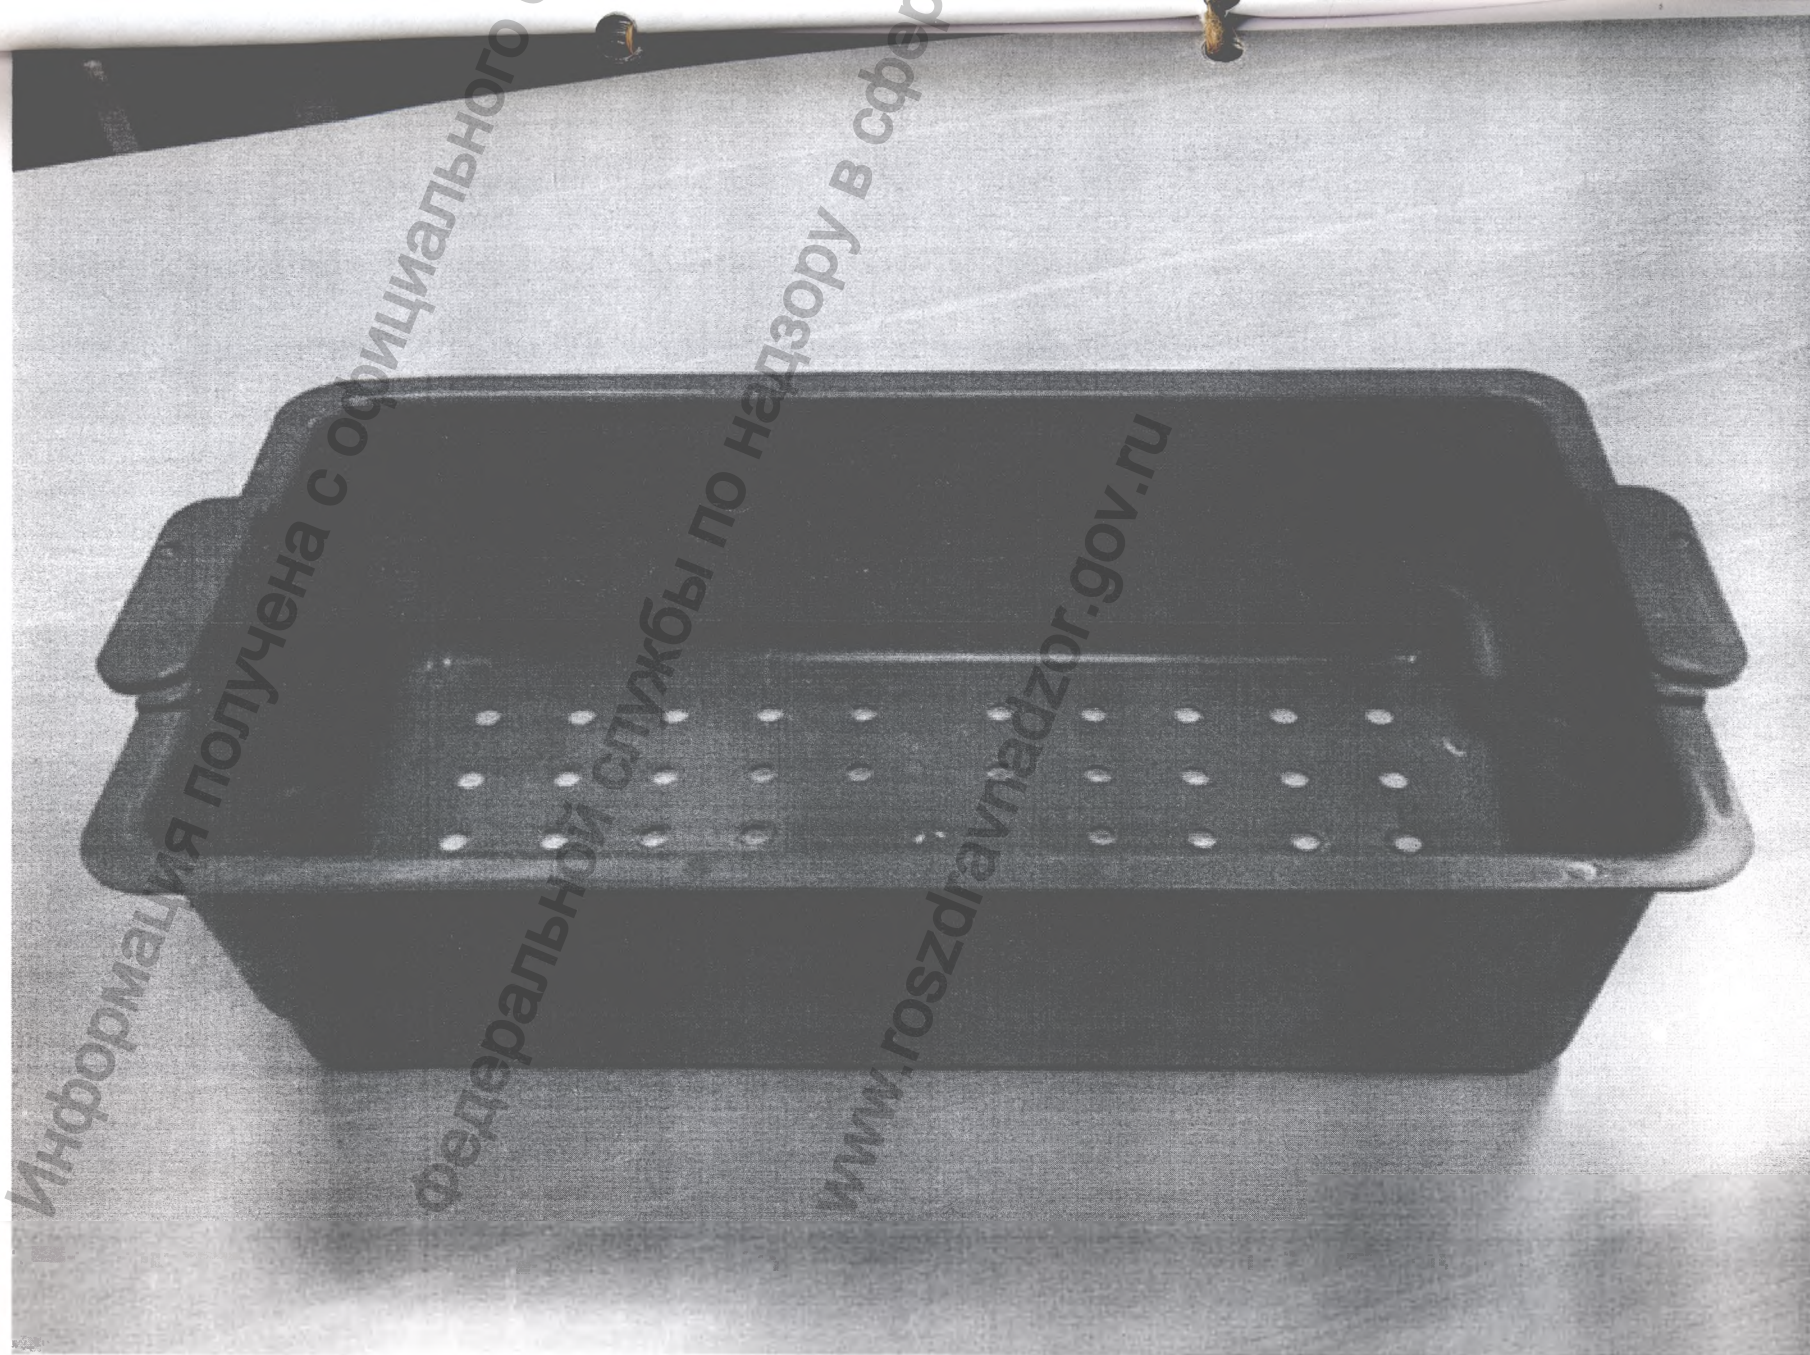

МПИ-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой) (Фотографическое изображение перфорированного контейнера-вкладки)

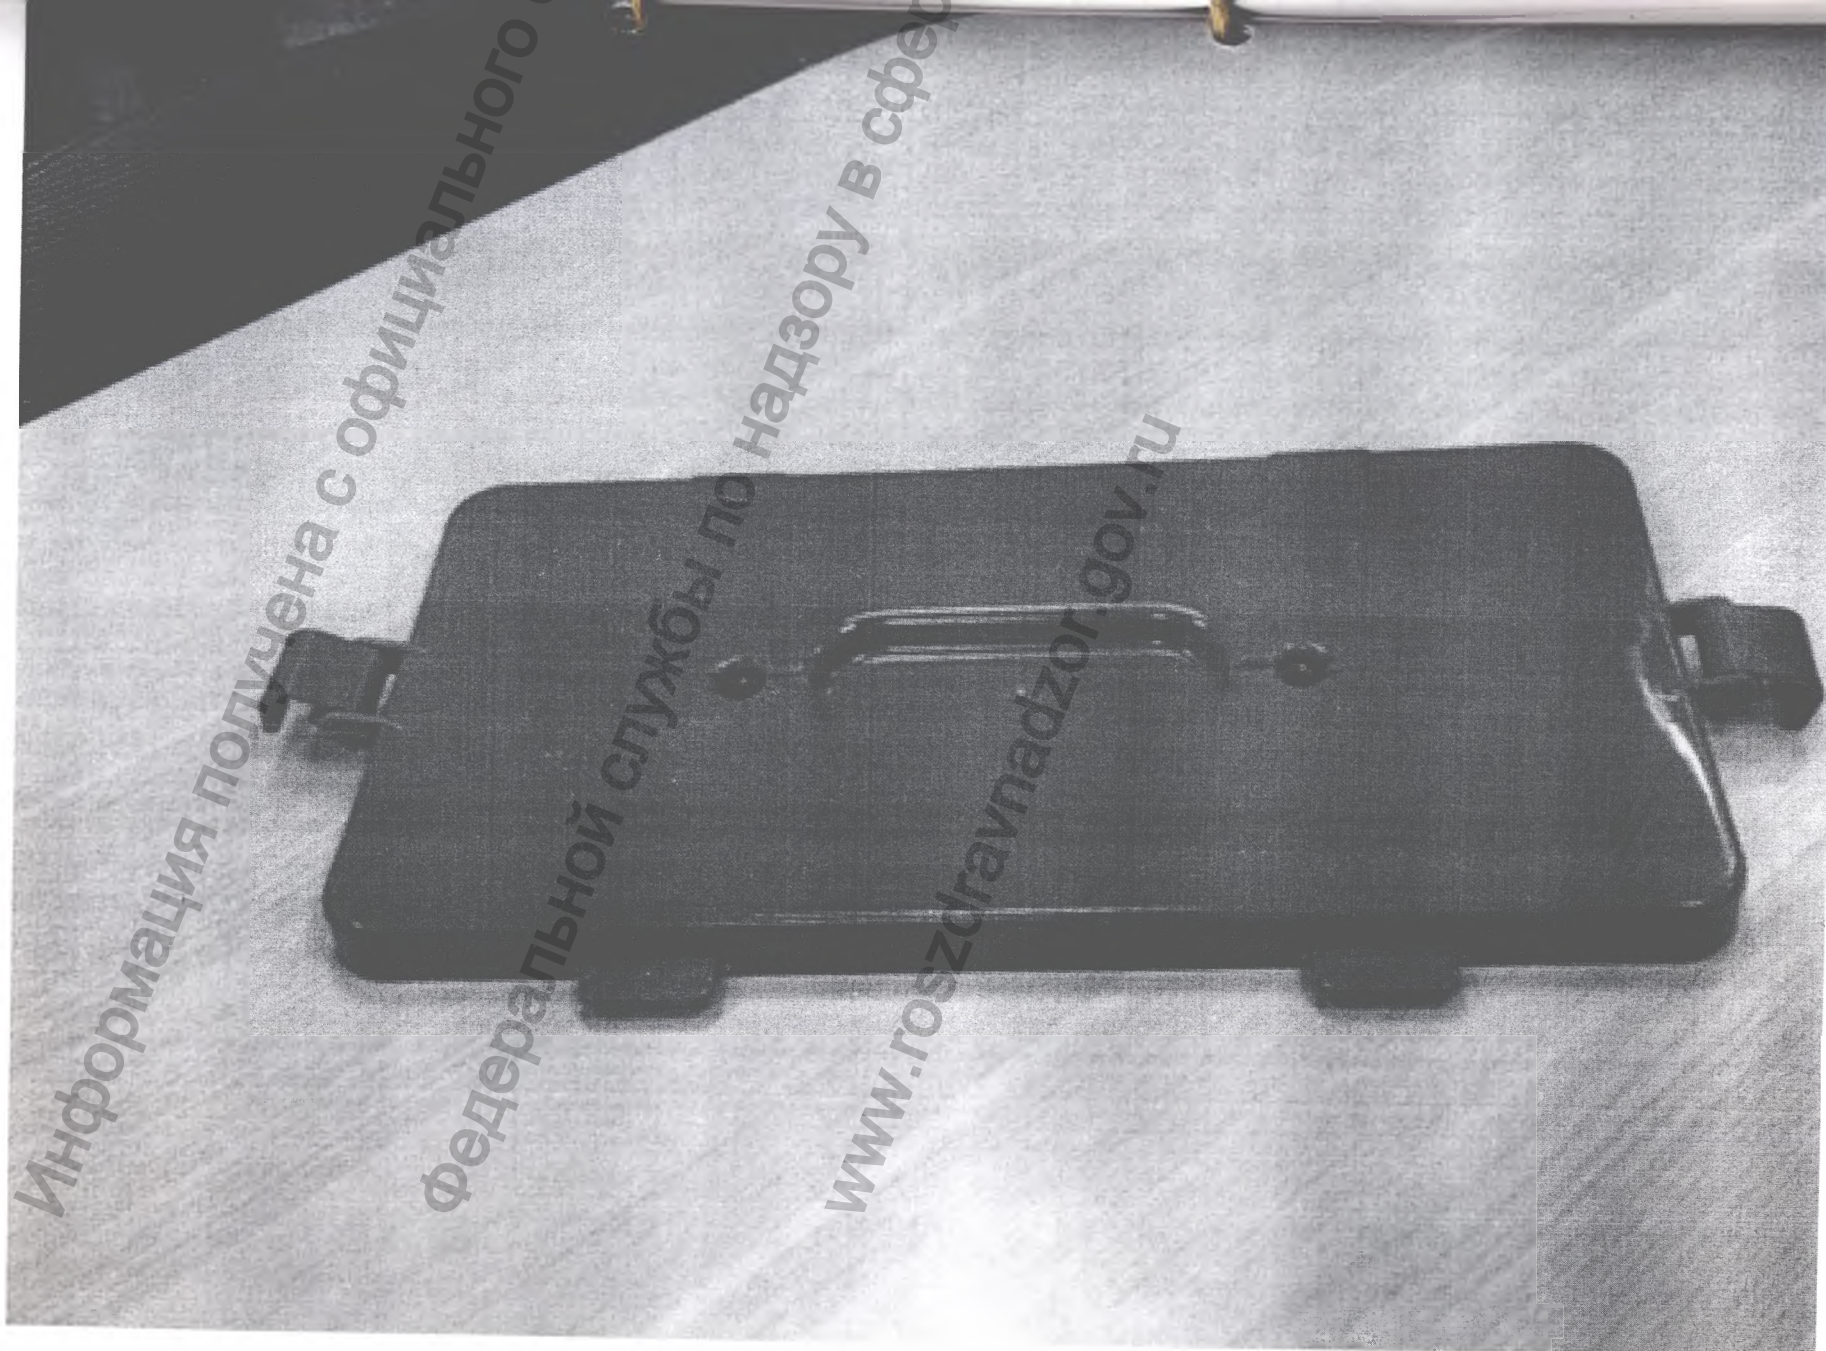


МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение крышки)

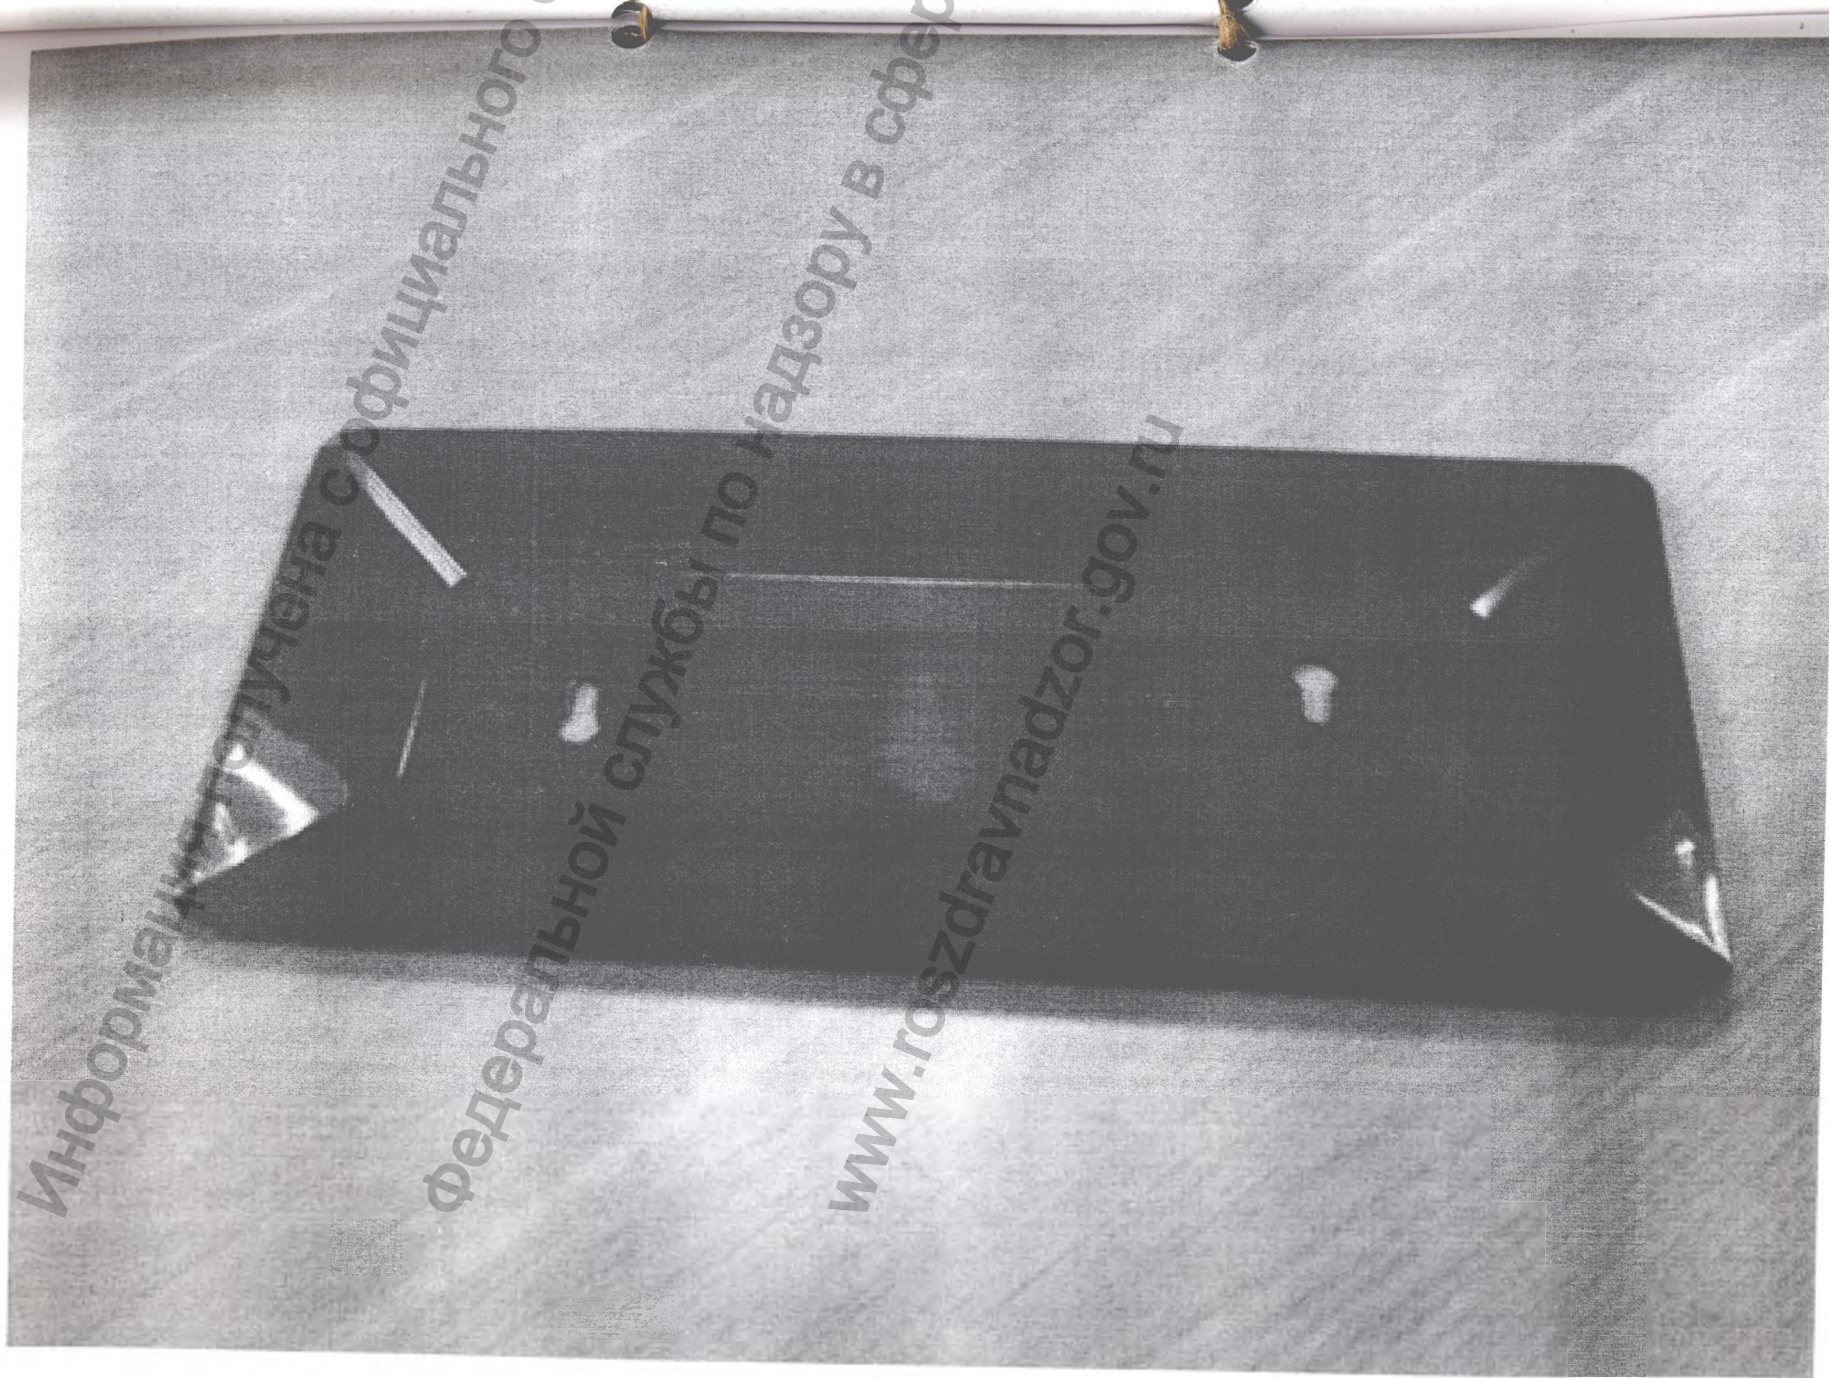

МПИ-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксацией в фиксаторе), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение пресса)



МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксацией) (Регистрация МИ в Росздравнадзоре), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение ручки)

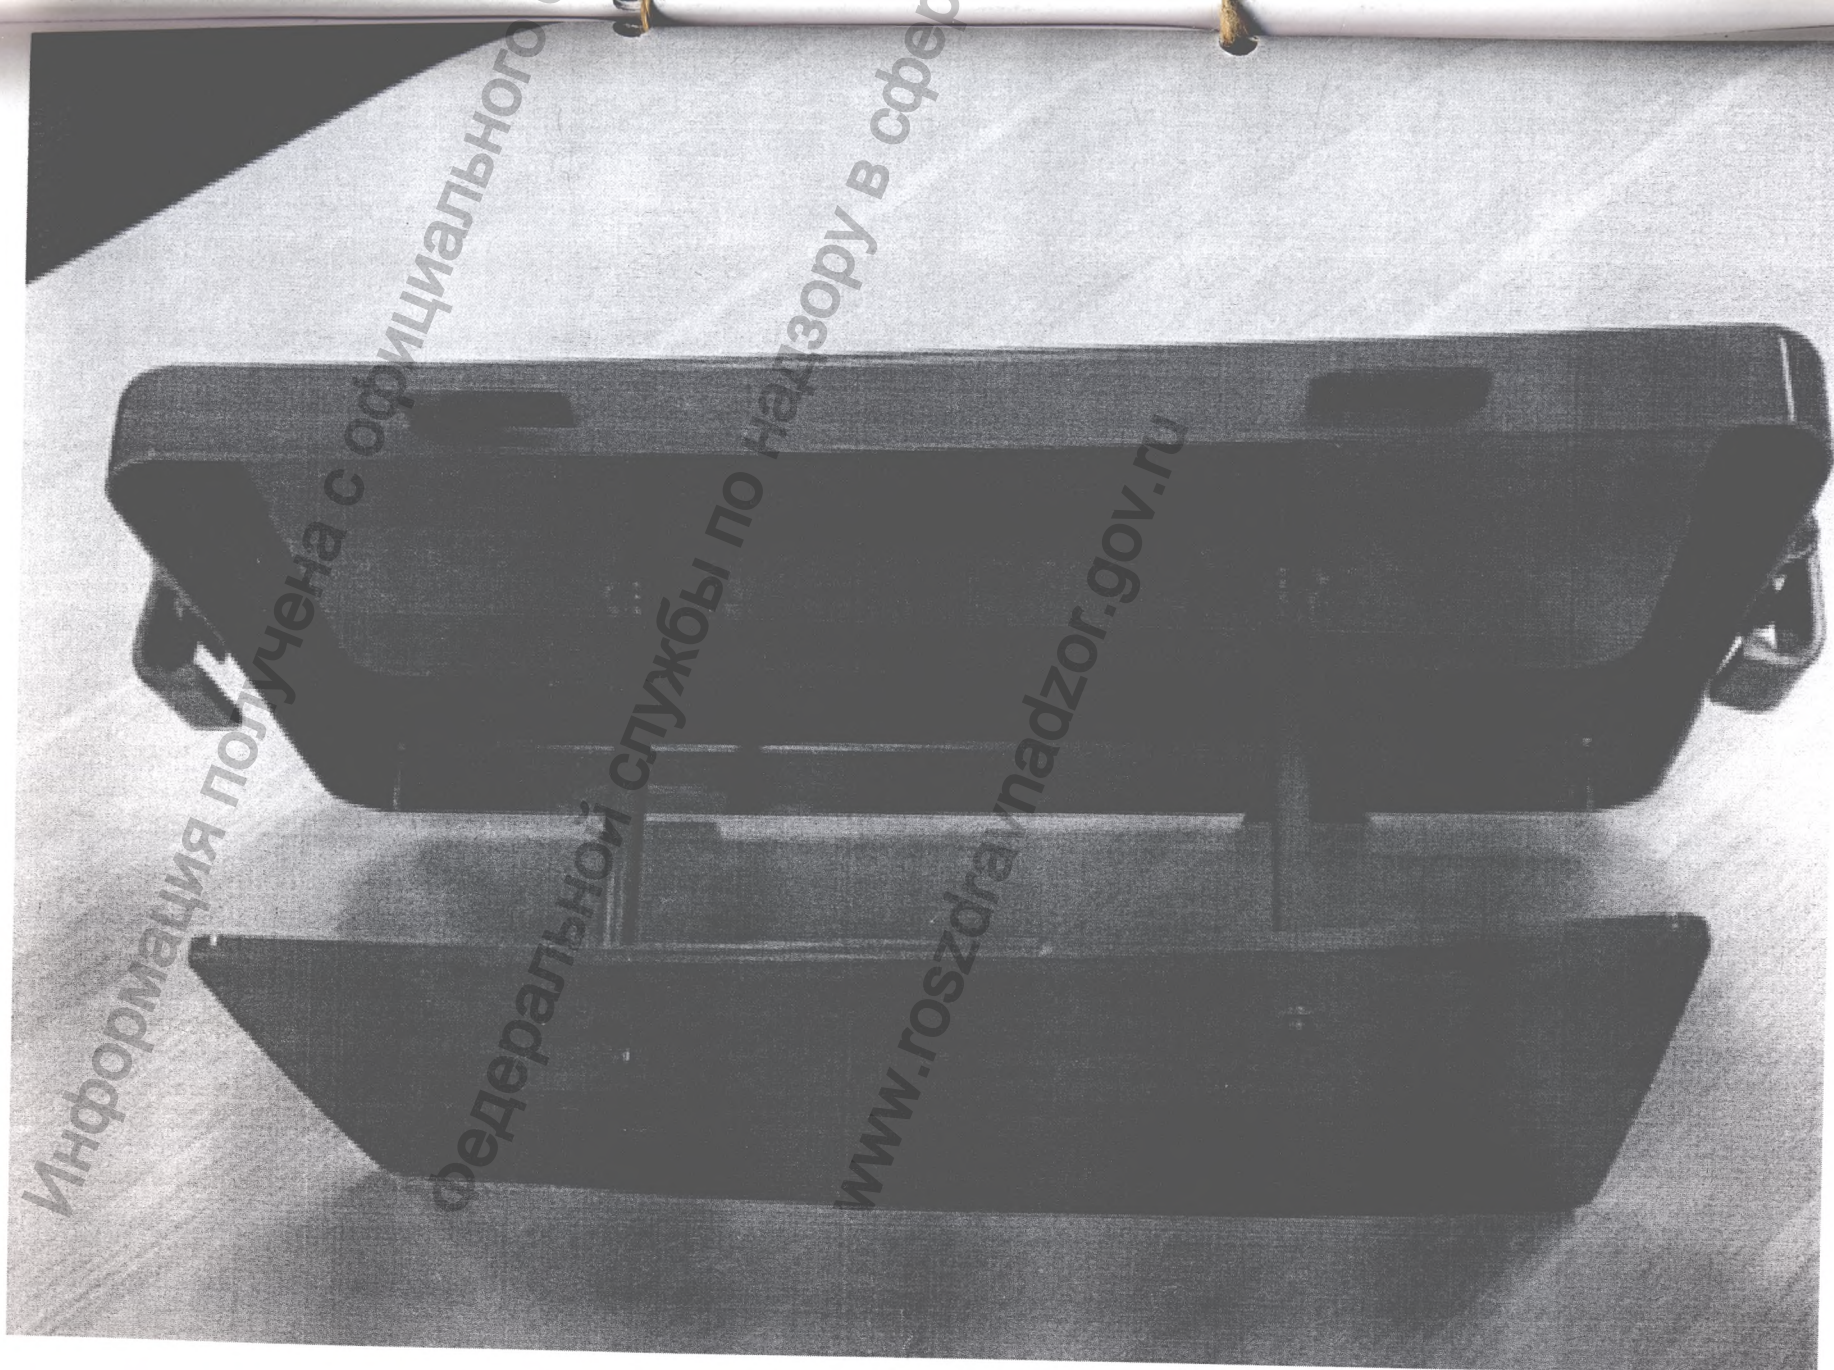

МП-03-Ф Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (бирюзовый) (с фиксирующейся крышкой), объемом 7,5 л. (Фотографическое изображение крышки в сборе с ручкой и прессом)




КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической
дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом),
(бирюзовый).

Название ЛПУ _____	Производитель: ООО «Медпак»
Код подразделения ЛПУ _____	141002, РФ, Московская область, г.
Наименование дез. средства _____	Мытищи, ул. Колпакова, д.2,
Дата приготовления _____	корпус1, помещение 107.
раствора _____	Тел : (495) 645-04-74.
Срок годности раствора _____	Изделие изготовлено по ТУ
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и _____	33.10.14-003-84354588-2017
обеззараживание лица _____	Объем – 12,0 л.
	Номинальная нагрузка – 36 кг.
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
	480х300х188
	Дата изготовления : _____
	РУ № _____
	СС № _____


МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
(бирюзовый), объемом 12,0 л. (Изделие в сборе)

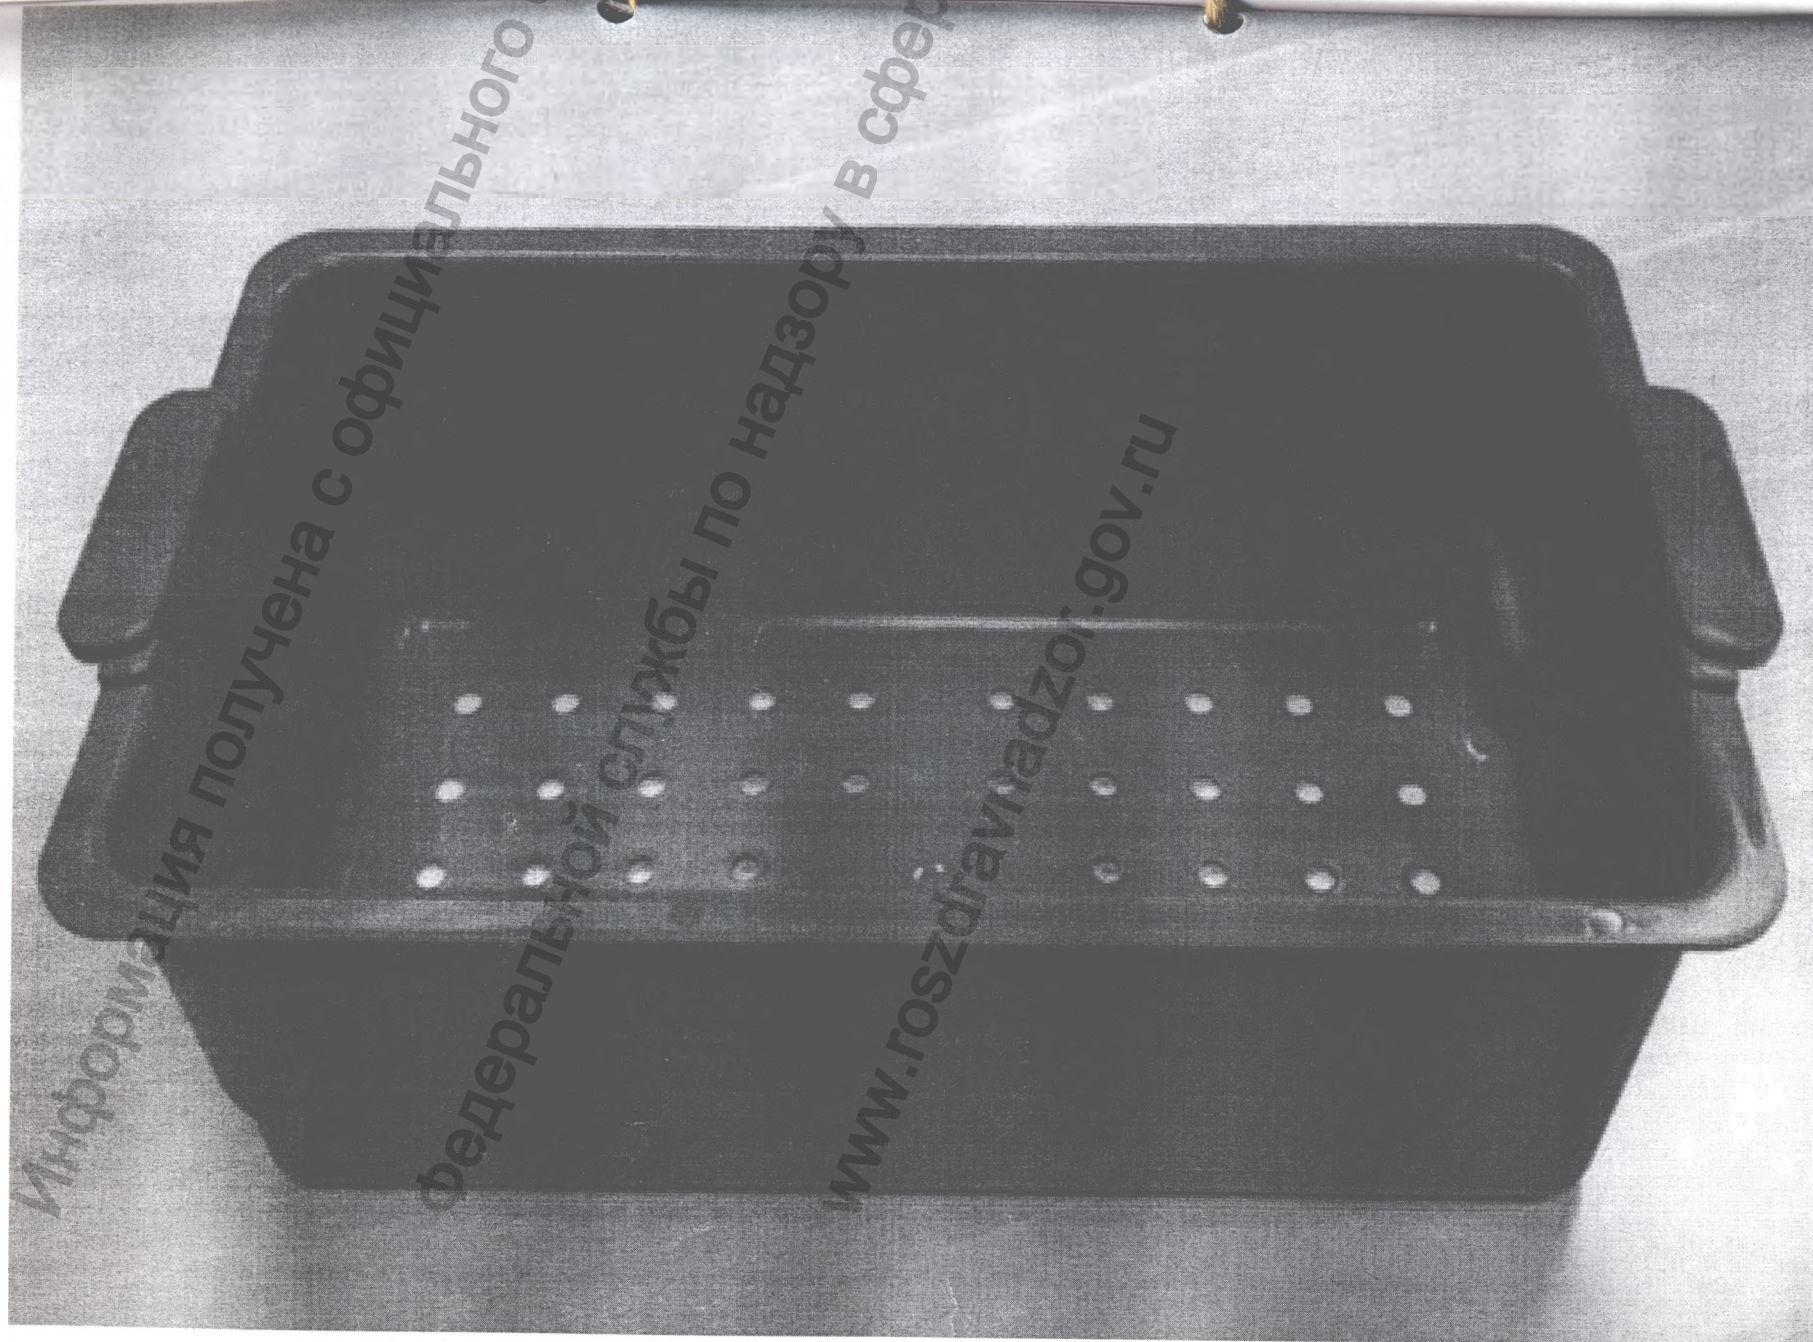

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объемом 12,0 л. (Фотографическое изображение перфорированного контейнера-вкладки)



МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объемом 12,0 л. (Фотографическое изображение основного контейнера с полочками наружу)

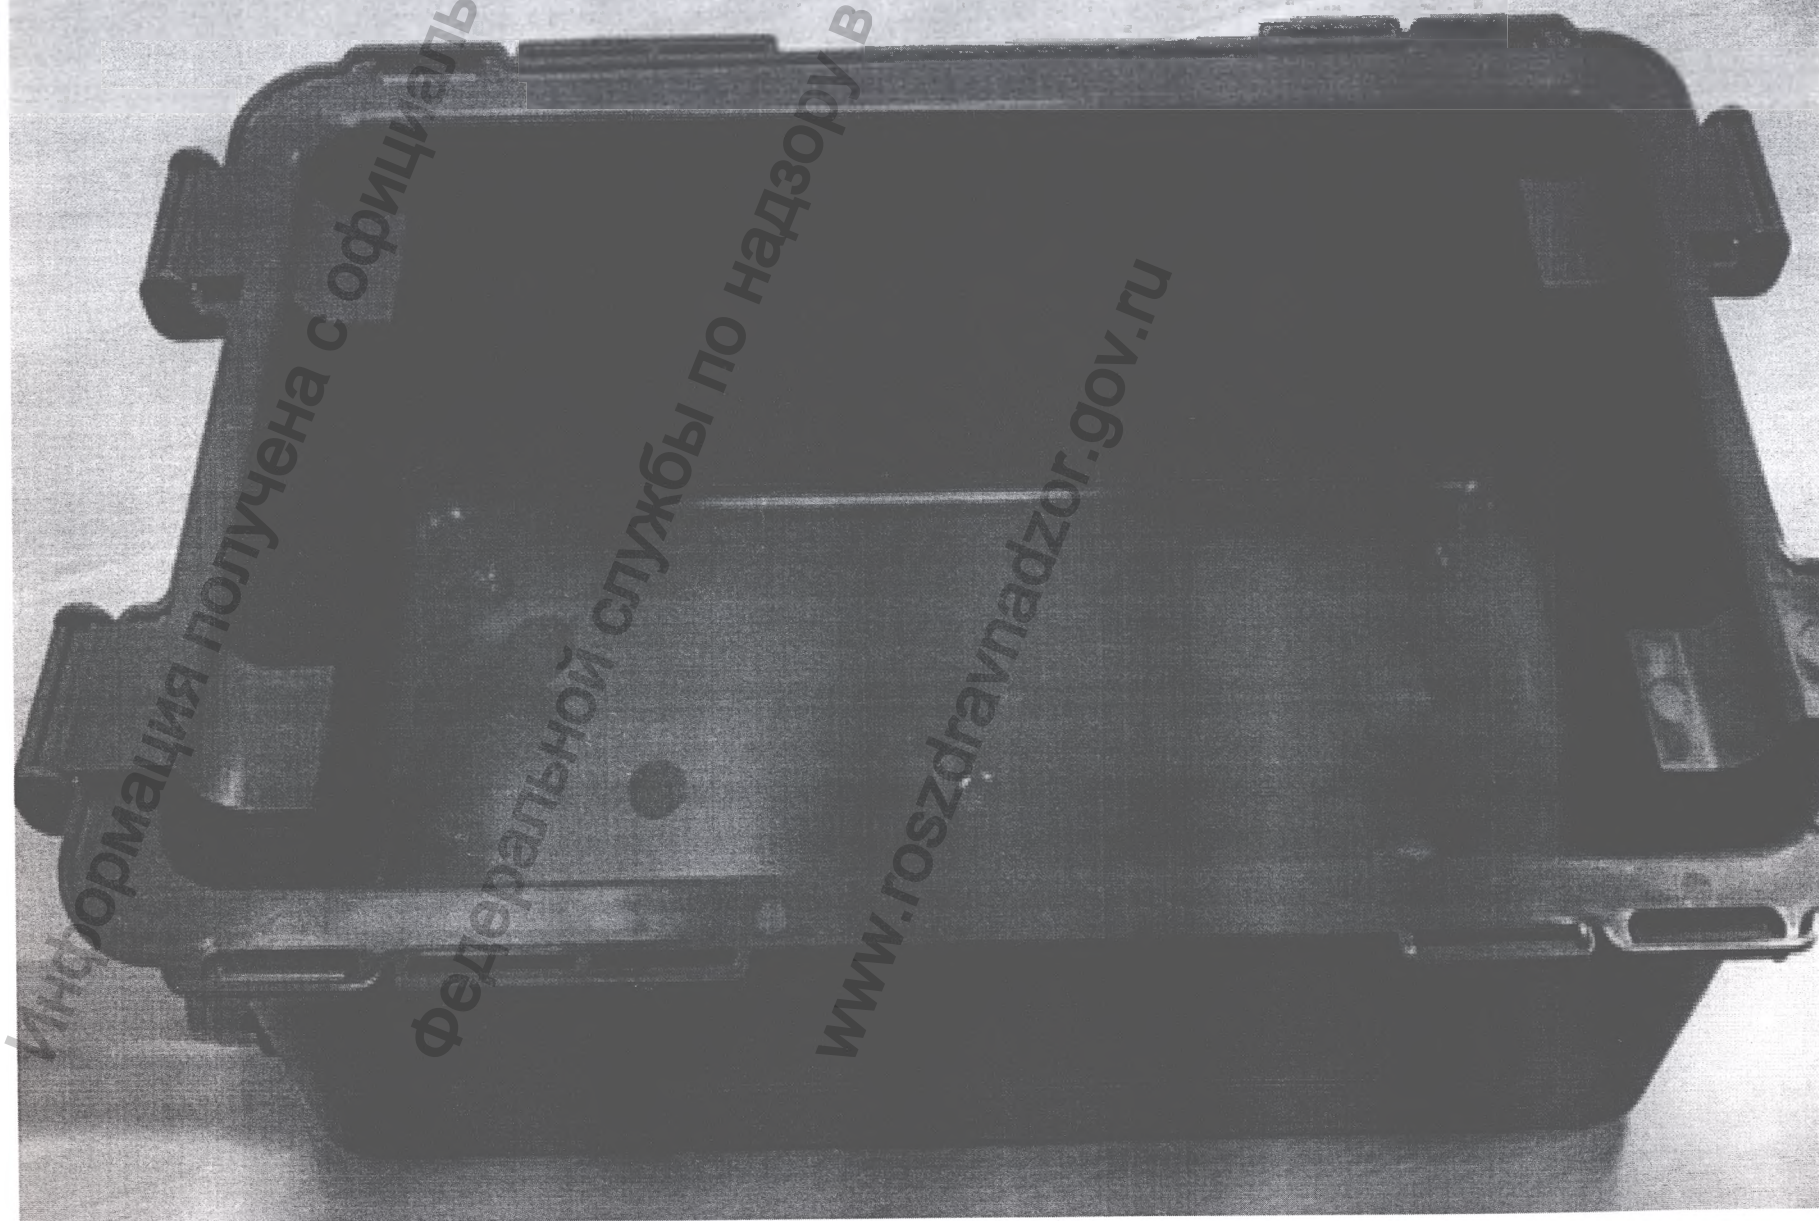


МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объём 10 л

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Графическое изображение основного контейнера с полочками внутри)




МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), объемом 12,0 л. (Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru) изображение основного контейнера с перфорированным контейнером- вкладкой,

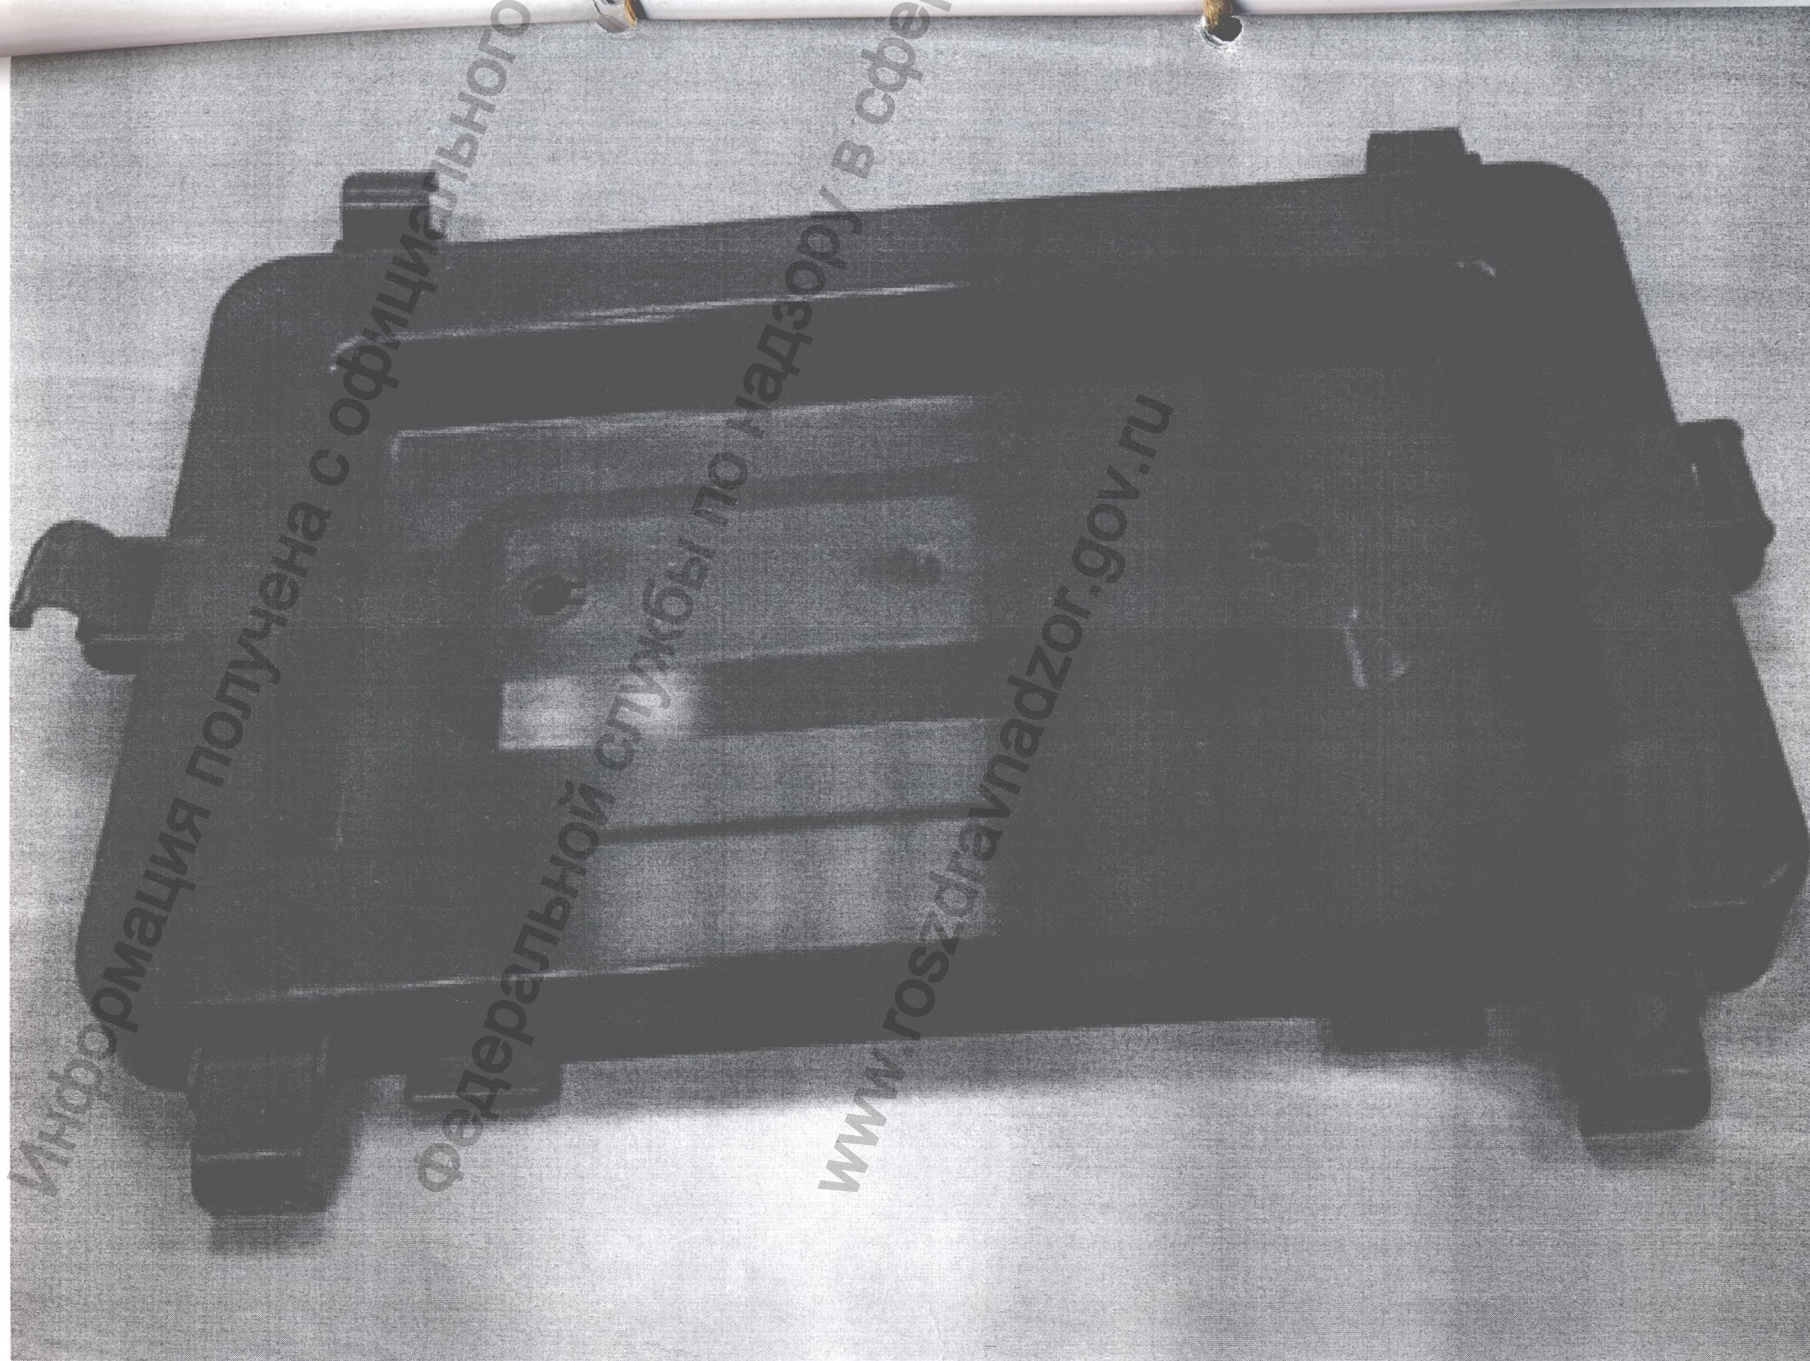

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
(б www.nevacert.ru | info@nevacert.ru) ем 12,0 л. (Фотографическое изображение крышки)




МПИ-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)

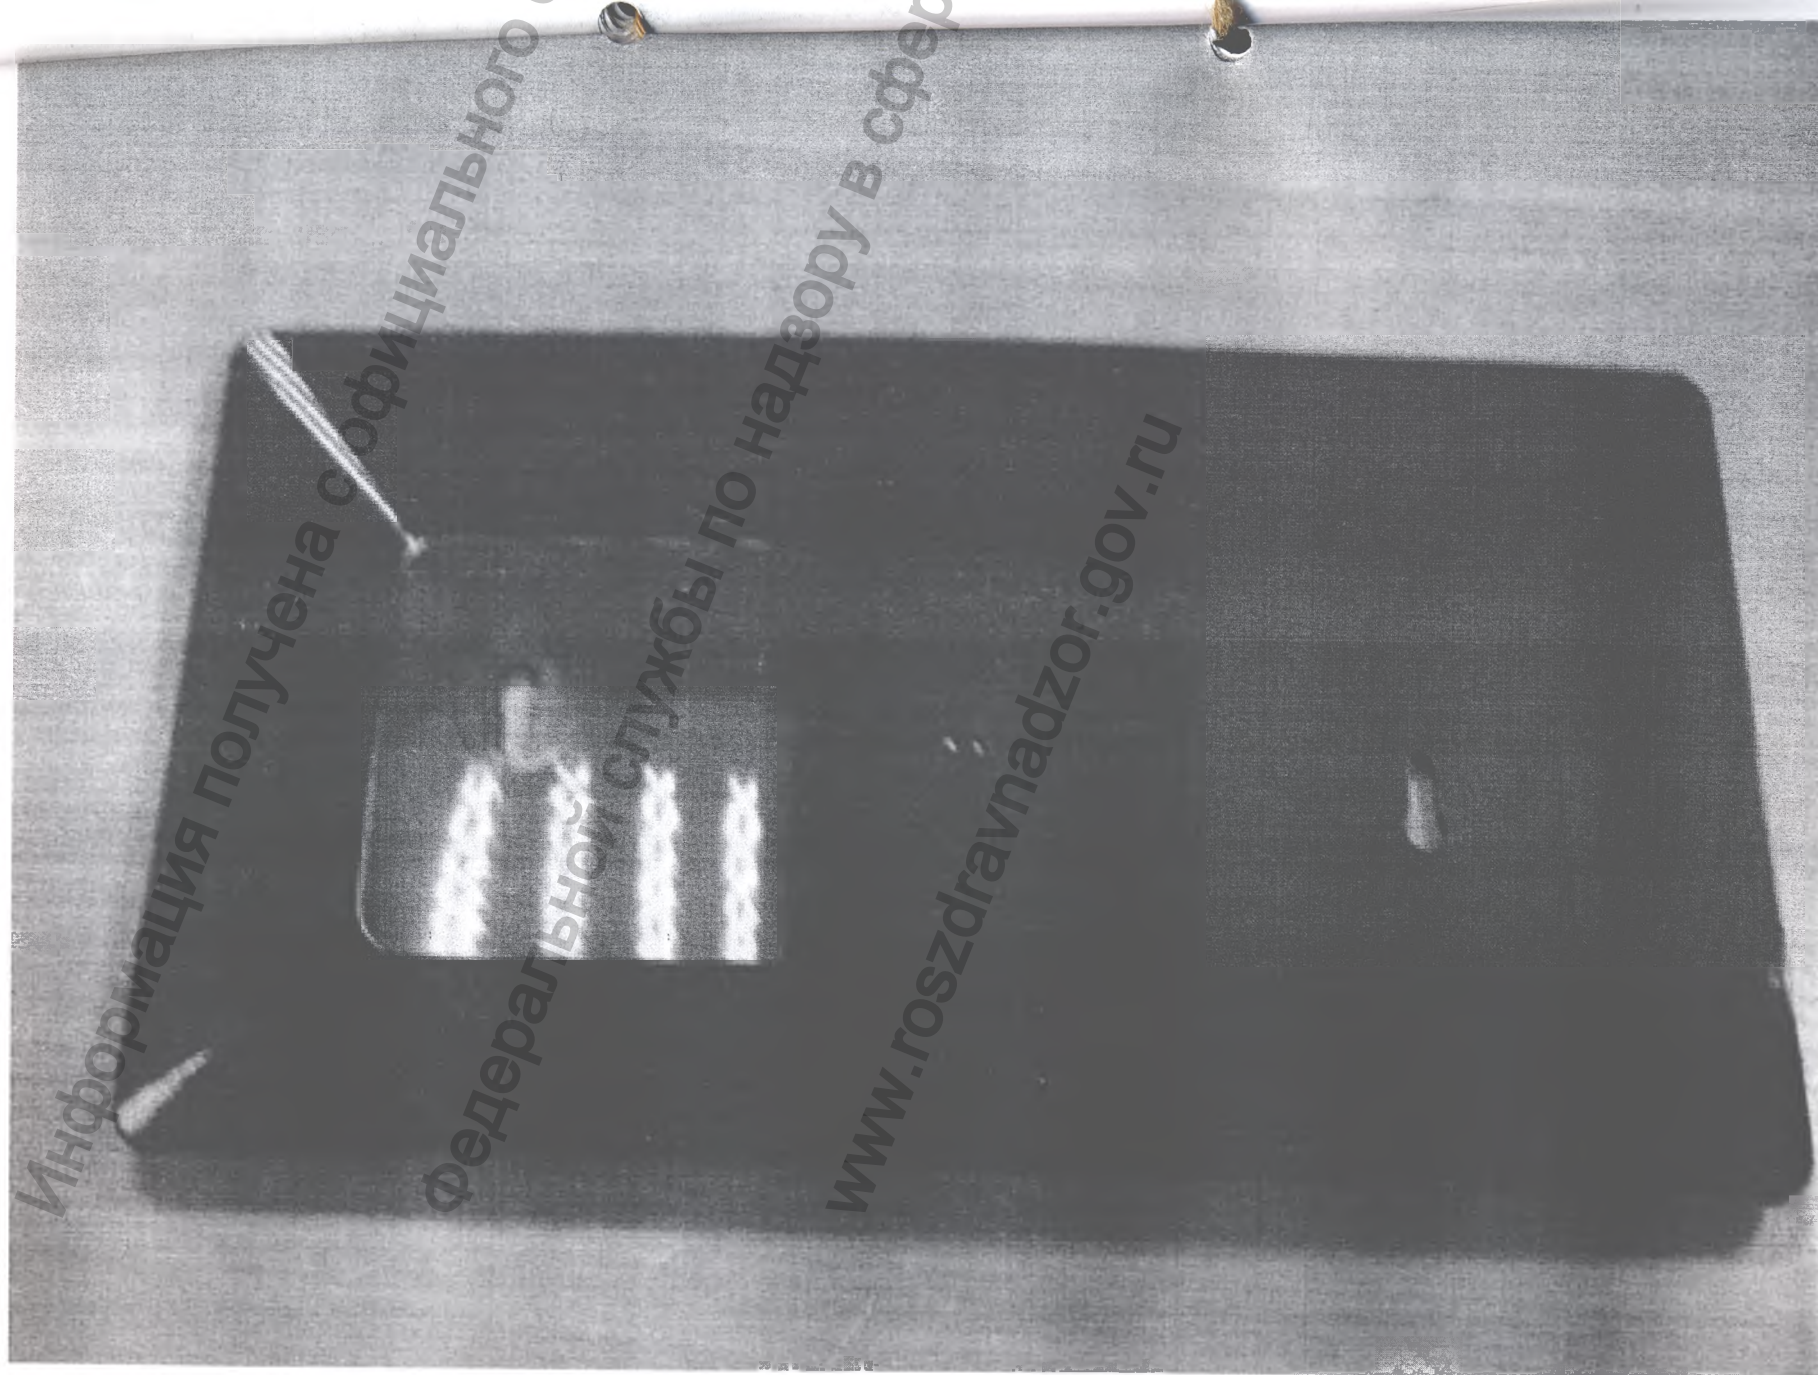


МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)

(Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru) **Мом 12,0 л. (Фотографическое изображение пресса)**

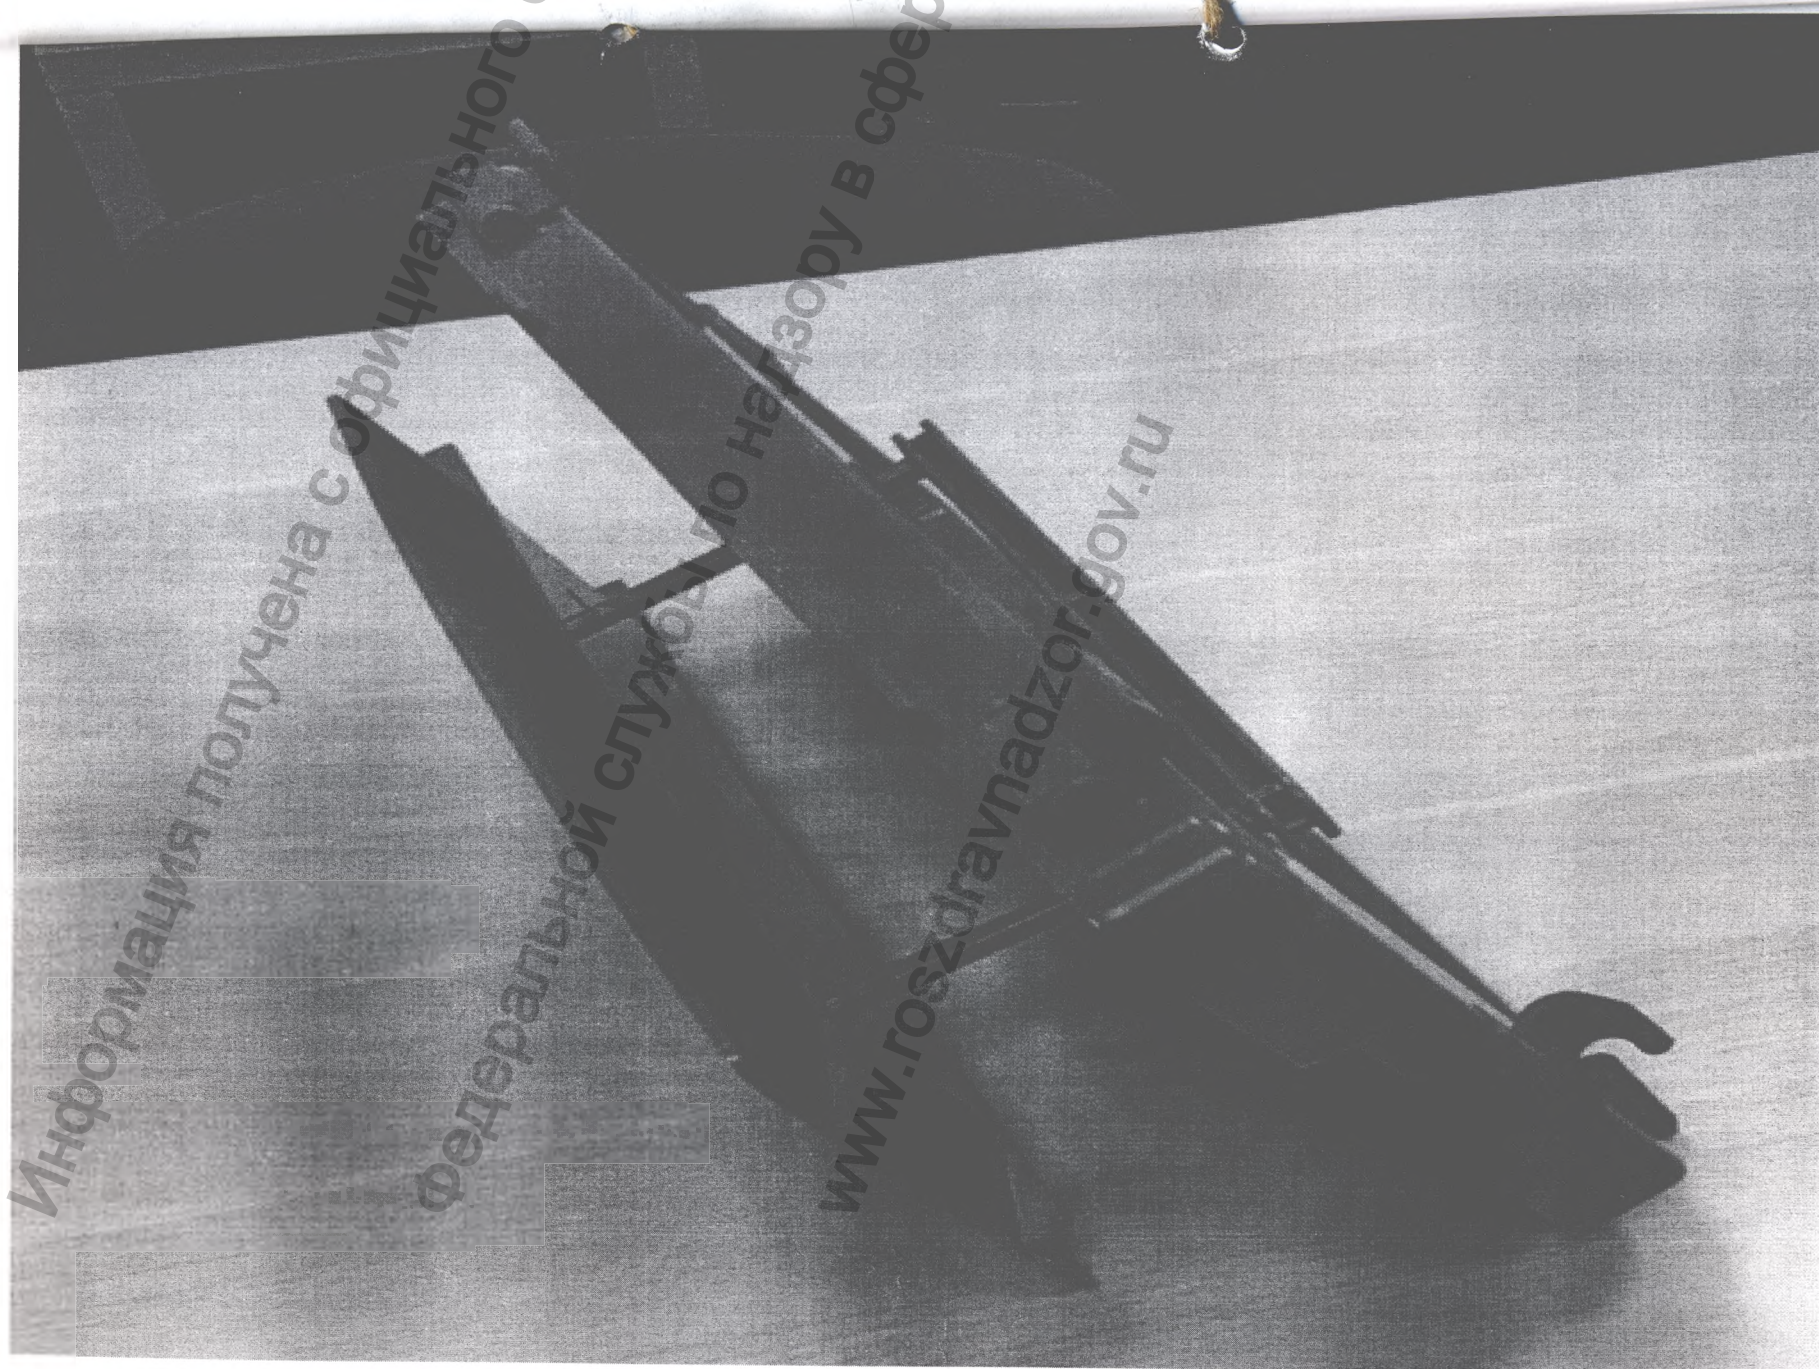

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом) (бирюзовый), фотография крышки в сборе с ручкой и прессом)

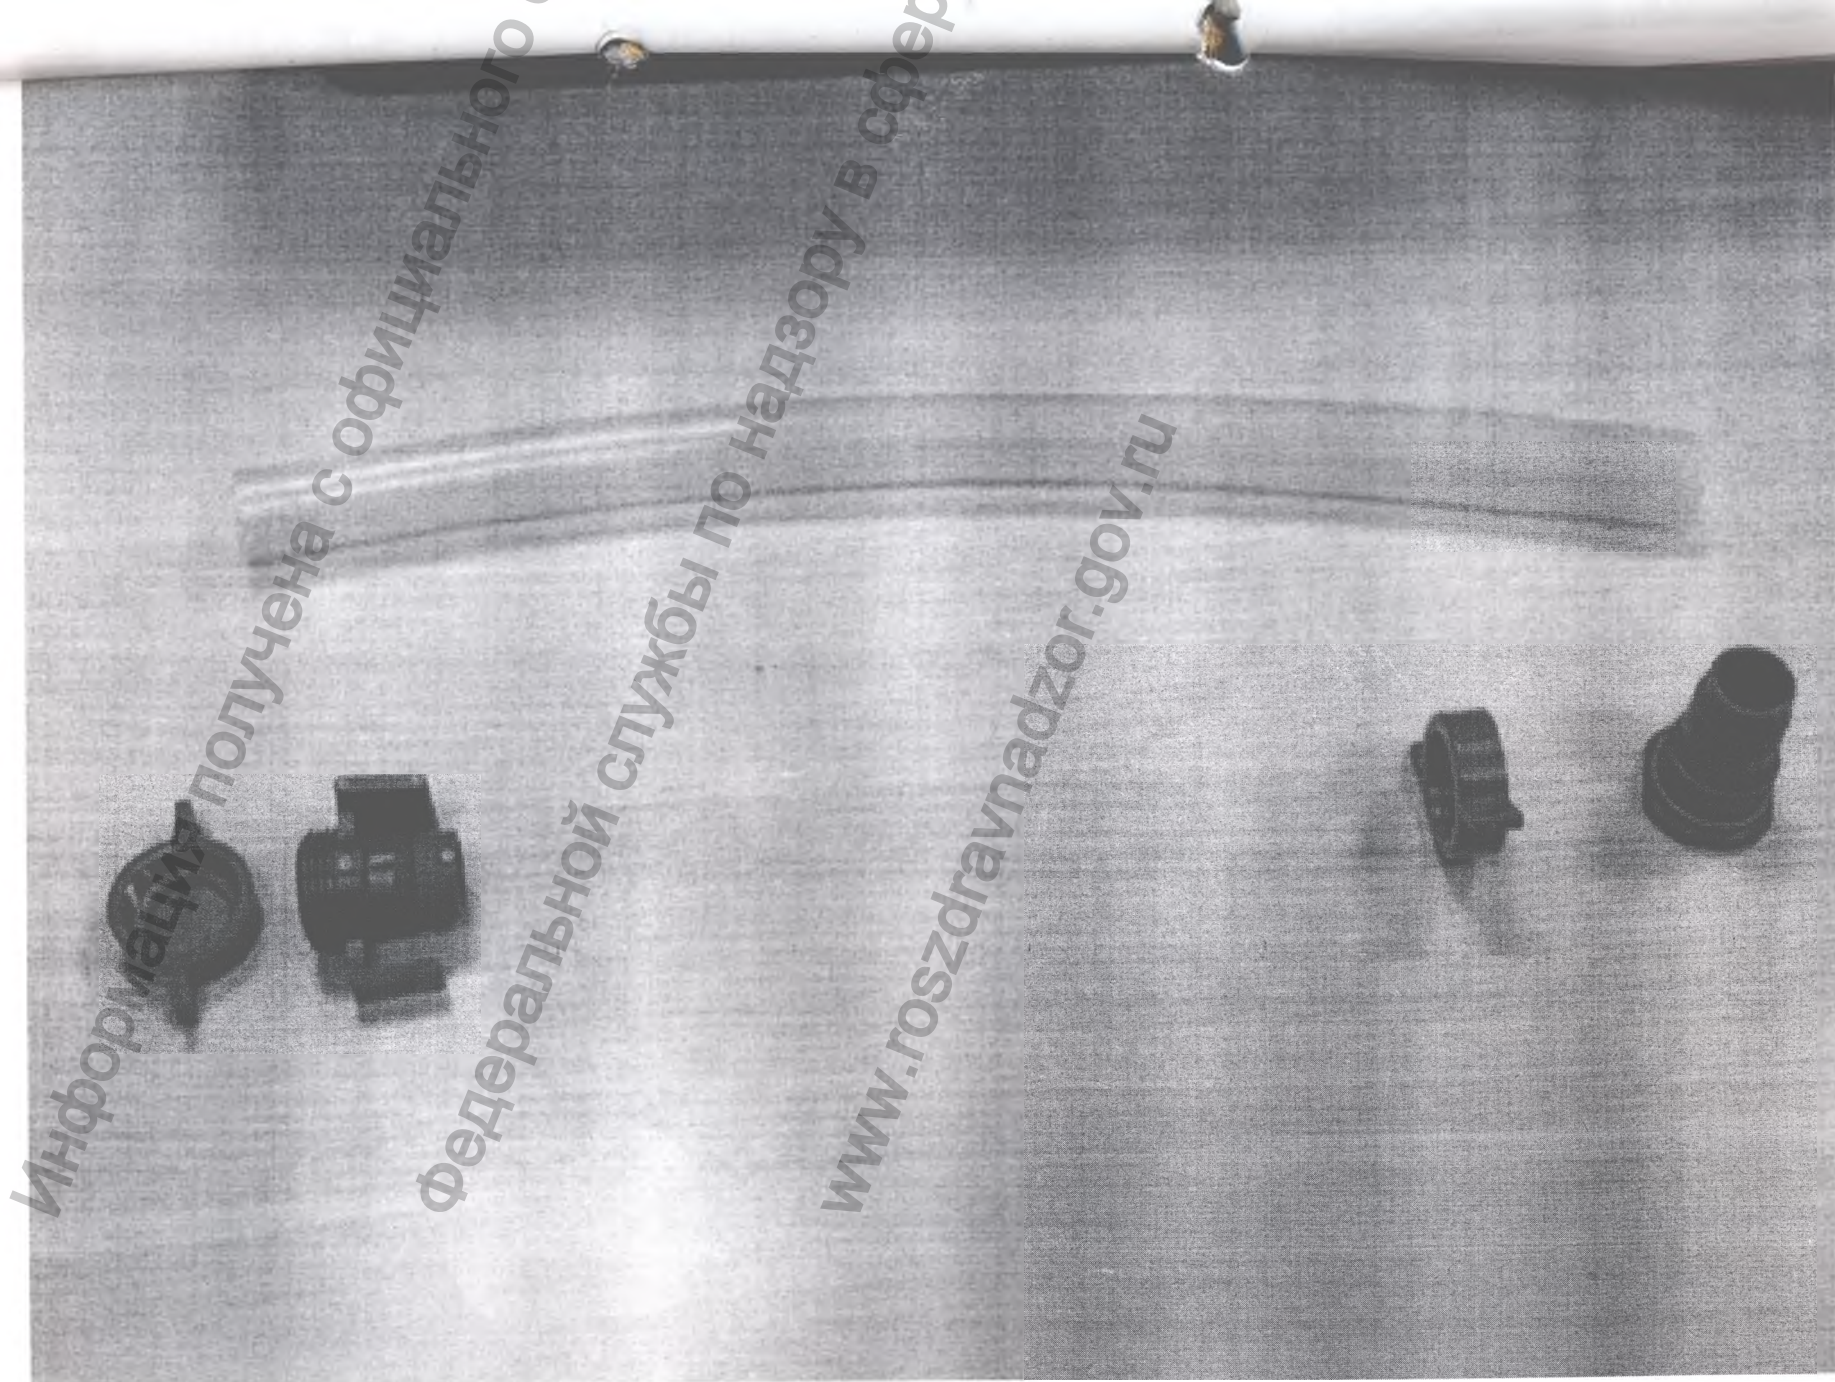

МП-03-С Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий (со сливом)
(бирюзового цвета, с крышкой) л. (Фотографическое изображение слива в разобранном виде)

Макет маркировки

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (бирюзовый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.

Тел : (495) 645-04-74.

Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017

Объем –1,3 л.

Номинальная нагрузка – 4,5 кг.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
170*120*130

Серийный номер МП-03-1.3-1117

Дата изготовления : 24.11.2017

РУ № _____

СС № _____

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ,
ХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

МП-03 Контейнер для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и
обеззараживания медицинских изделий, с крышкой (бирюзовый).

Название ЛПУ _____
Код подразделения ЛПУ _____
Наименование дез. средства _____
Дата приготовления раствора _____
Срок годности раствора _____
Ф.И.О. ответств. за дезинфекцию и
обеззараживание лица _____

Производитель: ООО «Медпак»
141002, РФ, Московская область, г.
Мытищи, ул. Колпакова, д.2, корпус1,
помещение 107.

Тел : (495) 645-04-74.

Изделие изготовлено по
ТУ 33.10.14-003-84354588-2017

Объем – 4,5 л.

Номинальная нагрузка – 8,0 кг.

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм –
375x205x130

Серийный номер МП-03-4.5-1117

Дата изготовления : 24.11.2017

РУ № _____

СС № _____

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru



Простыня прокупила
25 (двадцать пять)
листов