Генеральный директор ООО «Дентсплай Сирона»



Фотографическое изображение

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Инструменты для системы дентальных имплантатов Astra Tech Implant System®, PrimeTaper, варианты исполнений: EV, Profile EV, TX, многоразовые

производства

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany/ Германия





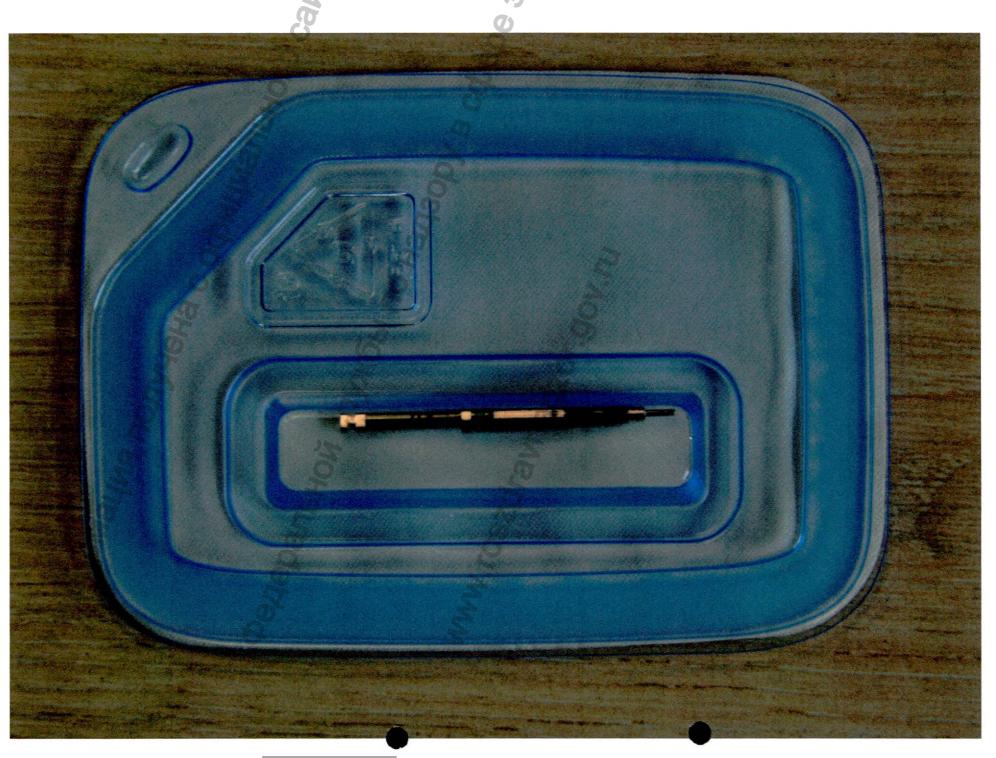

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru











ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007

(11)150102 (10)123456

Astra Tech Implant System





Made in <Country>





Dentsoly Imprants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Имплантовод EV 3.0 длинный (Implant Driver EV 3.0 Long)

Implant Driver EV 3.0 Long

PУ № P3H 2020/10009

XXXX.XX.XX TO

REF 25377

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия


Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



if a. dentapty sirona. com



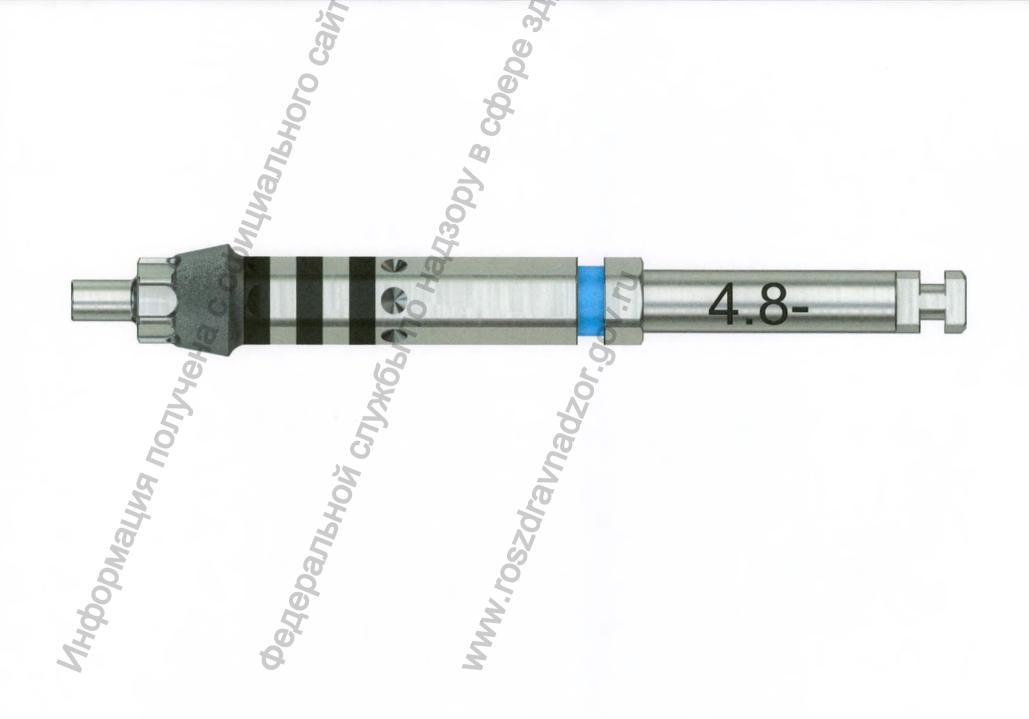



Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru







LOT 999999





ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007 (11)150102

(10)123456

Astra Tech Implant System



Made in <Country>



Dentsply Sirona

Dentsply Impiants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Имплантовод EV 4.8 длинный (Implant Driver EV 4.8 Long)

Implant Driver EV 4.8 Long

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 25383

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях; см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия


Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.denlaplysirona.com




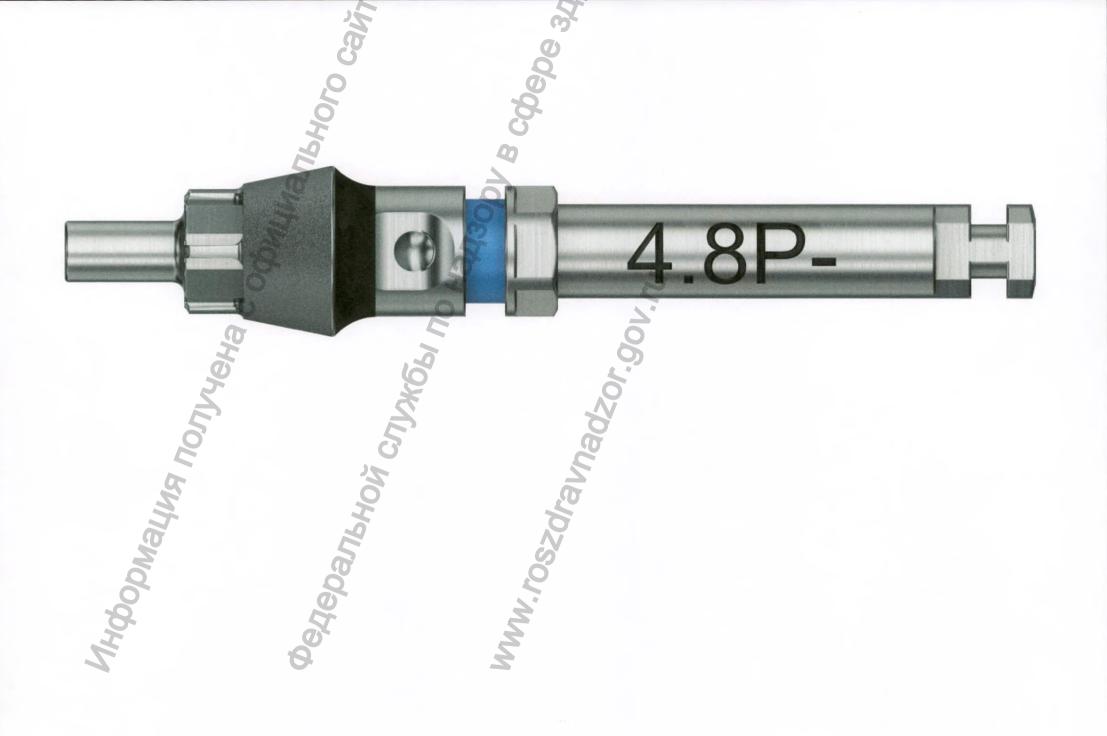



Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Макет маркировки и русскоязычной этикетки

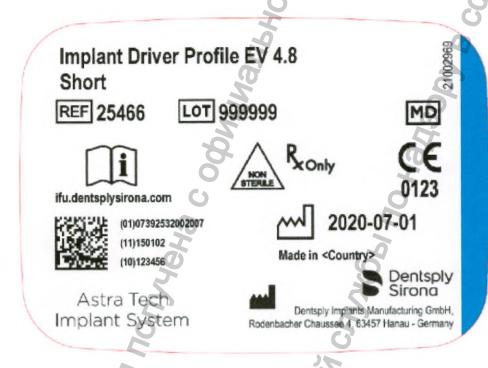

Имплантовод Profile EV 4.8 P короткий (Implant Driver Profile EV 4.8 P Short)

Implant Driver Profile EV 4.8 P Short

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 25466

см. на упаковке

Только для использования врачами стомат опогами. Инф ормация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

...

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия


Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentaplysirona.com





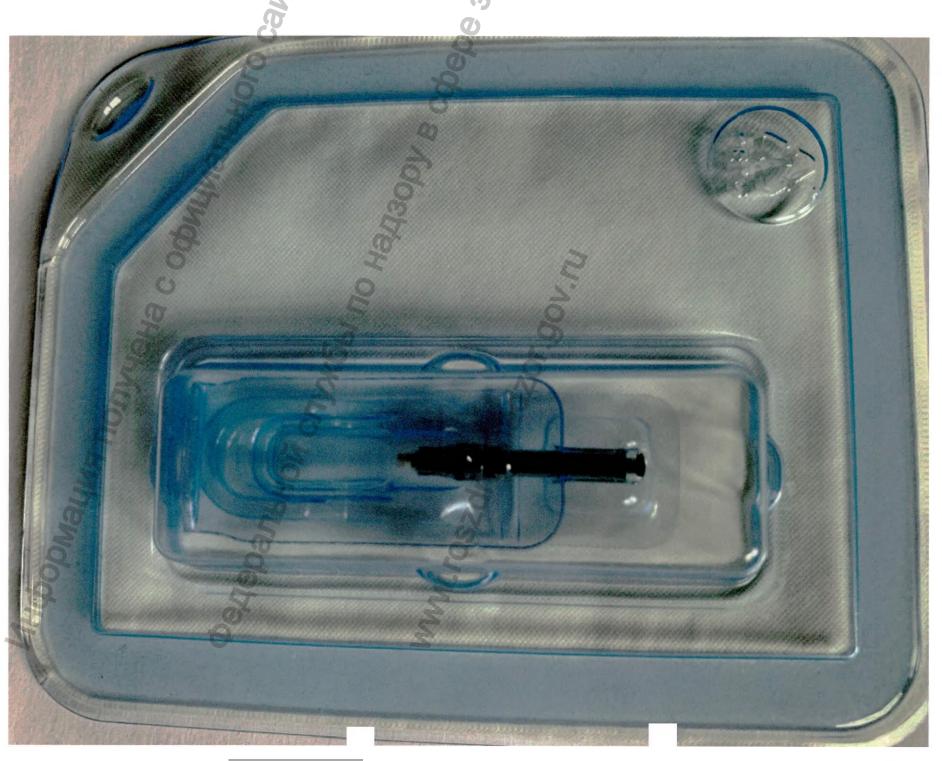

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Имплантовод EV (\$) короткий (Implant Driver EV (\$) Short)

(Implant Driver EV (S) Short

PУ № P3H 2020/10009

XXXX.XX.XX TO

REF 68015188

м см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Тел

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87


ifu.denlaplysirona.com







Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

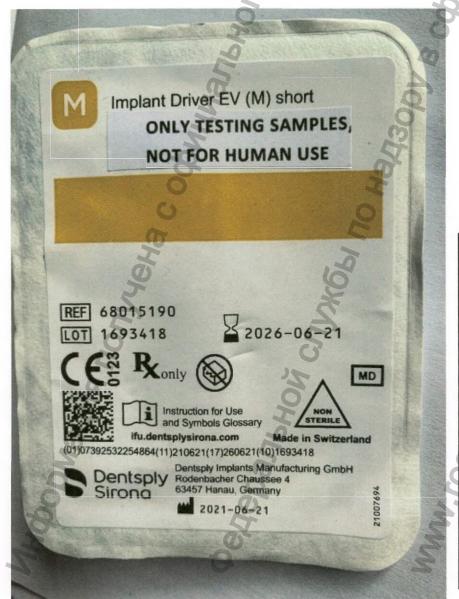

Имплантовод EV (M) короткий (Implant Driver EV (M) Short)

(Implant Driver EV (M) Short

PY № P3H 2020/10009

XXXX.XX.XX TO

REF 68015190

См. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.denlaplysirona.com



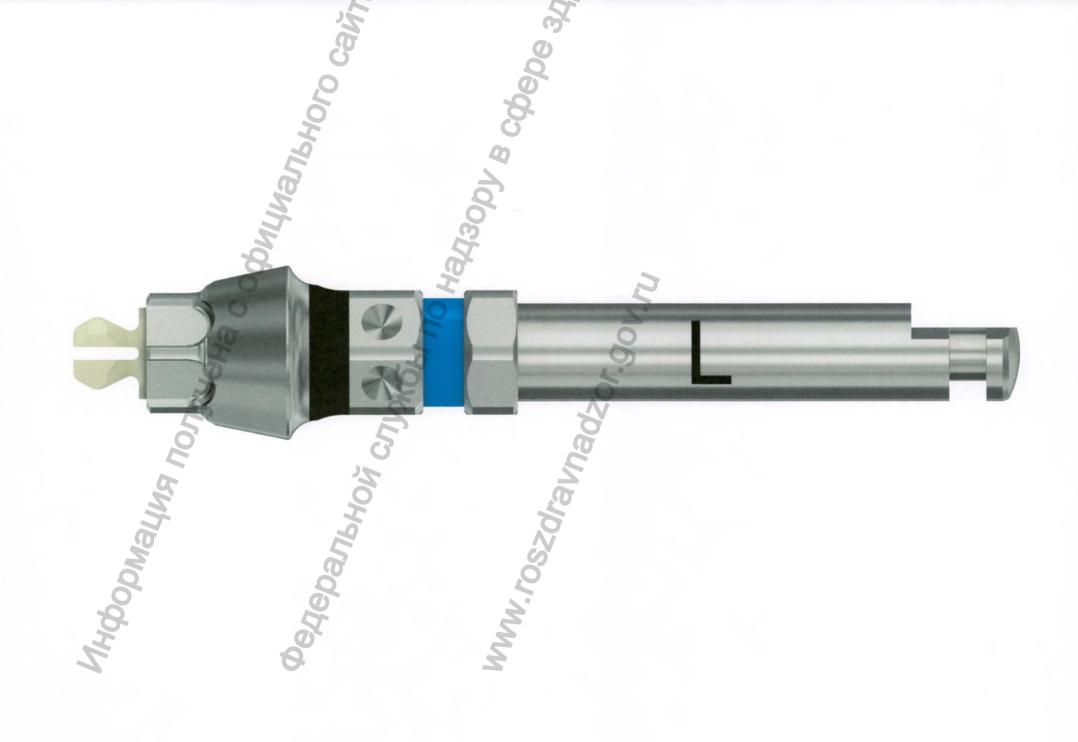





Имплантовод EV (L) короткий (Implant Driver EV (L) Short)

(Implant Driver EV (L) Short

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 68015192

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentaplysirona.com

Имплантовод Astra Tech Profile (PM) длинный (Astra Tech Implant Profile Driver (PM) Long)







Имплантовод Astra Tech Profile (PM) длинный (Astra Tech Implant Profile Driver (PM) Long)

Astra Tech Implant Profile Driver (PM) Long

PY № P3H 2020/10009

OT

REF 68015262

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3Н

Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentsplysirona.com







Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru









ifu.dentsplysirona.com



M 2020-07-01



Made in <Country>



(01)07392532002007 (11)150102

(10)123456

Astra Tech Implant System





Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Имплантовод EV-GS 4.8 (Implant Driver EV-GS Ø4.8)

Implant Driver EV-GS Ø4.8

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 26018

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противолоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau. Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Теп. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentaplysirona.com







Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



REF 26020



LOT 999999



ifu.dentsplysirona.com





Made in <Country>



2020 - 07 - 01



(01)07392532002007 (11)150102

Astra Tech Implant System





Dentsply implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Имплантовод Profile EV-GS 4.8 (Implant Driv er Profile EV-GS Ø4.8)

Implant Driver Profile EV-GS Ø4.8

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 26020



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях; см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau. Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.denlaplysirona.com





Макет маркировки и русскоязычной этикетки





Implant driver EV (M) ND GS

PY № P3H 2020/10009

OT

REF 68017002

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ:


ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3Н

Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentsplysirona.com




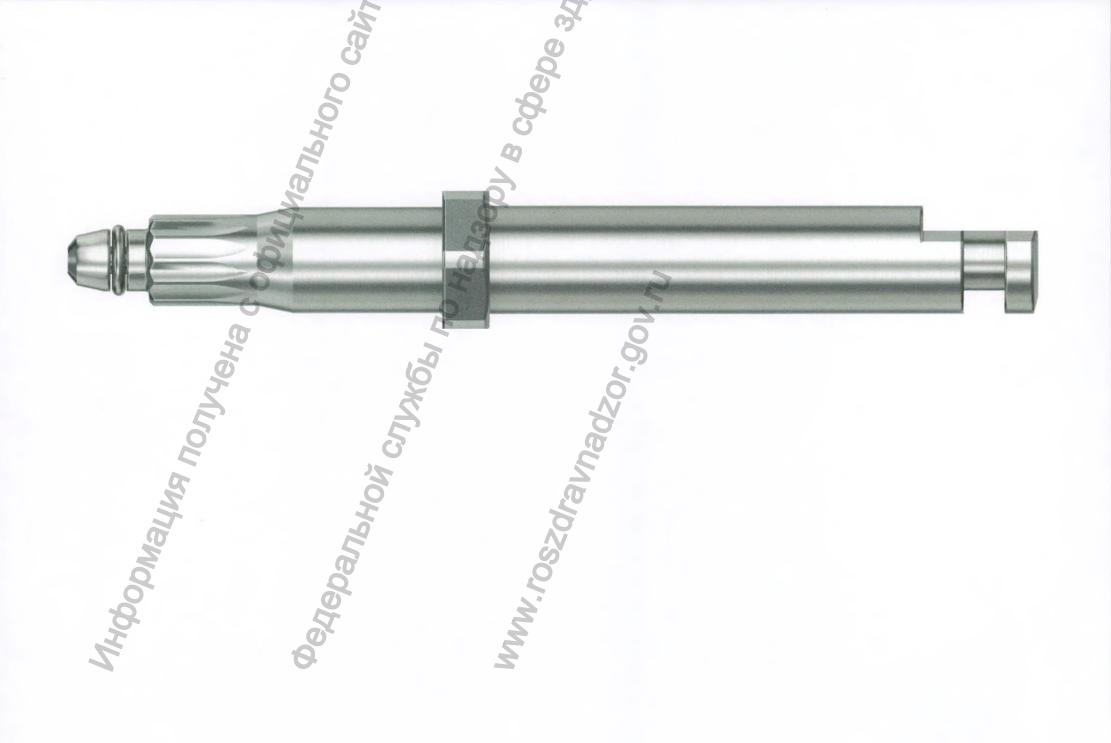



Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Uni Driver EV





NON STERULE





ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007 (11)150102

(10)123456



2020-07-01

Made in <Country>



Dentsply Sirona

Astra Tech Implant System



Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Ключ для установки абатмента Уни EV (Uni Driver EV)

Uni Driver EV

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXXX

REF 25708

m,

см. на упаковке

Только для использования врачами стомат опогами. Инф ормация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

and i

Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.denlaplysirona.com



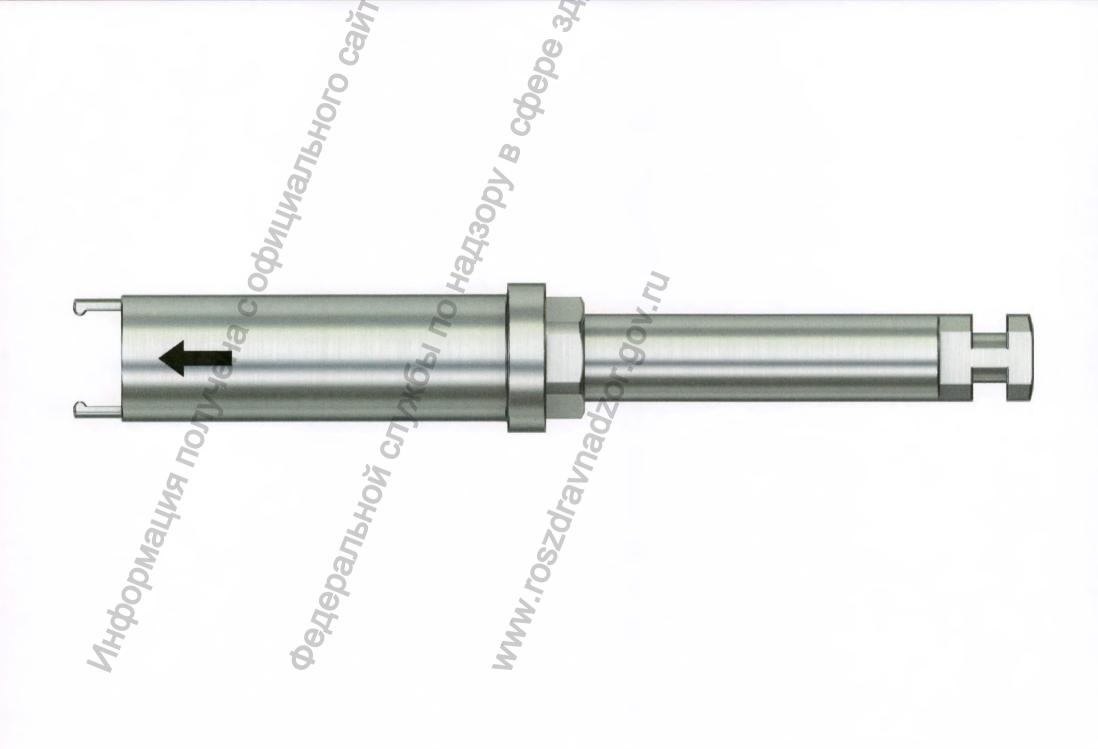

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru





LOT 999999

210029



ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007 (11)150102

(10)123456

Astra Tech Implant System



2020-07-01

Made in <Country>



Dentsply Sirona

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Ключ для установки абатмента прямого EV Ø3.3 Ø4 (Direct Driver EV Ø3.3 Ø4)

Direct Driver EV Ø3.3 Ø4

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 25764

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д.18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87





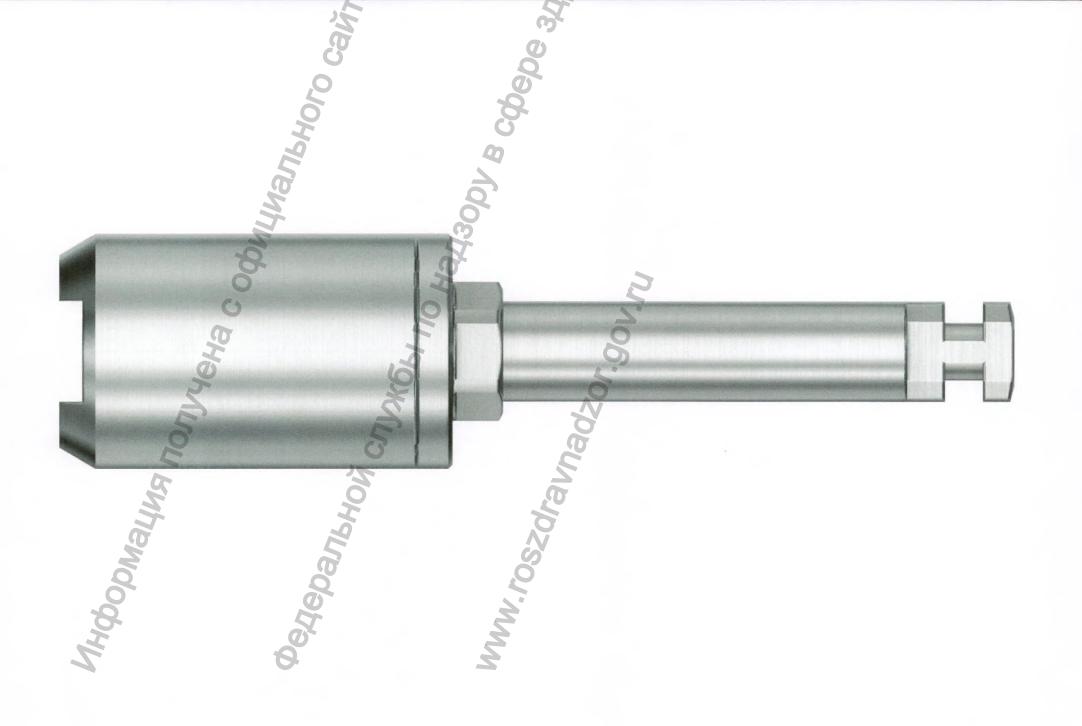











ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007

(11)150102 (10)123456



2020-07-01

Made in <Country>



Astra Tech Implant System



Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Ключ для установки абатмента шаровидного EV (Ball Abutment Driver EV)

Ball Abutment Driver EV

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 25768

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:


Dent sply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона». 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87


if a. dentaply sirona. com



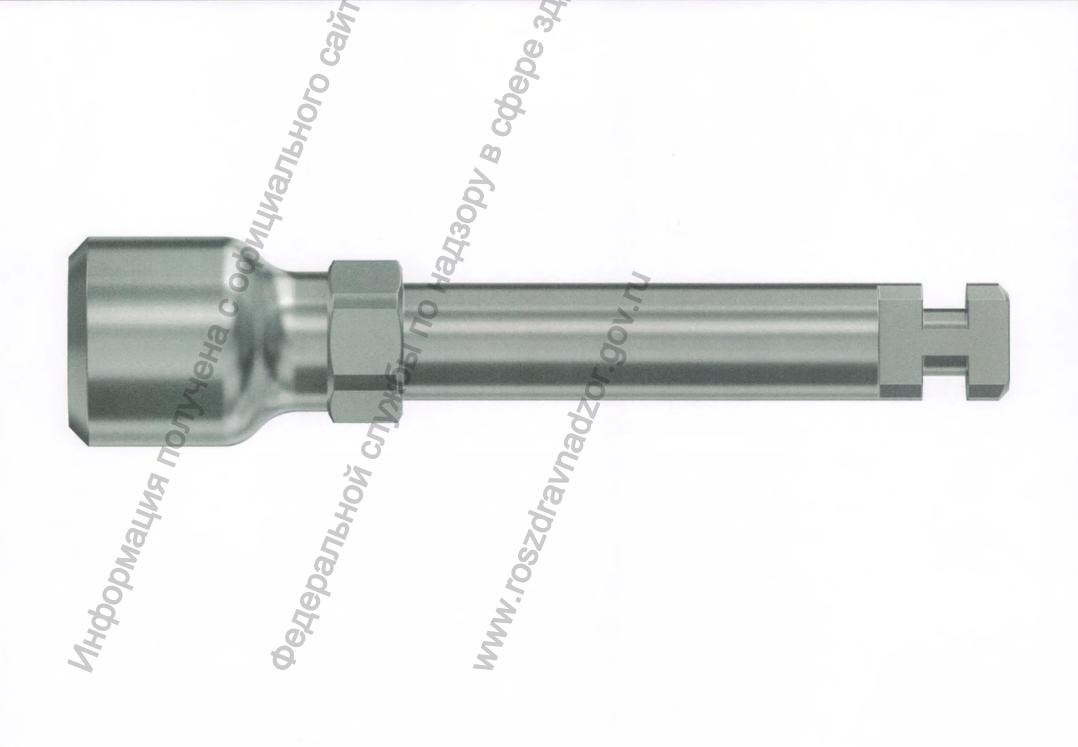



Макет маркировки и русскоязычной этикетки

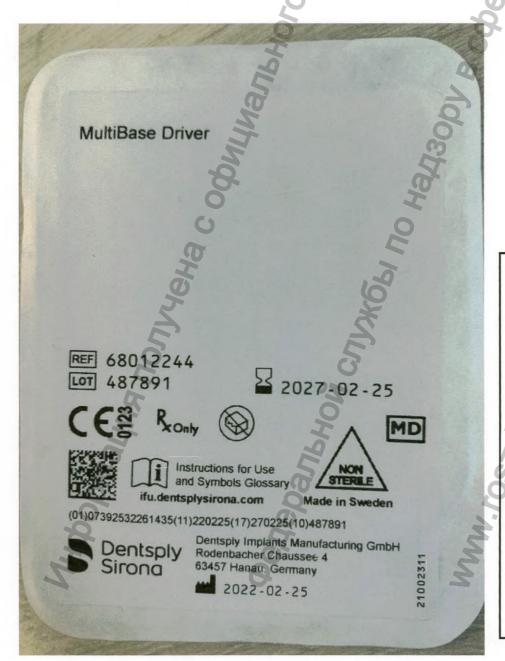

Ключ для установки абатмента MultiBase (MultiBase Driver)

MultiBase Driver

PY № P3H 2020/10009

OT

REF 68012244

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

ud.

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва,

наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3Н

Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentsplysirona.com



















Made in <Country>

(01)07392532002007(11)220701(10)123456

Astra Tech Implant System 2022-07-01

Dentsply Implants Manufacturing GmbH Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau - Germany

Глубиномер имплантата EV (Implant Depth Gauge EV)

Implant Depth Gauge EV)

PУ № P3H 2020/10009

XXXX.XX.XX TO

REF 25710

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.denfaplysirona.com





Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



















Made in <Country>

(01)07392532002007(11)220701(10)123456

Astra Tech Implant System



2022-07-01

Dentsply Implants Manufacturing GmbH Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau - Germany

Глубиномер абатмента EV 3.0/3.6 (Abutment Depth Gauge EV 3.0/3.6)

Abutment Depth Gauge EV 3.0/3.6

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXXX



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentaplysirona.com







LOT 999999












ifu.dentsplysirona.com

(01)07392532002007(11)220701(10)123456

Astra Tech Implant System



Made in <Country>



STERILE

Dentsply Implants Manufacturing GmbH Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau - Germany

Глубиномер абатмента EV 4.2/4.8 (Abutment Depth Gauge EV 4.2/4.8)

Abutment Depth Gauge EV 4.2/4.8

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXXX

REF 25793

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва. наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentaplysirona.com





Abutment Depth Gauge EV 5.4

REF 25726

LOT 999999













ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>



2022-07-01

Astra Tech Implant System Dentsply Implants Manufacturing GmbH Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau - Germany Глубиномер абатмента EV 5.4 (Abutment Depth Gauge EV 5.4)

Abutment Depth Gauge EV 5.4

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXXX

REF 25726

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

-

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

XXX

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д.18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87



if a.dentaptysirona.com















ifu.dentsplysirona.com



(01)07392532002007

(11)150102

(10)123456



2020-07-01



Dentsply Sirona

Astra Tech Implant System



Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Отвертка шестигранная механическая EV средняя, 24 мм (Hex Driver EV Machine Intermediate, 24 mm)

Hex Driver EV Machine Intermediate, 24 mm

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXXX



м см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87



Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru







Макет маркировки и русскоязычной этикетки



Отвертка шестигранная 24 мм (Hex Driver 24 mm)

Hex Driver 24 mm

PY № P3H 2020/10009

OT

REF 68015205

См. на упаковке

только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

-

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3H

Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentsplysirona.com

Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru







Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru





LOT 999999





ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>



سر 2022-07-01



(01)07392532002007

Astra Tech Implant System





Dentsply implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussea 4, 63457 Hanau - Germany Отвертка шестигранная ручная EV 20 мм (Hex Driver EV Manual 20 mm)

Hex Driver EV Manual 20 mm

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 25771



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87




ifu.denlaplysirona.com









REF 26211



M 2022-07-01

E33

ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>



(01)07392532002007 (11)150102 (10)123456

Astra Tech Implant System





Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Ример костный EV Ø 7.0 (Bone Reamer EV Ø 7.0)

Bone Reamer EV Ø 7.0

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 26211

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.denlaplysirona.com











26216 Гот 999999






MD

ifu.dentsplysirona.com



1)07392532002007 (11)220701 (10)123456

Astra Tech Implant System









Dentsply implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Направляющая для костного римера EV 5.4 (Bone Reamer Guide EV 5.4)

Bone Reamer Guide EV 5.4

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 26216

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. ЗН Ten. +7 (495) 725-10-87



ifu.dentaplysirona.com







Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Direction Indicator EV

REF 25765 LOT 999999



ifu.dentsplysirona.com

CEE Ronly Made in <Country>

M 2022-07-01



(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456

Astra Tech Implant System





Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Индикатор направления EV (Direction Indicator EV)

Direction Indicator EV

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 25765

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentaplysirona.com



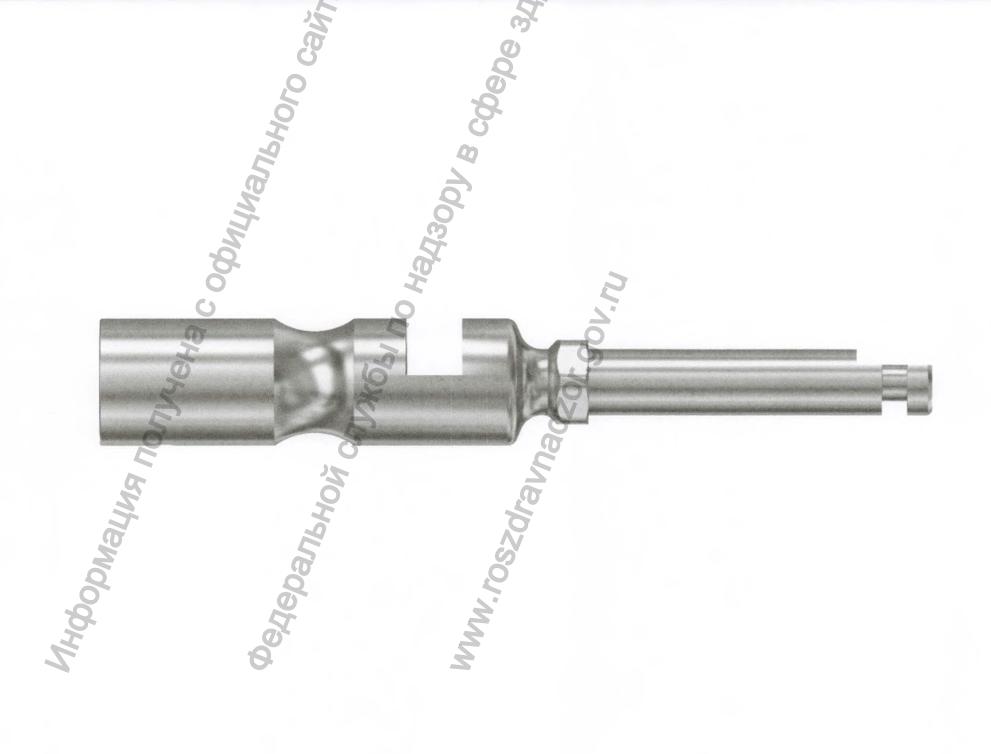



Макет маркировки и русскоязычной этикетки



Удлинитель для имплантовода (Instrument Extender)

Instrument Extender

PY № P3H 2020/10009

REF 68015197

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentsplysirona.com

Шаблон SmartFix® (SmartFix® Guide)





SmartFix® Guide





LOT 999999









2022-07-01

Dentsply Implants

Manufacturing GmbH

Rodenbacher Chaussee 4

63457 Hanau - Germany





Made in <Country>

(01)07392532002007(11)220701(10)123456





Шаблон SmartFix® (SmartFix® Guide)

SmartFix® Guide)

PY № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXXX

REF 26205

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва,

наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.denlaplysirona.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Макет маркировки и русскоязычной этикетки



Шаблон SmartFix (SmartFix Guide)

SmartEix Guide

PУ № P3H 2020/10009

OT

REF 68015235

~ CM. H

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

...

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя


Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-1<u>0-</u>87

ifu.dentsplysirona.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Шаблон рентгенологический OsseoSpeed EV (Radiographic Implant Guides OsseoSpeed EV)

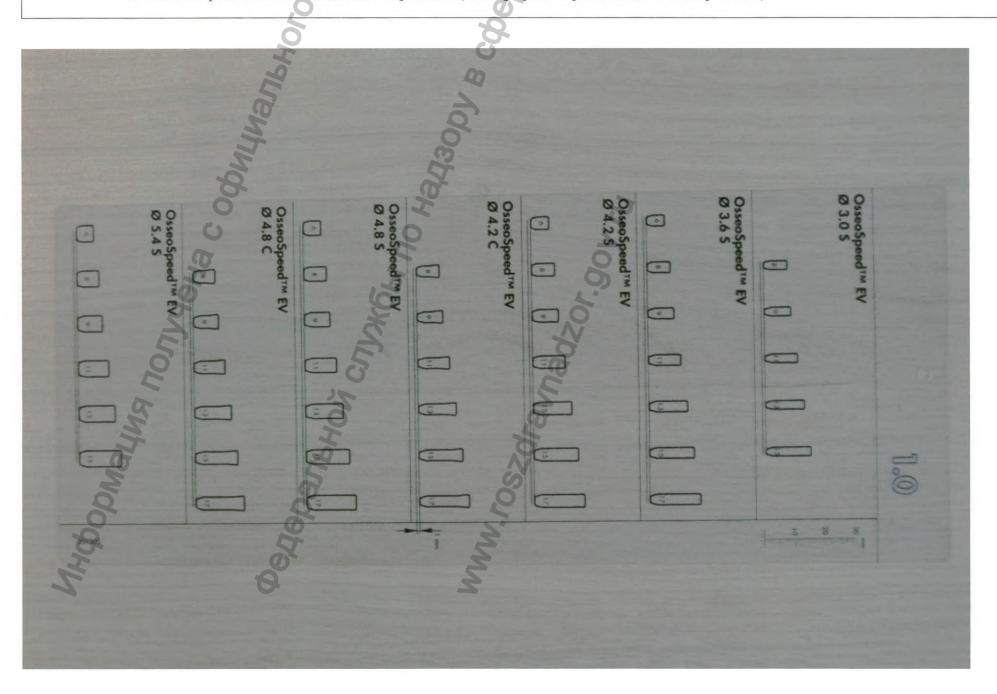



Radiographic Implant Guides OsseoSpeed™ EV

REF 25500



LOT 999999





ifu.dentsplysirona.com



Made in <Country>

M 2022-07-01



(01)07392532002007 (10)123456

Astra Tech Implant System





Dentsply implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany

Шаблон рентгенологический OsseoSpeed EV (Radiographic Implant Guides OsseoSpeedEV)

(Radiographic Implant Guides OsseoSpeed EV SmartFix® Guide)

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 25500

см. на упаковке

Уполномоченный представитель в РФ:

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:

ifu.denlaplysirona.com





Глубиномер имплантата PrimeTaper/Astra Tech (PrimeTaper/Astra Tech Impl Depth Gauge)

PrimeTaper/Astra Tech Impl Depth Gauge

PY № P3H 2020/10009

OT

REF 68015198

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

_

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя


Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва,

ооо «дентсплаи сирона», 115035, г. москва наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentsplysirona.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

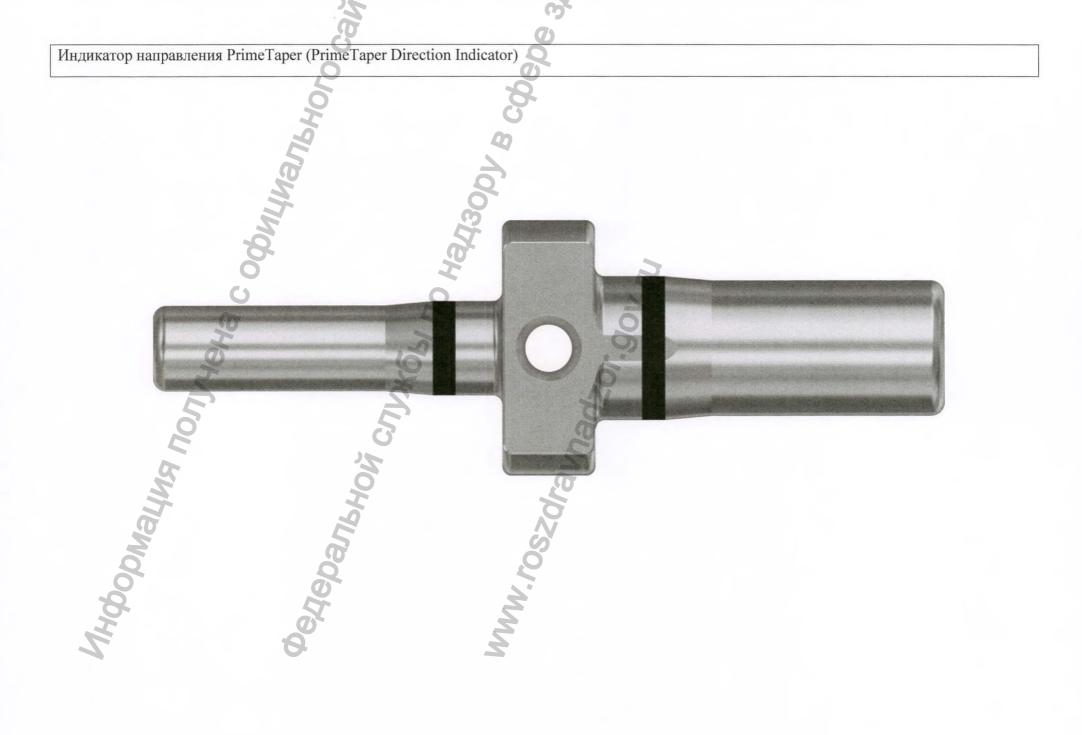





Индикатор направления PrimeTaper (PrimeTaper Direction Indicator)

Prime Taper Direction Indicator

PY № P3H 2020/10009

ОТ

REF 68015352

См. на упаковке

только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

-

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя


Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,


д. 18/1, 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87


ifu.dentsplysirona.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


















Instructions for Use and Symbols Glossary ifu.dentsplysirona.com



Made in Germany

(01)07392532255281(11)211122(17)261121(10)8210011029



Dentspiy Implants Manufacturing GmbH Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau, Germany 2021-11-22

Шаблон рентгенологический PrimeTaper (PrimeTaper Radiographic Template)

PrimeTaper Radiographic Template

PY № P3H 2020/10009

REF 68015322

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя


Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва,

наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3Н


Тел. +7 (495) 725-10-87



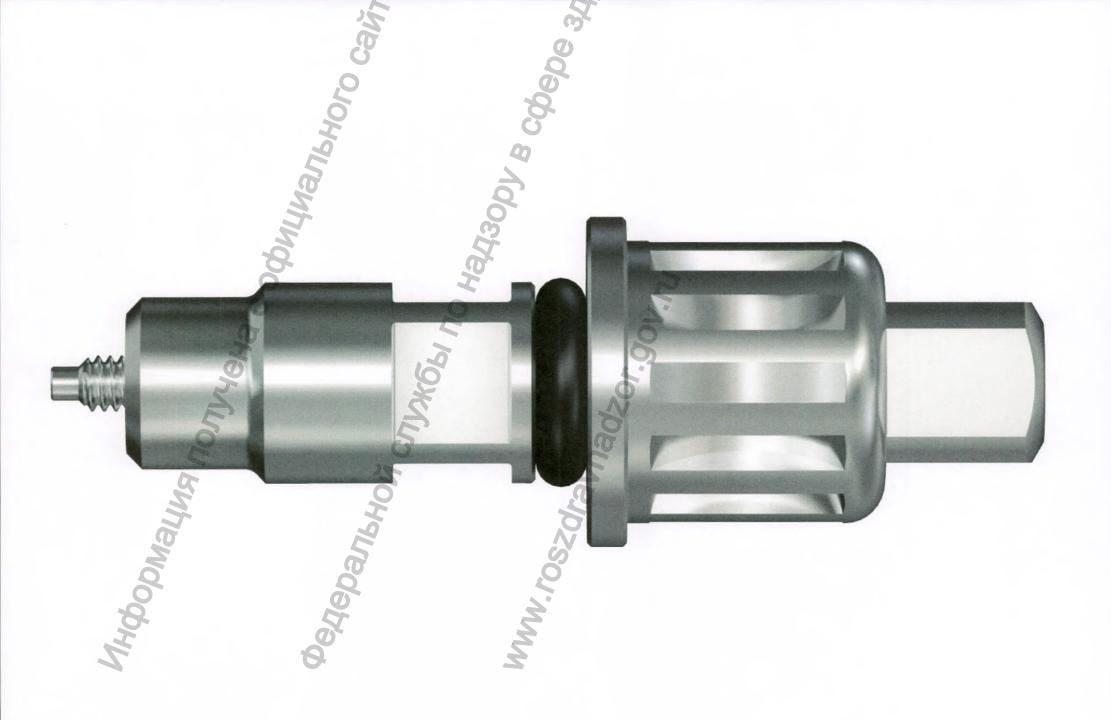



Abutment Adapter, Short









2022-07-01

21002975

(01)07392532002007

(11)220701 (10)123456











ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH. Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany

Адаптер абатмента короткий (Abutment Adapter, Short)

Abutment Adapter, Short

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 24425

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: XXX

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва. наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87








Wrench Adapter

REF 24572

21002975



(01)07392532002007 (11)220701







ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Адаптер ключа-трещотки (Wrench Adapter)

Wrench Adapter

PУ № P3H 2020/10009

REF 24572

XXXXXXXX TO

см. на упаковке

Только для использования врачами стомат опогами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях; см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:


Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87













LOT 999999

Astra Tech Implant System





2022-07-01

(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456









ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country?



Astra Tech Implant System

MON STERILE

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Глубиномер абатментов, глубина погружения 1 - 8 мм (Abutment Depth Gauge 1-8 MM)

Abutment Depth Gauge 1-8 MM)

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 24573

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dent sply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: XXX

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87













REF 25010

LOT 999999

Astra Tech Implant System







(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456









FOR INSTRUCTIONS FOR USE AND SYMBOL GLOSSARY REFER TO

Made in <Country>

ifu.dentsplysirona.com

2022-07-01

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Имплантовод 3.5/4.0 длинный (Implant Driver 3.5/4.0, Long)

Implant Driver 3.5/4.0, Long

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 25010

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматопогами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва. наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:

ifu.dentaptysirona.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru





Implant Driver Profile Long



REF 25058

LOT 999999

Astra Tech Implant System

REF 25058 LOT 999999



21002985

2022-07-01

(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456











ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>



Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Имплантовод 4.5/5.0 Profile длинный (Implant Driver 4.5/5.0 Profile, Long)

Implant Driver 4.5/5.0 Profile, Long

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 25058

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87

000 «Дентсплай Сирона»,

Уполномоченный представитель в РФ:







Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Direction Indicator 2.0/3.2 mm



LOT 999999

Astra Tech Implant System





(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456









ifu.dentsplysirona.com

Made in





Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Индикатор направления имплантатов 2.0/3.2 (Direction Indicator 2.0/3.2)

Direction Indicator 2.0/3.2

PУ № P3H 2020/10009

REF 22434

XXXXXXXX TO

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва. наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87









Макет маркировки и русскоязычной этикетки

Implant Depth Gauge 6-19 mm



REF 24801

LOT 999999

Astra Tech Implant System





9999

2022-07-01

(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456









ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>



Astra Tech Implant System Manufacturing GmbH,

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Глубиномер имплантатов, глубина погружения 6 - 19 мм (Implant Depth Gauge 6 - 19 mm)

Implant Depth Gauge 6 - 19 mm

PУ № P3H 2020/10009

XXXXX.XX TO

REF 24801



см. на упаковке

Только для использования врачами стоматопогами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87



ifu.denlaplysirona.com

Pегистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru





Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Removal Tool M1.4, Long

24037

Astra Tech Implant System

21002975

(01)07392532002007

(11)220701













ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Инструмент для извлечения абатмента Уни М1.4 длинный (Removal Tool M1.4, Long)

Removal Tool M1.4, Long

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXXX

REF 24037

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: XXX

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035. г. Москва. наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. ЗН Тел. +7 (495) 725-10-87



Ключ шаровидного абатмента (Ball Wrench)





Макет маркировки и русскоязычной этикетки



Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany

Ключ шаровидного абатмента (Ball Wrench)

Ball Wrench

PУ № P3H 2020/10009

мГ.

XXXXXXXX TO

REF 24367

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противолоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

44

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: ххх

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87



Ключ шестигранный для удаления абатментов (Wrench)



Макет маркировки и русскоязычной этикетки



Ключ ш естигранный для удаления абатментов (Wrench)

Wrench

PУ № P3H 2020/10009

REF 22124

OT XX.XX.XXX

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: ххх

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87









Ratchet Wrench

REF 24357

LOT 999999

Astra Tech Implant System

 \overline{M}

2022-07-01

21002975

(01)07392532002007

(11)220701









Ronly



Made in <Country>

Astra Wech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Ключ-трещотка для имплантатов (Ratchet Wrench)

Ratchet Wrench

PУ № P3H 2020/10009

XXXXX.XX TO

REF 24357

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противолоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: xxx Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87







Отвёртка шестигранная для ключа-трещотки динамометрического длинная (T.W Bit Hex, Long)

T.W Bit Hex, Long

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 24094

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: XXX

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



Отвёртка шестигранная для наконечника длинная (Hex CA Driver, Long)




Hex CA Driver Long, 35 mm





LOT 999999

Astra Tech Implant System




LOT 999999



Date of manufacture 2017-10-01





(01)0739253200200











ifu.dentsplysirona.com



Made in

Astra Tech Impiant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Отвёртка шестигранная для наконечника длинная (Hex CA Driver, Long)

Hex CA Driver, Long

PУ № P3H 2020/10009

XXXX.XX.XX TO

REF 22549

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87



Отвёртка шестигранная короткая (Hex Screwdriver, Short)





REF 22514

LOT 999999

Astra Tech Implant System

21002975

2022-07-0

(01)07392532002007







ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>

Astraciech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Отвёртка шестигранная короткая (Hex Screwdriver, Short)

Hex Screwdriver, Short

PУ № P3H 2020/10009

REF 22514

XXXXXXXX TO

См. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: xxx Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87







Driver Handle



REF 24358

LOT 999999

Astra Tech Implant System

REF 24358



LOT 999999



2022-07-01


(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456











HON

Made in <Country



Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Рукоятка для отвёртки (Driver Handle)

Driver Handle

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 24358

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

-

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87





Макет маркировки и русскоязычной этикетки



Astra Tech Implant System

21002975

2022-07-01

(01)07392532002007

(11)220701 (10)123456







ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Трансфер для абатмента прямого, диаметр 4 мм (DA 4 Metal Carrier)

DA 4 Metal Carrier

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX

REF 22850

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: XXX

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Ten. +7 (495) 725-10-87











REF 22520

Lот 999999

Astra Tech Implant System

LOT 999999



<Country

(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456









ifu.dentsplysirona.com

Made in





STERULE

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Удлинитель фрезы (Drill Extension)

Drill Extension

PУ № P3H 2020/10009

XXXXXXXX TO

REF 22520

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau. Германия


Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:

ifu.denlaplysirona.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

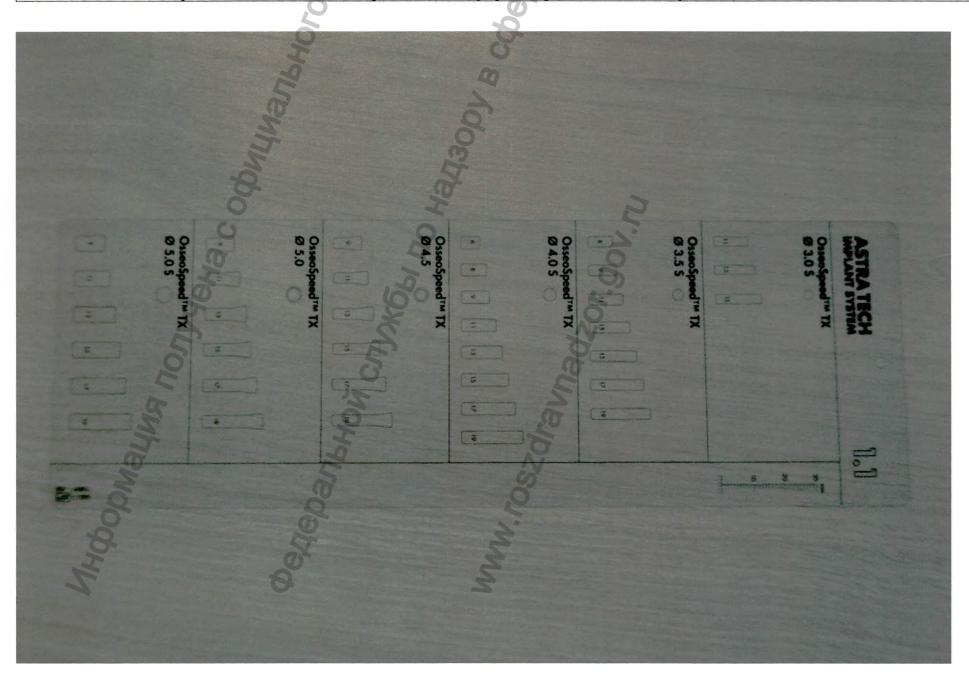

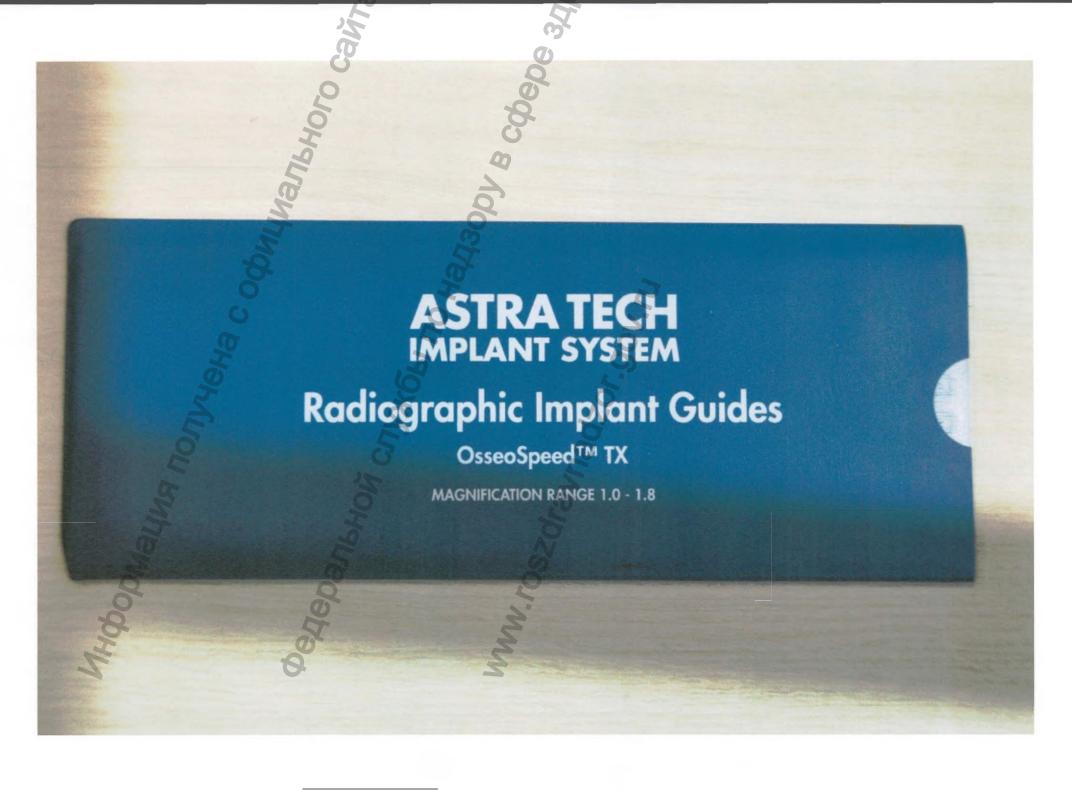



Radiographic Implant Guides OsseoSpeed™ TX



24892 [LOТ 999999





ifu.dentsplysirona.com



M 2022-07-01



(01)07392532002007 (11)220701 (10)123456

Astra Tech Implant System





Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany

Шаблон имплантатов рентгенопогический OsseoSpeed TX (Radiographic Implant Guides OsseoSpeed TX)

Radiographic Implant Guides OsseoSpeed TX

PУ № P3H 2020/10009

XXXX.XX.XX TO

REF 24892



Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта




Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия


Страна происхождения:

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона». 115035, г. Москва. наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Ten. +7 (495) 725-10-87



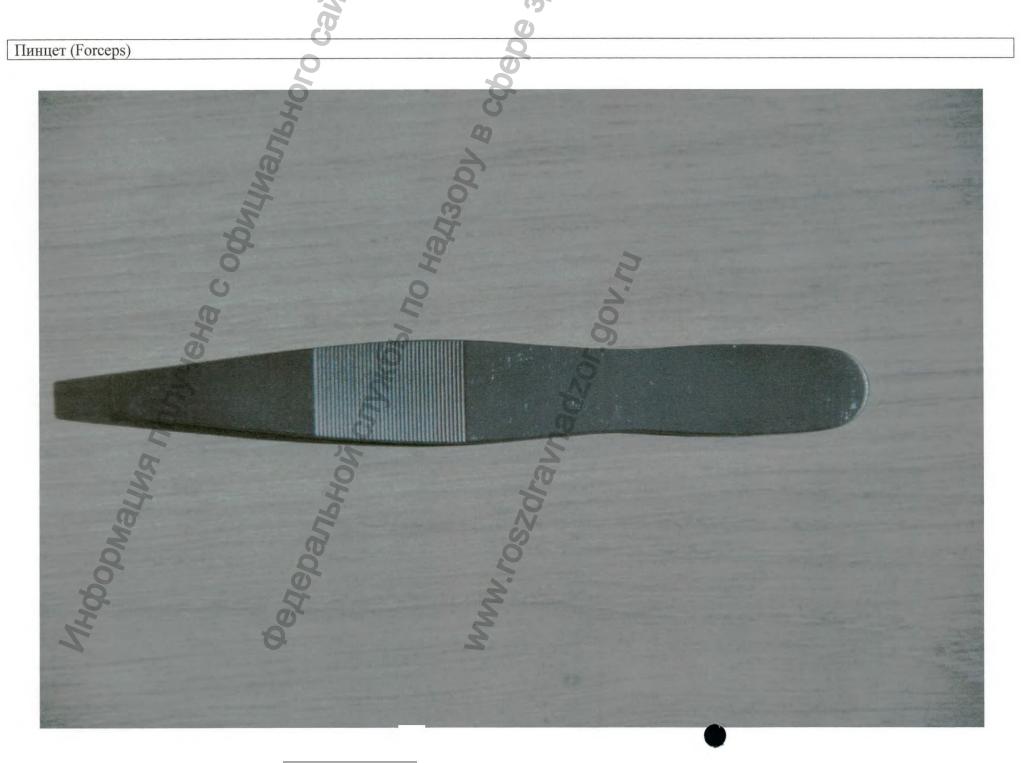





REF 22437 LOT 999999

Astra Tech Implant System

 $\overline{\mathbf{M}}$

2022-07-01

21002975

(01)07392532002007









Ronly



Made in <Country>

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Пинцет (Forceps)

Forceps

PУ № P3H 2020/10009

REF 22437

XXXXXXX TO

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматопогами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: ххх

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87





Регистрация МИ в Росздравнадзоре www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



22137

999999

Implant System

21002975

(01)07392532002007

(11)220701 (10)123456







ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Чаша титановая (Bowl Titanium)

Bowl Titanium

PУ № P3H 2020/10009

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

XXXXXXXX TO

см. на упаковке

REF 22137

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: XXX

Уполномоченный представитель в РФ: 000 «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87







Implant Retriever

REF 22192 LOT 999999

Astra Tech Implant System

М

2022-07-01

21002975

(01)07392532002007 (11)220701

(11)220701 (10)123456







Ronly



Made in <Country>

Astra Tech Implant System

and

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Harau - Germany Извлекатель имплантатов (Implant Retriever)

Implant Retriever

PУ № P3H 2020/10009

XXXXX.XXX TO

REF 22192

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

M

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: xxx Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87







Uni Abutment Retriever

REF 22429

LOT 999999

Astra Tech Implant System



2022-07-01

21002975

(01)07392532002007 (11)220701

(10)123456













ifu.dentsplysirona.com

Made in <Country>

Astra Tech Implant System

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau - Germany Извлекатель резьбовой абатмента Уни (UniAbutment Retriever)

UniA butment Retriever

PУ № P3H 2020/10009

OT XX.XX.XXX





см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: ххх

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, стр. 2, помещ. 3H Тел. +7 (495) 725-10-87







Глубиномер имплантата PrimeTaper/Astra Tech (PrimeTaper/Astra Tech Impl Depth Gauge)

PrimeTaper/Astra Tech Impl Depth Gauge

PY № P3H 2020/10009

OT

REF 68015198

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.




Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская, д. 18/1, 2, помещ. 3Н

Тел. +7 (495) 725-10-87

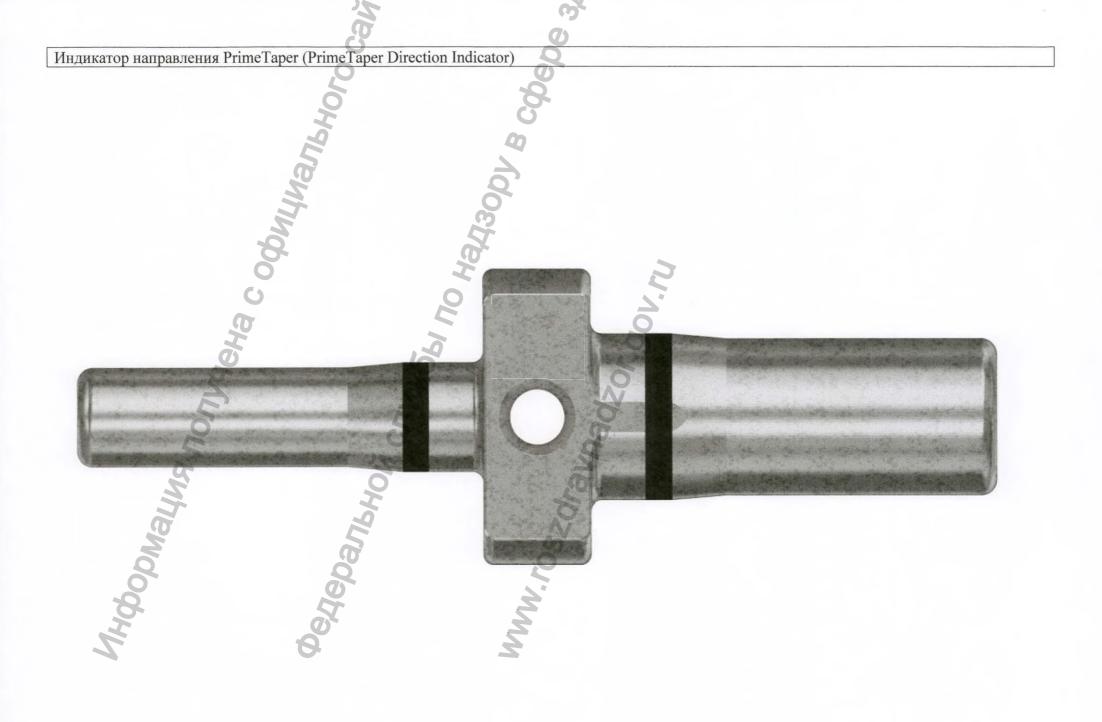





Индикатор направления PrimeTaper (PrimeTaper Direction Indicator)

PrimeTaper Direction Indicator

PУ № P3H 2020/10009

REF 68015352

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3Н Тел. +7 (495) 725-10-87



Rodenbacher Chaussee 4

2021-11-22

63457 Hanau, Germany

Dentsply

Sirona

Шаблон рентгенологический PrimeTaper (PrimeTaper Radiographic Template)

PrimeTaper Radiographic Template

PY № P3H 2020/10009

REF 68015322

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции. Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия

Страна происхождения: хххя

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115035, г. Москва, наб. Овчинниковская,

д. 18/1, 2, помещ. 3Н

Тел. +7 (495) 725-10-87

ifu.dentsplysirona.com

21002311

