

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор

ООО «Нейропроджект»

Д.М. Чебурашкин

«2» июня 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:


Монитор CereLink® для измерения внутричерепного давления

Производства Интегра ЛайфСайнсиз Продакшн Корпорейшн (Integra LifeSciences Production Corporation), США

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.gov.ru


2022

Монитор CereLink® для измерения внутричерепного давления в транспортной упаковке.

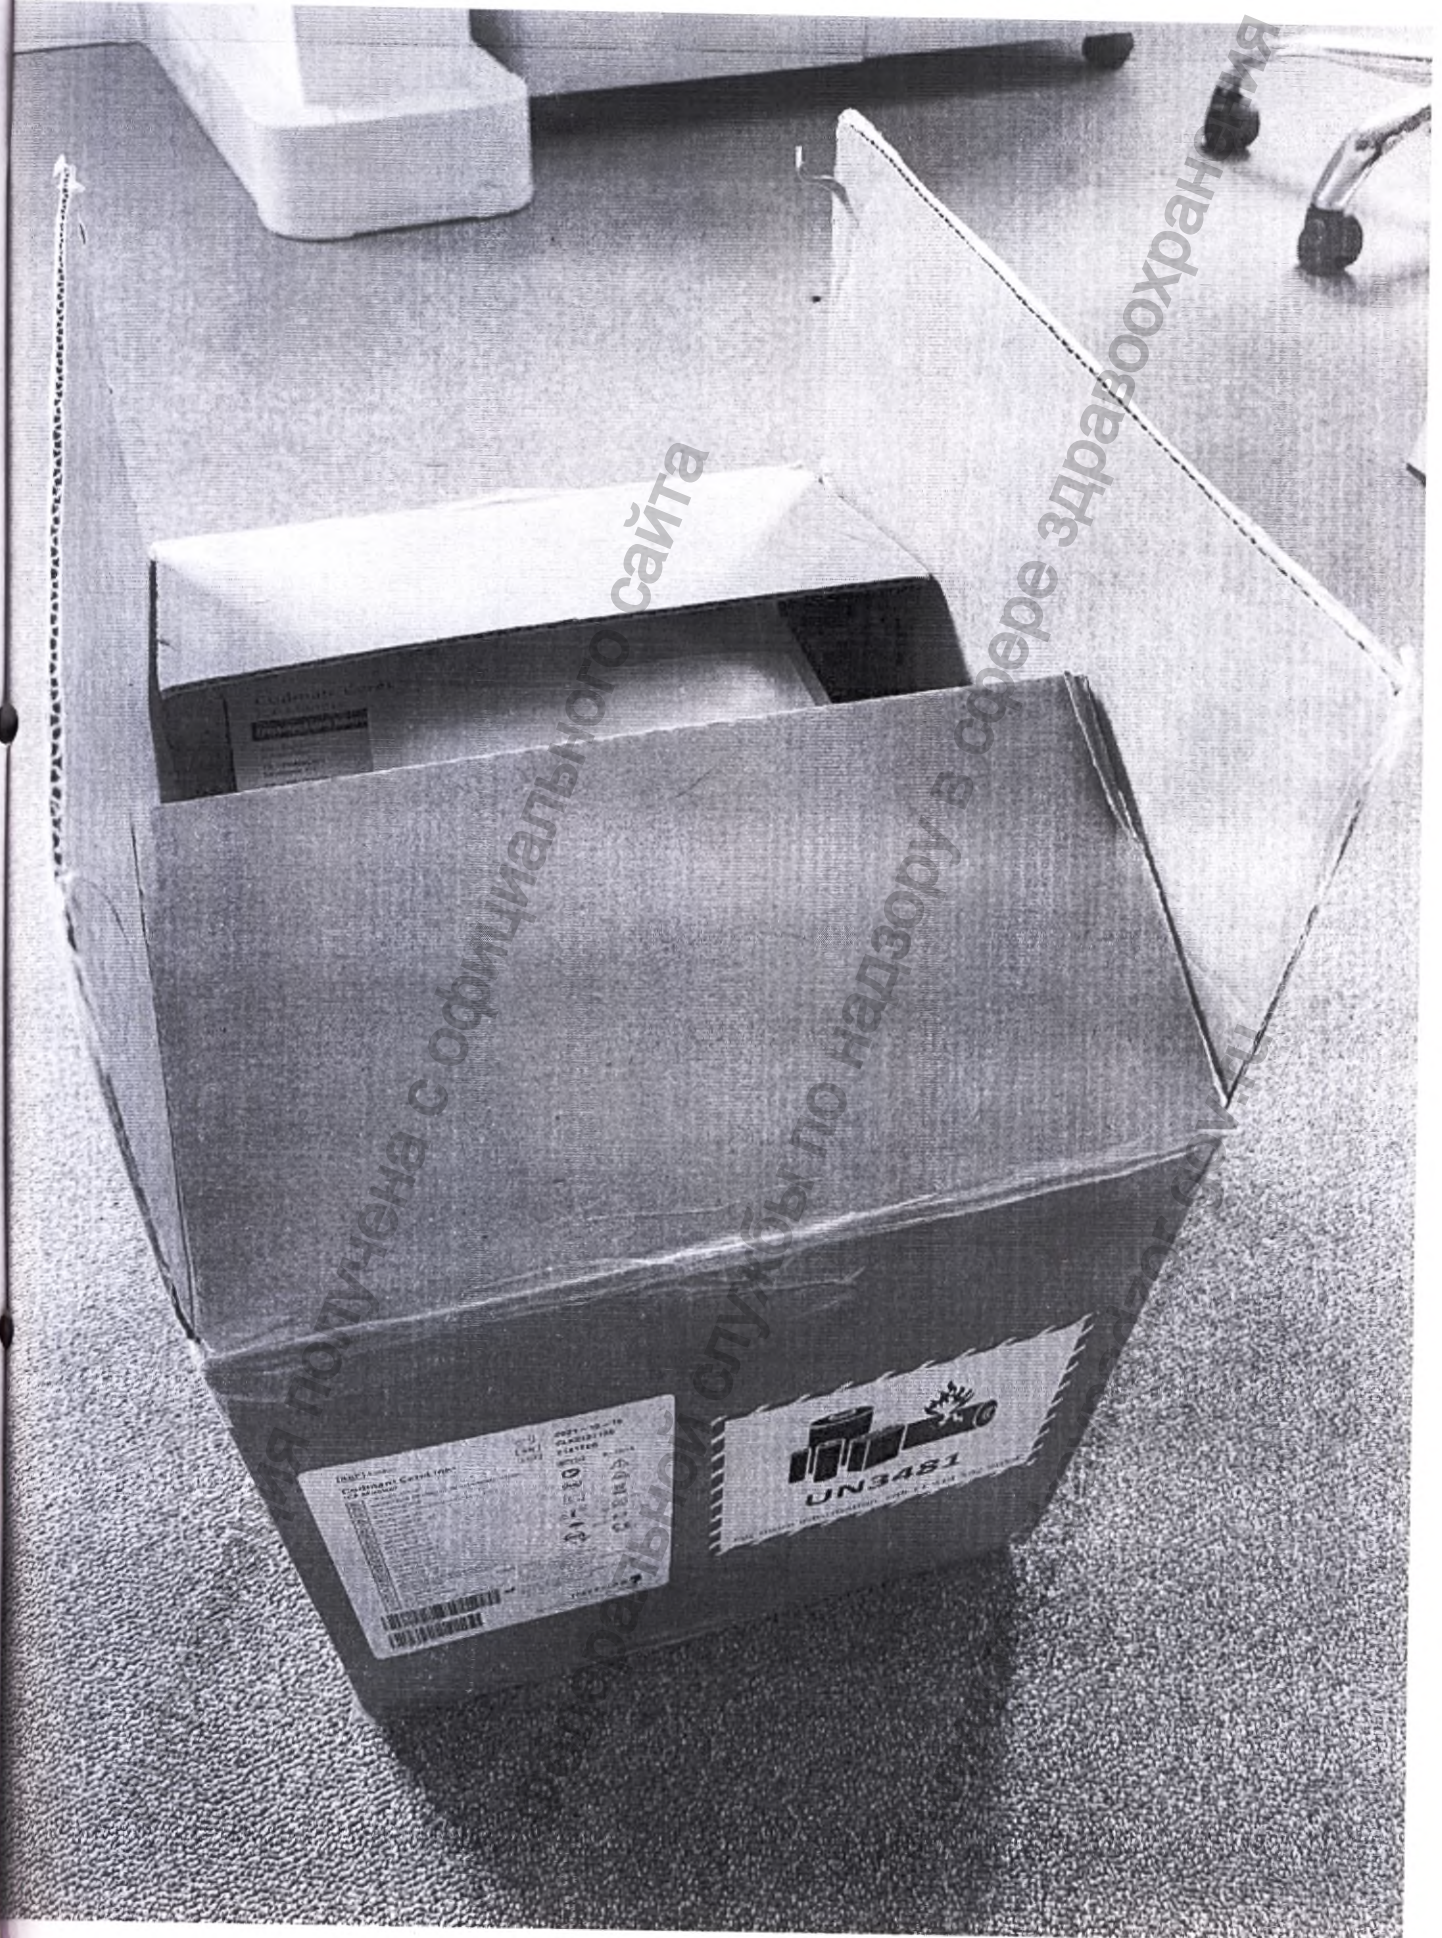



Монитор CereLink® для измерения внутричерепного давления, вид сбоку.

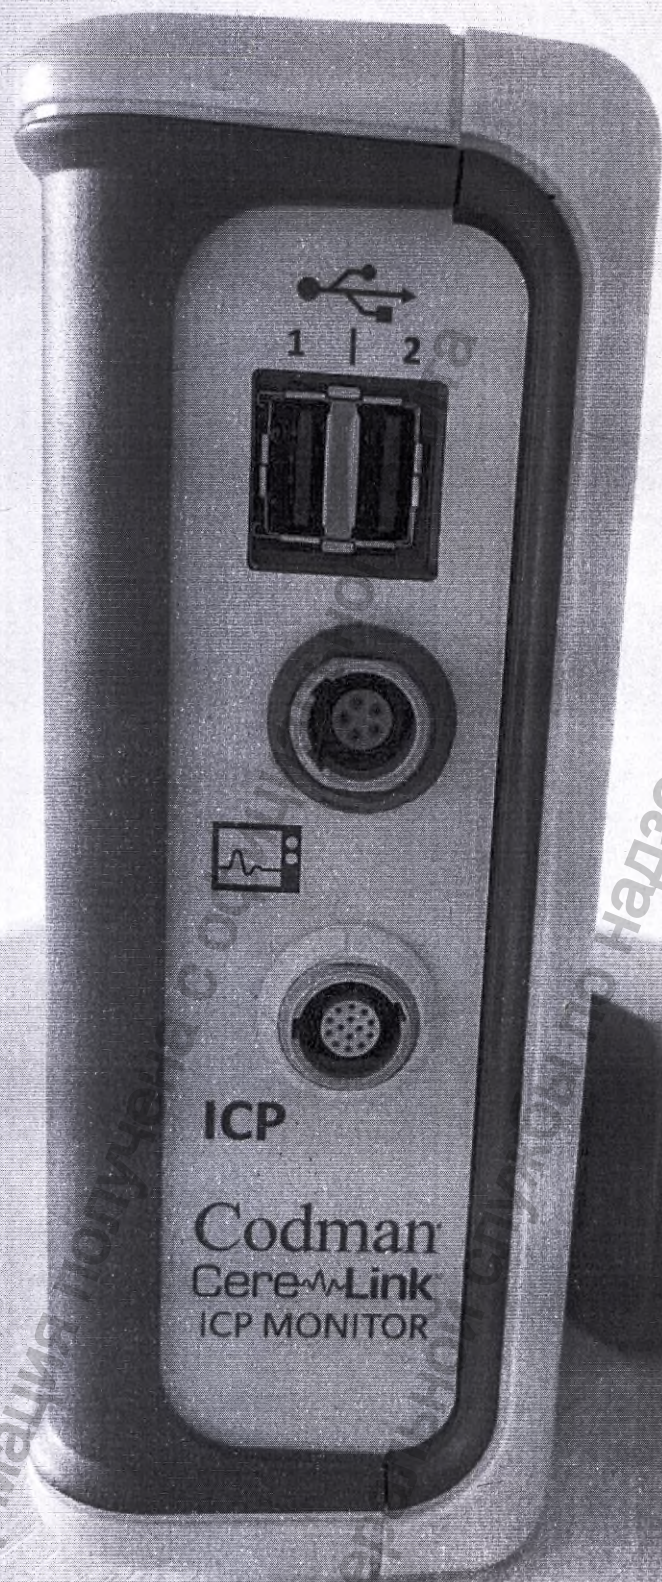


Информация
Получена
в
Федеральном
Центре
по
надзору
в
сфере
здравоохранения
www.fscs.gov.ru

Монитор CereLink® для измерения внутричерепного давления, лицевая панель.




Монитор CereLink® для измерения внутричерепного давления, задняя панель.

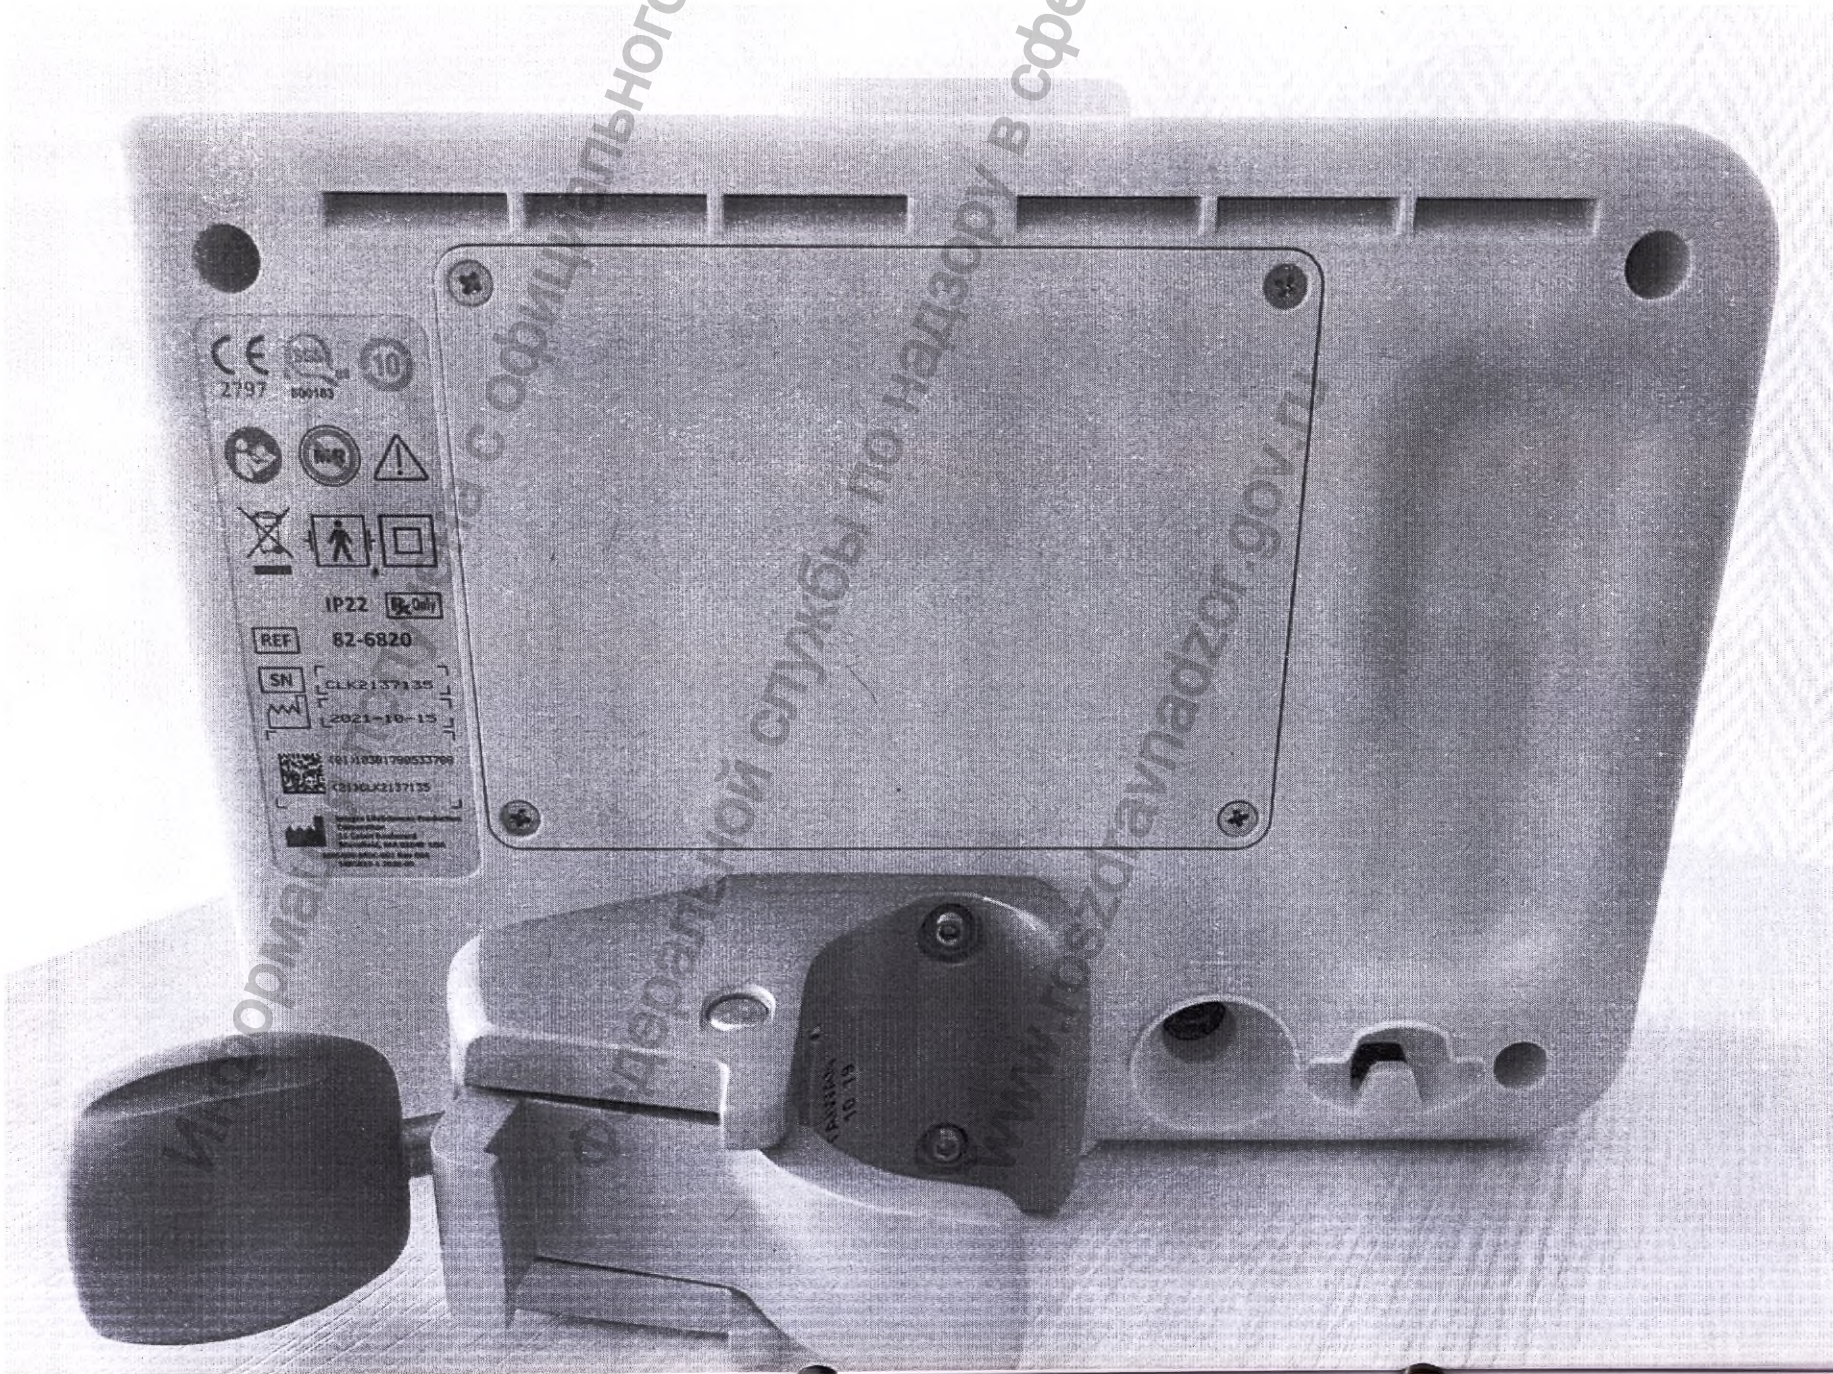

CE 2797 100183
IP22
REF 82-6820
SN CLK2137135
2021-10-15
101118381790533788
C0196LK2137135
CereLink
22 Canal
www.nevacert.ru

менный блок питания, в индивидуальной упаковке.

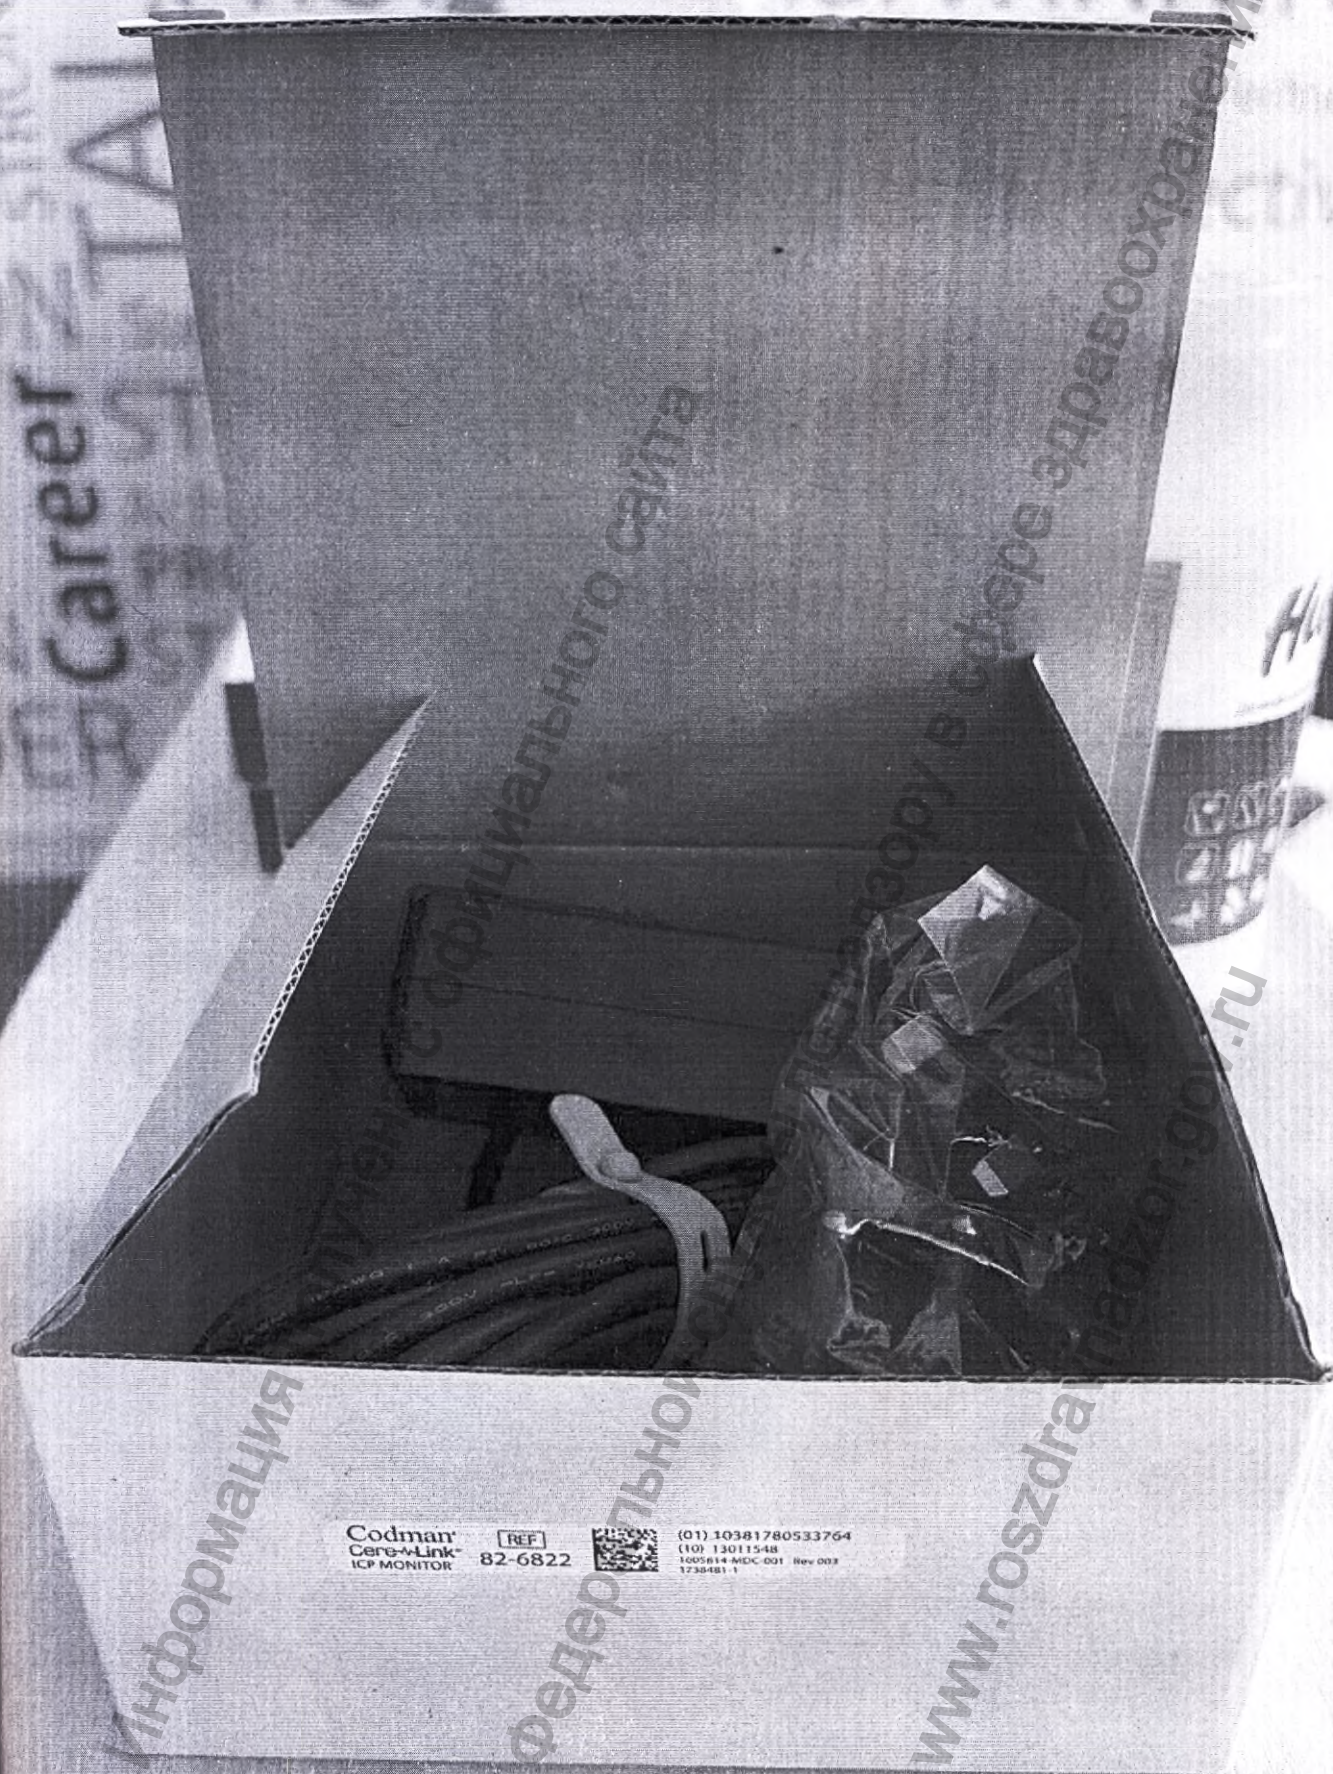

Codman
Cere-Link
ICP MONITOR

REF 82-6822



(01) 10381780533764
(10) 13011548
1007514-MDC-001 Rev 003
1738481-1

менный блок питания, в собранном виде с кабелем с вилкой стандарта США.



Информация
Федеральное агентство по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdram.ru

длинительный кабель, в первичной упаковке, лицевая сторона.




длинительный кабель, в первичной упаковке, обратная сторона.

Codman

©2019 Integra LifeSciences Corporation

REF 82 6845

 2021 02-03


CE

LOT 5261899

QTY 1

CereLink™
ICP Extension Cable

Rallonge de PIC
ICP Verlängerungskabel
ICP-verlängerkabel
Cavo prolunga ICP (pressione intracranica)
Cable de extensión ICP
Cabo de extensão de PIC
ICP-förlängarledning
Förlängningskabel ICP
ICP-jatkokaapeli
Καλώδιο επέκτασης ενδοκρανιακής πίεσης (ICP)
ICP hosszabbító kábel

 Integra LifeSciences Production Corporation
11 Cabot Boulevard
Mansfield, MA 02048 USA

EC REP Integra LifeSciences Services (France)
Immeuble Séquoia 2
97 Allée Alexandre Borodine
Parc Technologique de la Porte des Alpes
69800 Saint Priest - France

MADE IN China

U.S. Patent www.integralife.com/patentmarking



(01)10381780520665




(10)5261899



REV. E

REGISTRATION DE INTEGRALIFE LIFE SCIENCES

длинный кабель, без упаковки.

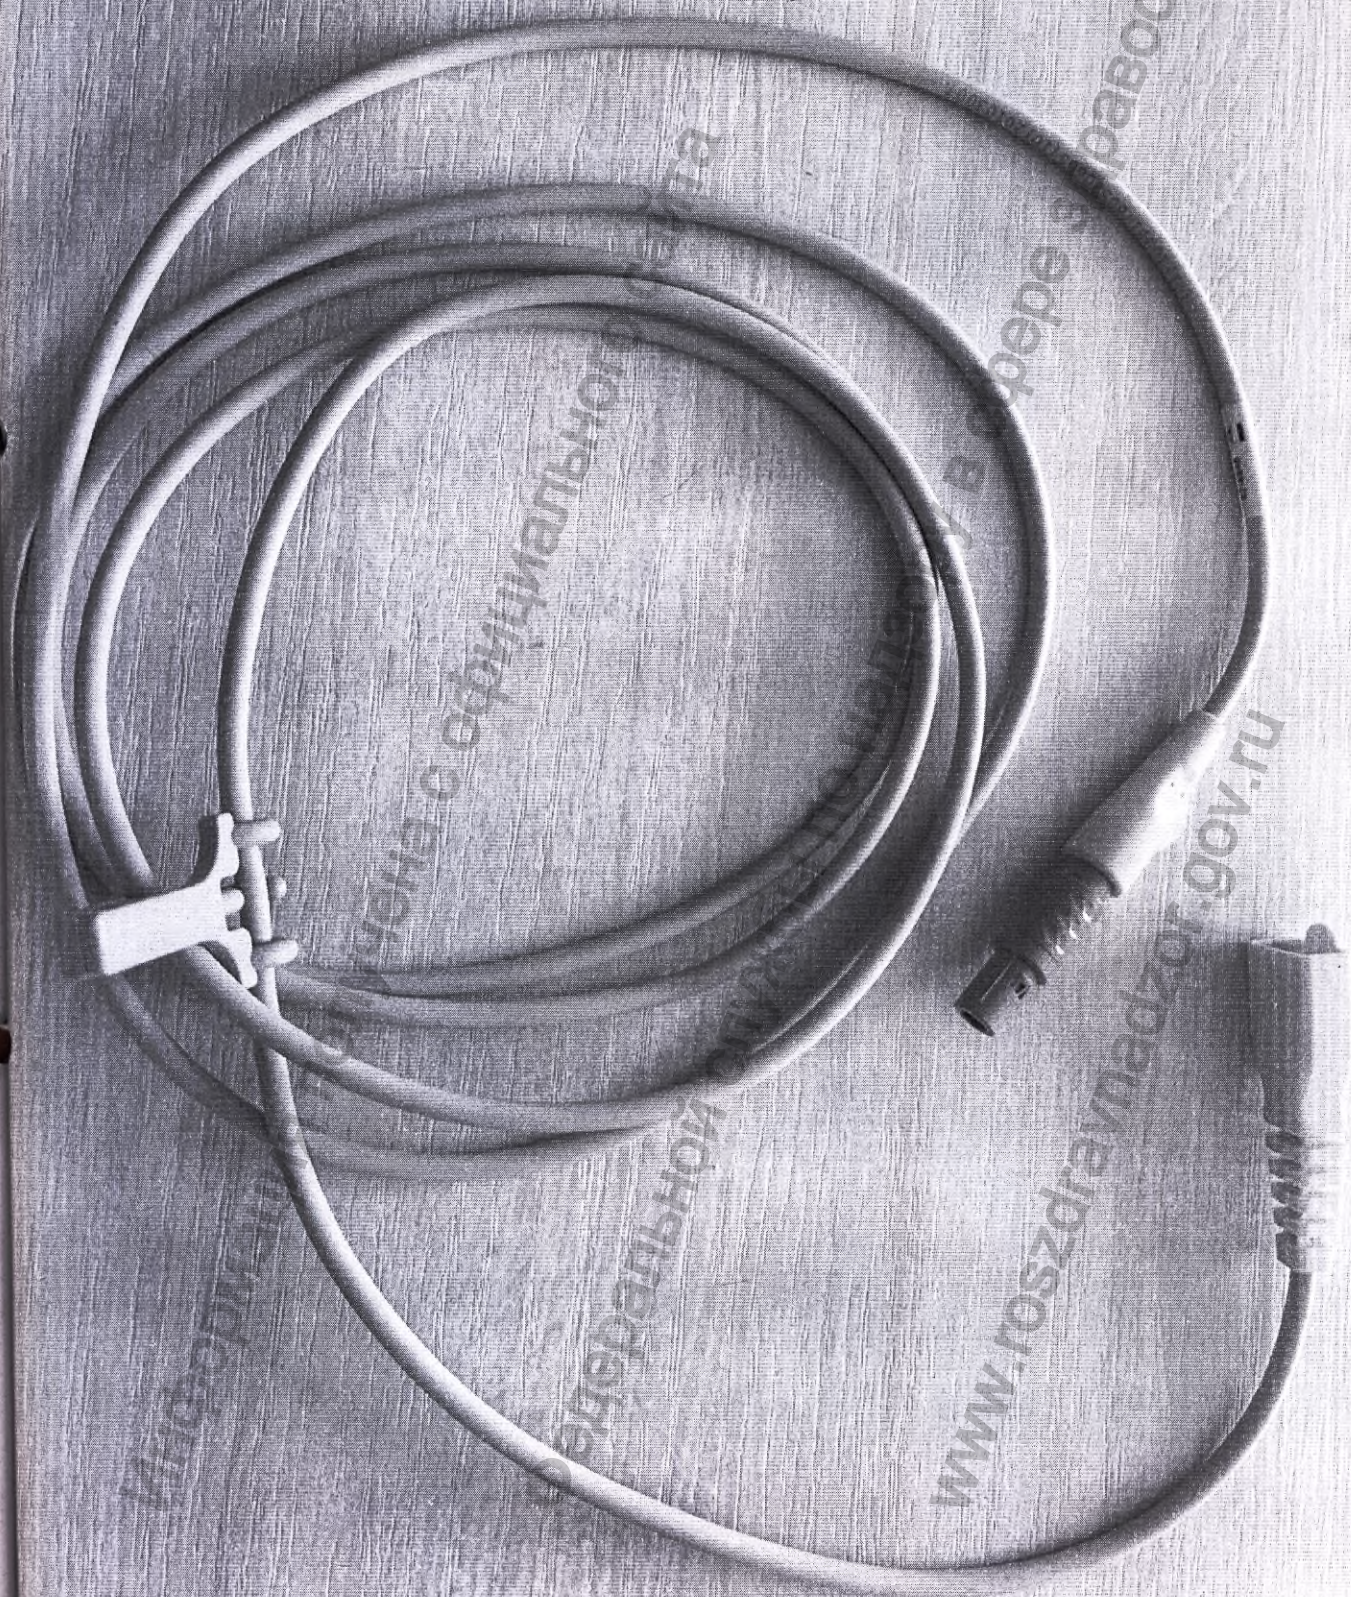

Батарея.




Информация

Учтена с официальной печатью

Федеральной службы

www.roszdrnadzor.gov.ru

Codman®
CereLink ICP MONITOR
 UN38.3 Registered
 IEC62133-2:2017 Registered

REF		(01)10381780533771
82-6824		(10)2019004
		1005613-MDC-001 REV 003
		1709003-1 2020-10

Karyon Electronics Production
 81 Karyon Building
 100000-4000-001 8th St
 100000-1 2020-08


(21) CLK2137135



<01>103817805337788



[2021-10-15]

CLK2137135

REF 82-6820

IP22 


2797 800153

SCS 10

CE

Батарея, установленная в монитор.

Комплект USB-адаптера, в составе: коннектор (1 шт.), кабель (1 шт.), диск (1 шт.), инструкция по эксплуатации (1 шт.) – индивидуальной упаковке.

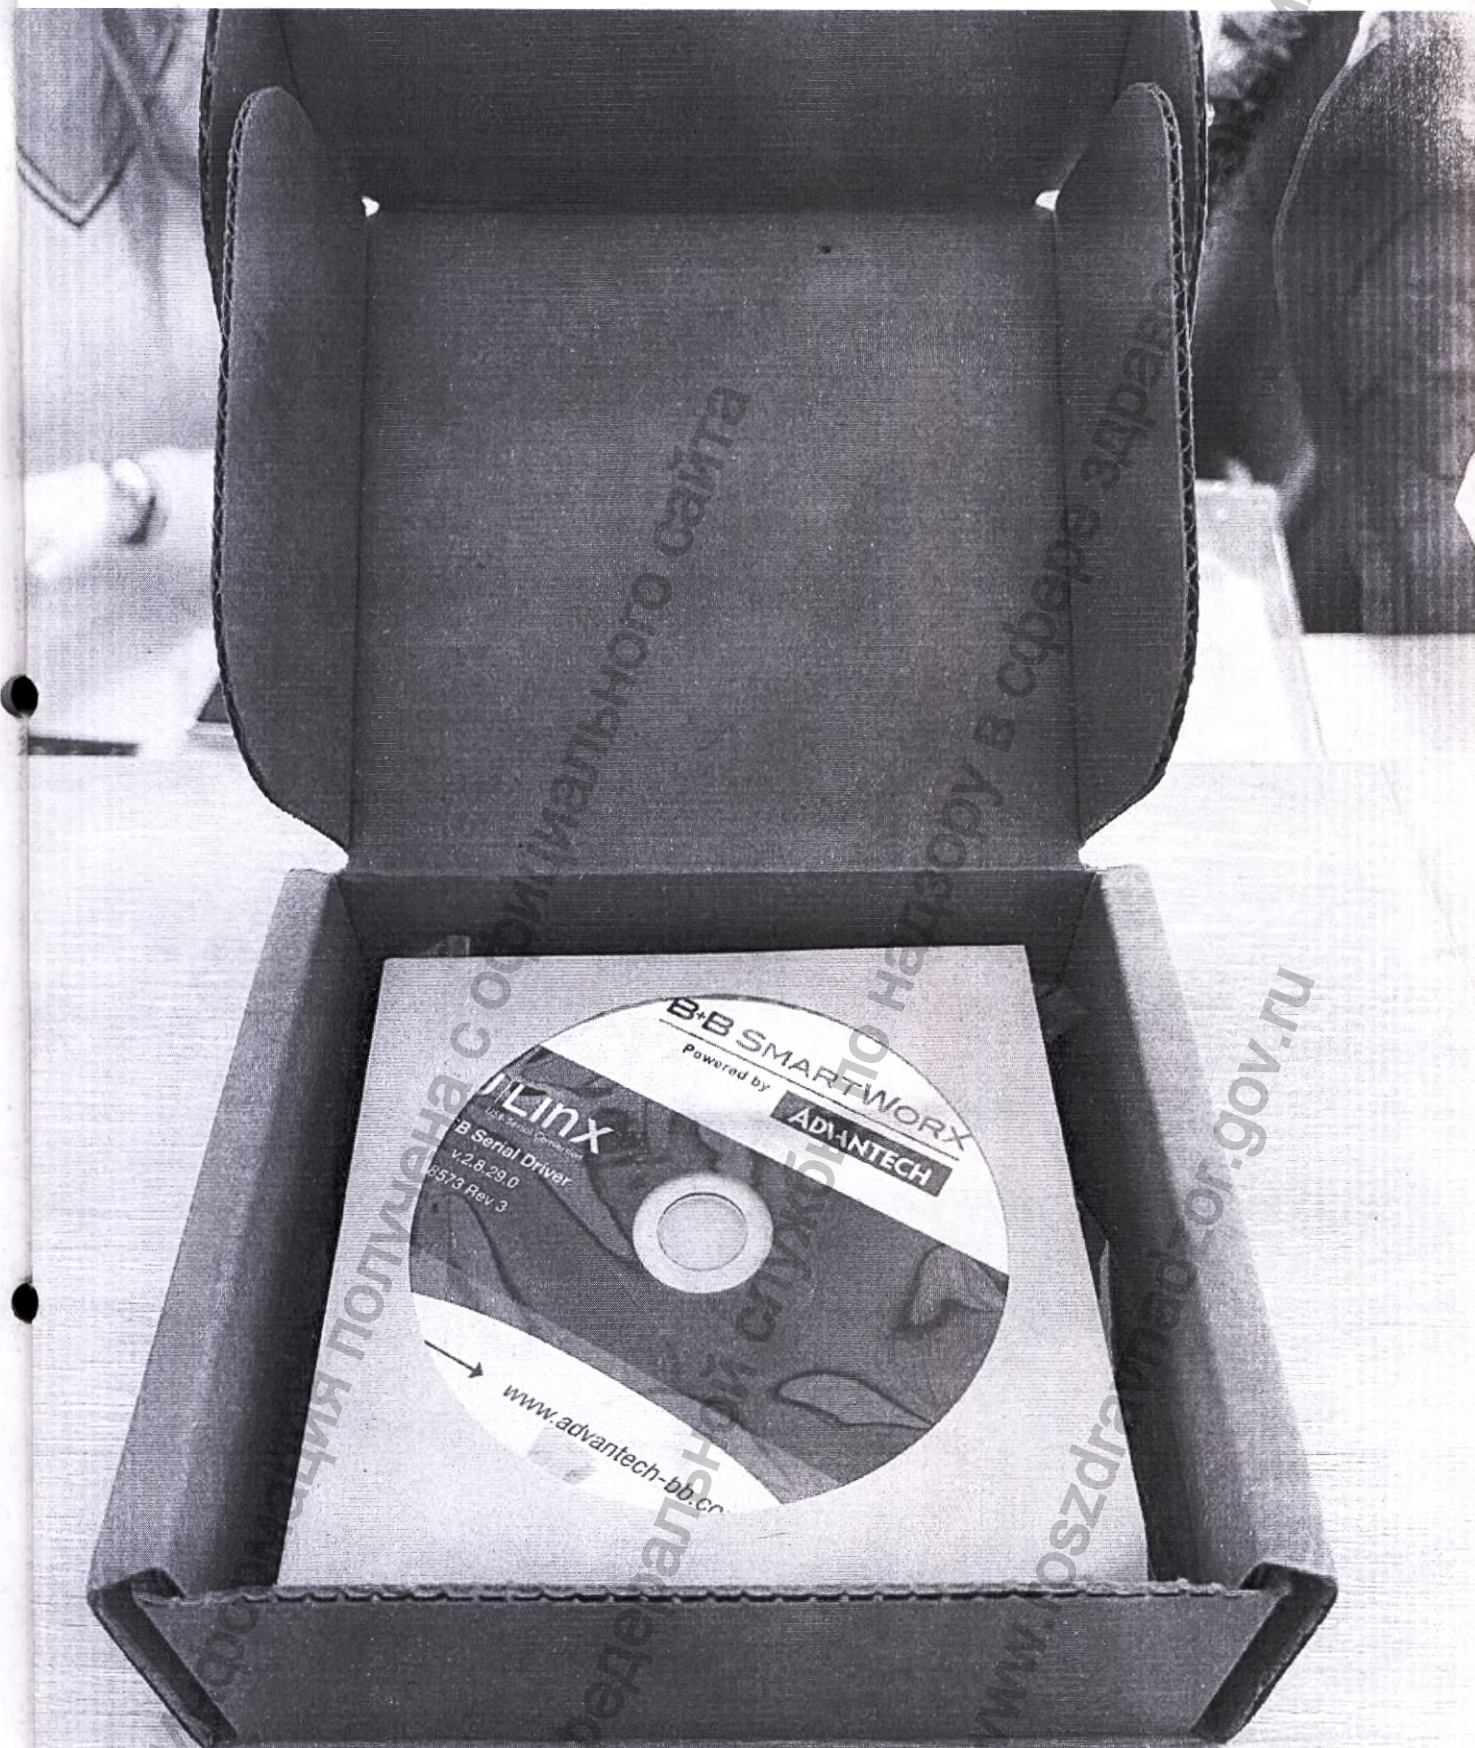

Комплект USB-адаптера, в составе: коннектор (1 шт.), кабель (1 шт.), диск (1 шт.), инструкция по эксплуатации (1 шт.) – в индивидуальной упаковке.

REF EXPORTCAB

CATALOG NUMBER

USB-to-RS232 Adapter Cable
Câble adaptateur USB vers RS-232
USB-RS232-Adapterkabel
Adapterkabel USB-naar-RS232
Cable adaptador USB a RS232
Cavo adattatore da USB a RS232
USB-til-RS232-adapterkabel
Przewód adapter USB-RS232
Кабель адаптера USB-RS232
Cabo Adaptador USB a RS232
USB-RS232 アダプタケーブル
USB-to-RS232 适配器线缆
USB 대 RS232 어댑터 케이블

INTEGRA



(01)10381780121686(10)5613590



Integra LifeSciences Production
Corporation
11 Cabot Boulevard
Mansfield, MA 02048 USA




LOT 5613590

LOT NUMBER
integrable.com

Label P/N 72003773 Rev D
LCA: 1647822-1

Комплект USB-адаптера, в составе: коннектор (1 шт.), кабель (1 шт.), диск (1 шт.), инструкция по эксплуатации (1 шт.) без упаковки.

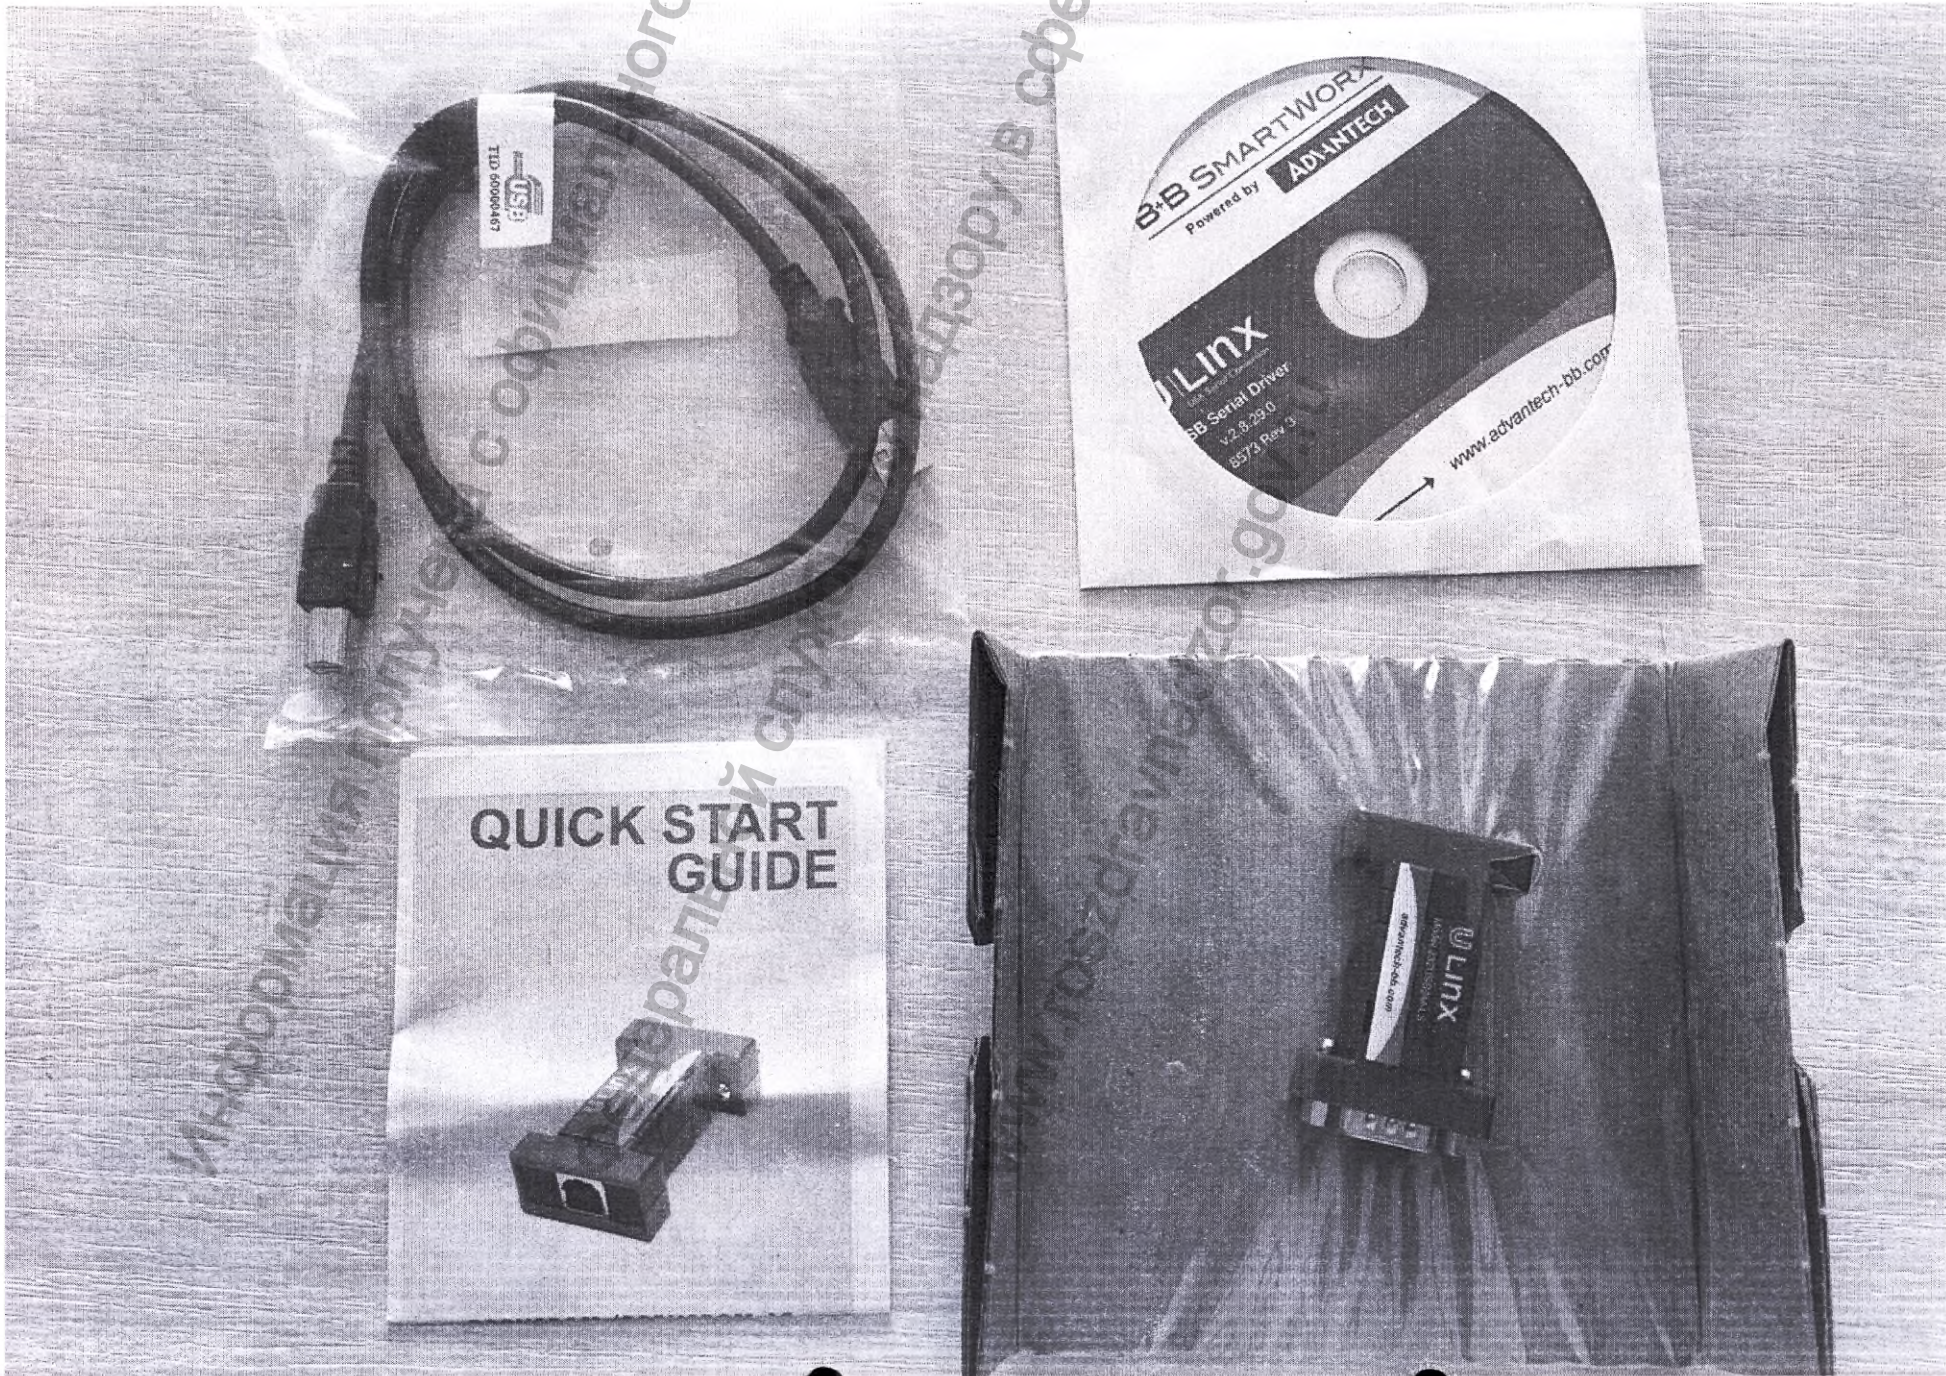

Rx ONLY



Codman® CereLink® ICP Monitor

Instruction Manual

EN – ENGLISH ICP-Monitor	3
FR – FRANÇAIS Moniteur PIC	44
DE – DEUTSCH ICP-Monitor	84
IT – ITALIANO Monitor ICP	124
ES – ESPAÑOL Monitor de PIC	164
DA – DANSK ICP-monitor	203
FI – SUOMI ICP -monitori	242
PT (EU) – PORTUGUÊS Monitor de PIC	281
RU – Русский Монитор ВЧД	320
SV – SVENSKA ICP-monitor	360
NL – NEDERLANDS ICP-monitor	399

Codman
SPECIALTY SURGICAL

A DIVISION OF INTEGRA LIFESCIENCES

INTEGRA

Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью

18 (всего листов) лист об

Директор Чебурашкин Д.М.



Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.goszdravnadzor.gov.ru

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор
ООО «Нейропроджект»



Д.М. Чебурашкин

«2» июня 2022 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Монитор CereLink® для измерения внутричерепного давления

Производства Интегра ЛайфСайнсиз Продакшн Корпорейшн (Integra LifeSciences Production Corporation), США

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

www.gosdrazhnadzor.gov.ru

Монитор CereLink® для измерения внутричерепного давления

Дата изготовления: дд.мм.гггг
Количество: _____ штук
Артикул: 82-6820
Номер партии: _____
РУ: № _____



Транспортировать при температуре от -30°С до +60°С, влажности от 15% до 85%, давлении от 500 гПа до 1060 гПа (без конденсации)
Производитель: «Интегра ЛайфСайнс Продакшн Корпорейшн», США
Страна изготовления: США
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект», Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101, Тел.+7 495 6608173

Сменный блок питания

Дата изготовления: дд.мм.гггг
Количество: _____ штук
Артикул: 82-6822
Номер партии: _____
РУ: № _____



Транспортировать при температуре от -30°С до +60°С, влажности от 15% до 85%, давлении от 500 гПа до 1060 гПа (без конденсации)
Производитель: «Интегра ЛайфСайнс Продакшн Корпорейшн», США
Страна изготовления: Китай
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект», Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101, Тел.+7 495 6608173

Удлинительный кабель

Дата изготовления: дд.мм.гггг
Количество: _____ штук
Артикул: 82-6845
Номер партии: _____
РУ: № _____



Транспортировать при температуре от -30°С до +60°С, влажности от 15% до 85%, давлении от 500 гПа до 1060 гПа (без конденсации)
Производитель: «Интегра ЛайфСайнс Продакшн Корпорейшн», США
Страна изготовления: Китай
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект», Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101, Тел.+7 495 6608173

Батарея

Дата изготовления: дд.мм.гггг
Количество: _____ штук
Артикул: 82-6824
Номер партии: _____
РУ: № _____



Транспортировать при температуре от -30°С до +60°С, влажности от 15% до 85%, давлении от 500 гПа до 1060 гПа (без конденсации)
Производитель: «Интегра ЛайфСайнс Продакшн Корпорейшн», США
Страна изготовления: Германия
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект», Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101, Тел.+7 495 6608173

Комплект USB-адаптера, в составе: коннектор (1 шт.), кабель (1 шт.), диск (1 шт.), инструкция по эксплуатации (1 шт.)

Дата изготовления: дд.мм.гггг
Количество: _____ штук
Артикул: EXPORTCAB
Номер партии: _____
РУ: № _____



Транспортировать при температуре от -30°С до +60°С, влажности от 15% до 85%, давлении от 500 гПа до 1060 гПа (без конденсации)
Производитель: «Интегра ЛайфСайнс Продакшн Корпорейшн», США
Страна изготовления: Китай
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропроджект», Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101, Тел.+7 495 6608173

Информация получена с официального сайта

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

2 (2000) лист а

Директор (Чебурашкин Д.М.)



Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdravnadzor.gov.ru