



Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для количественного выявления
антител класса G к SARS-CoV-2»
«ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный»
 Серия 01 от 2021.10.14

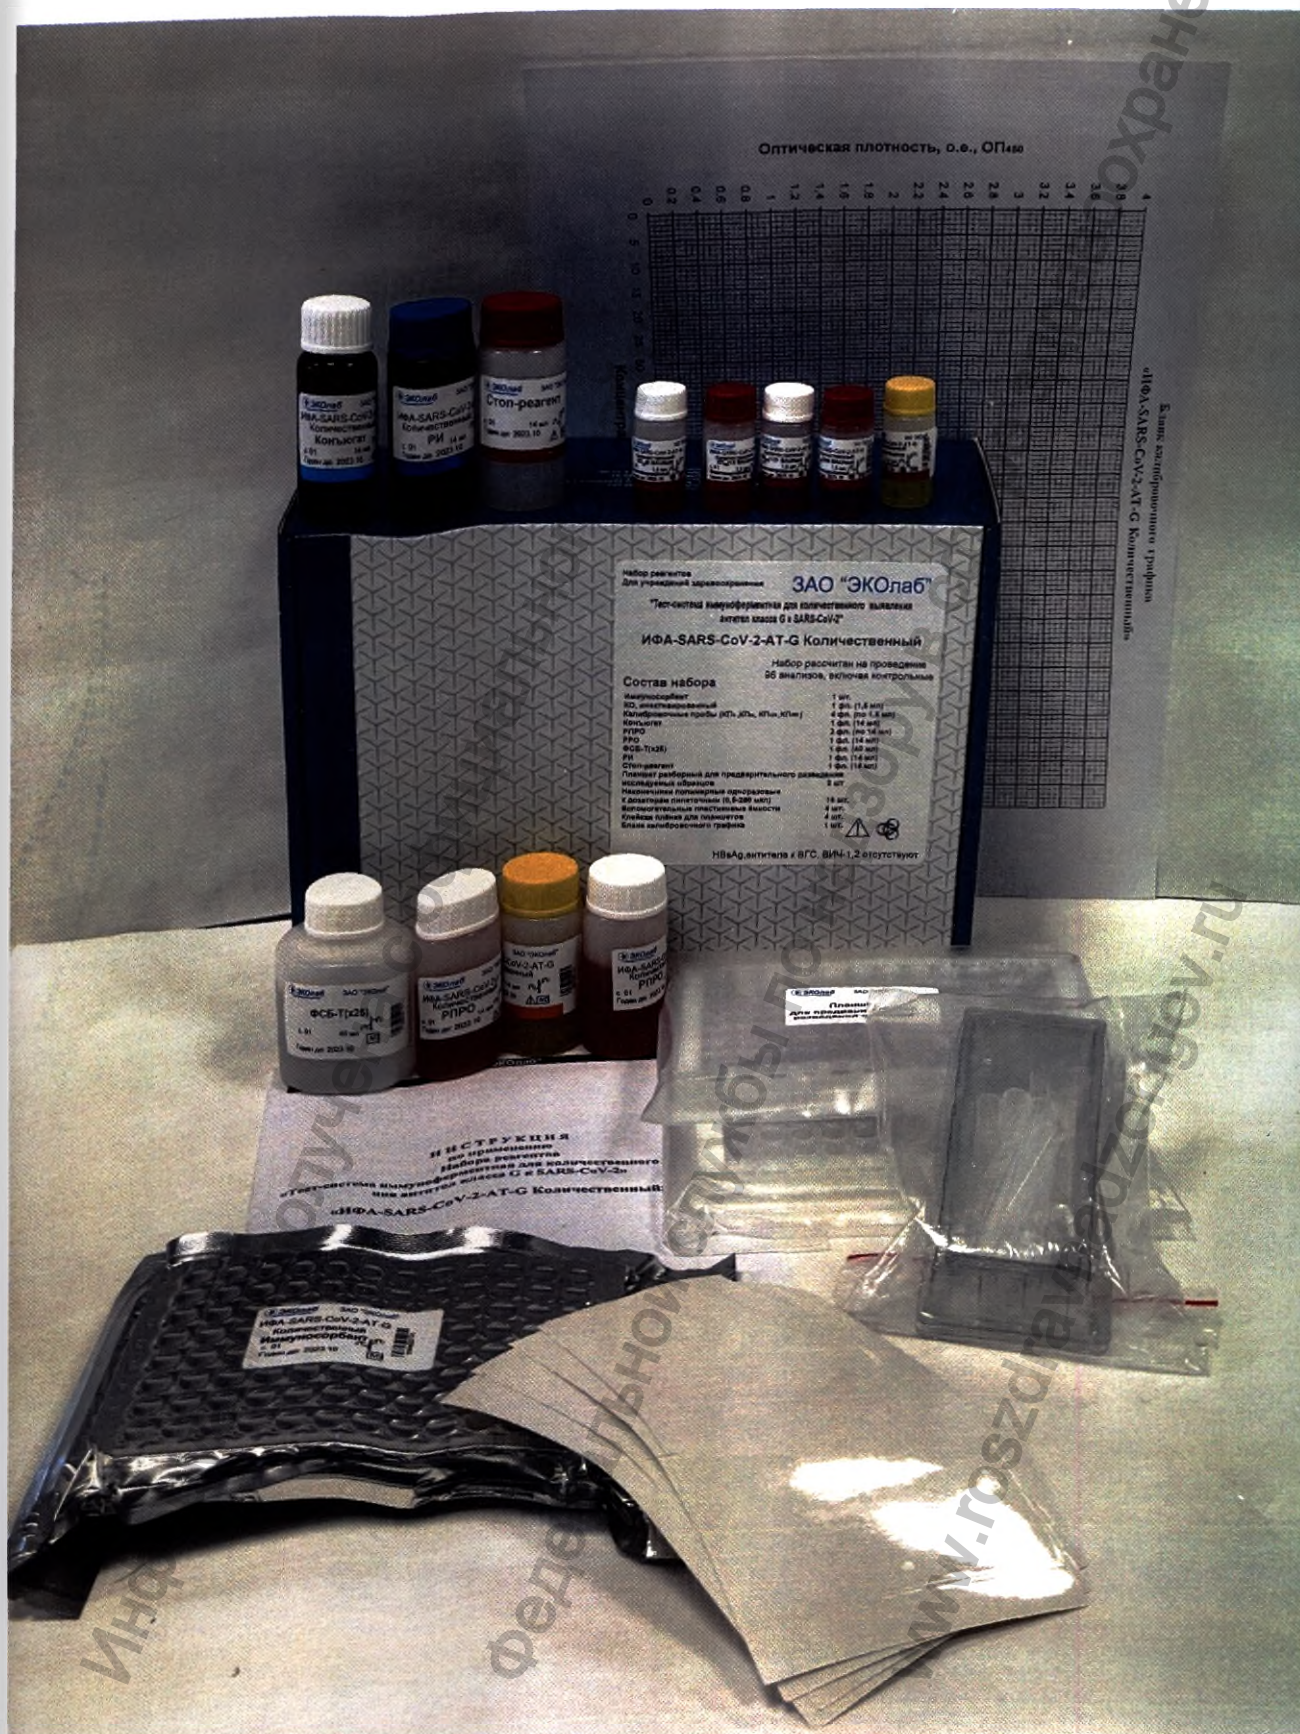

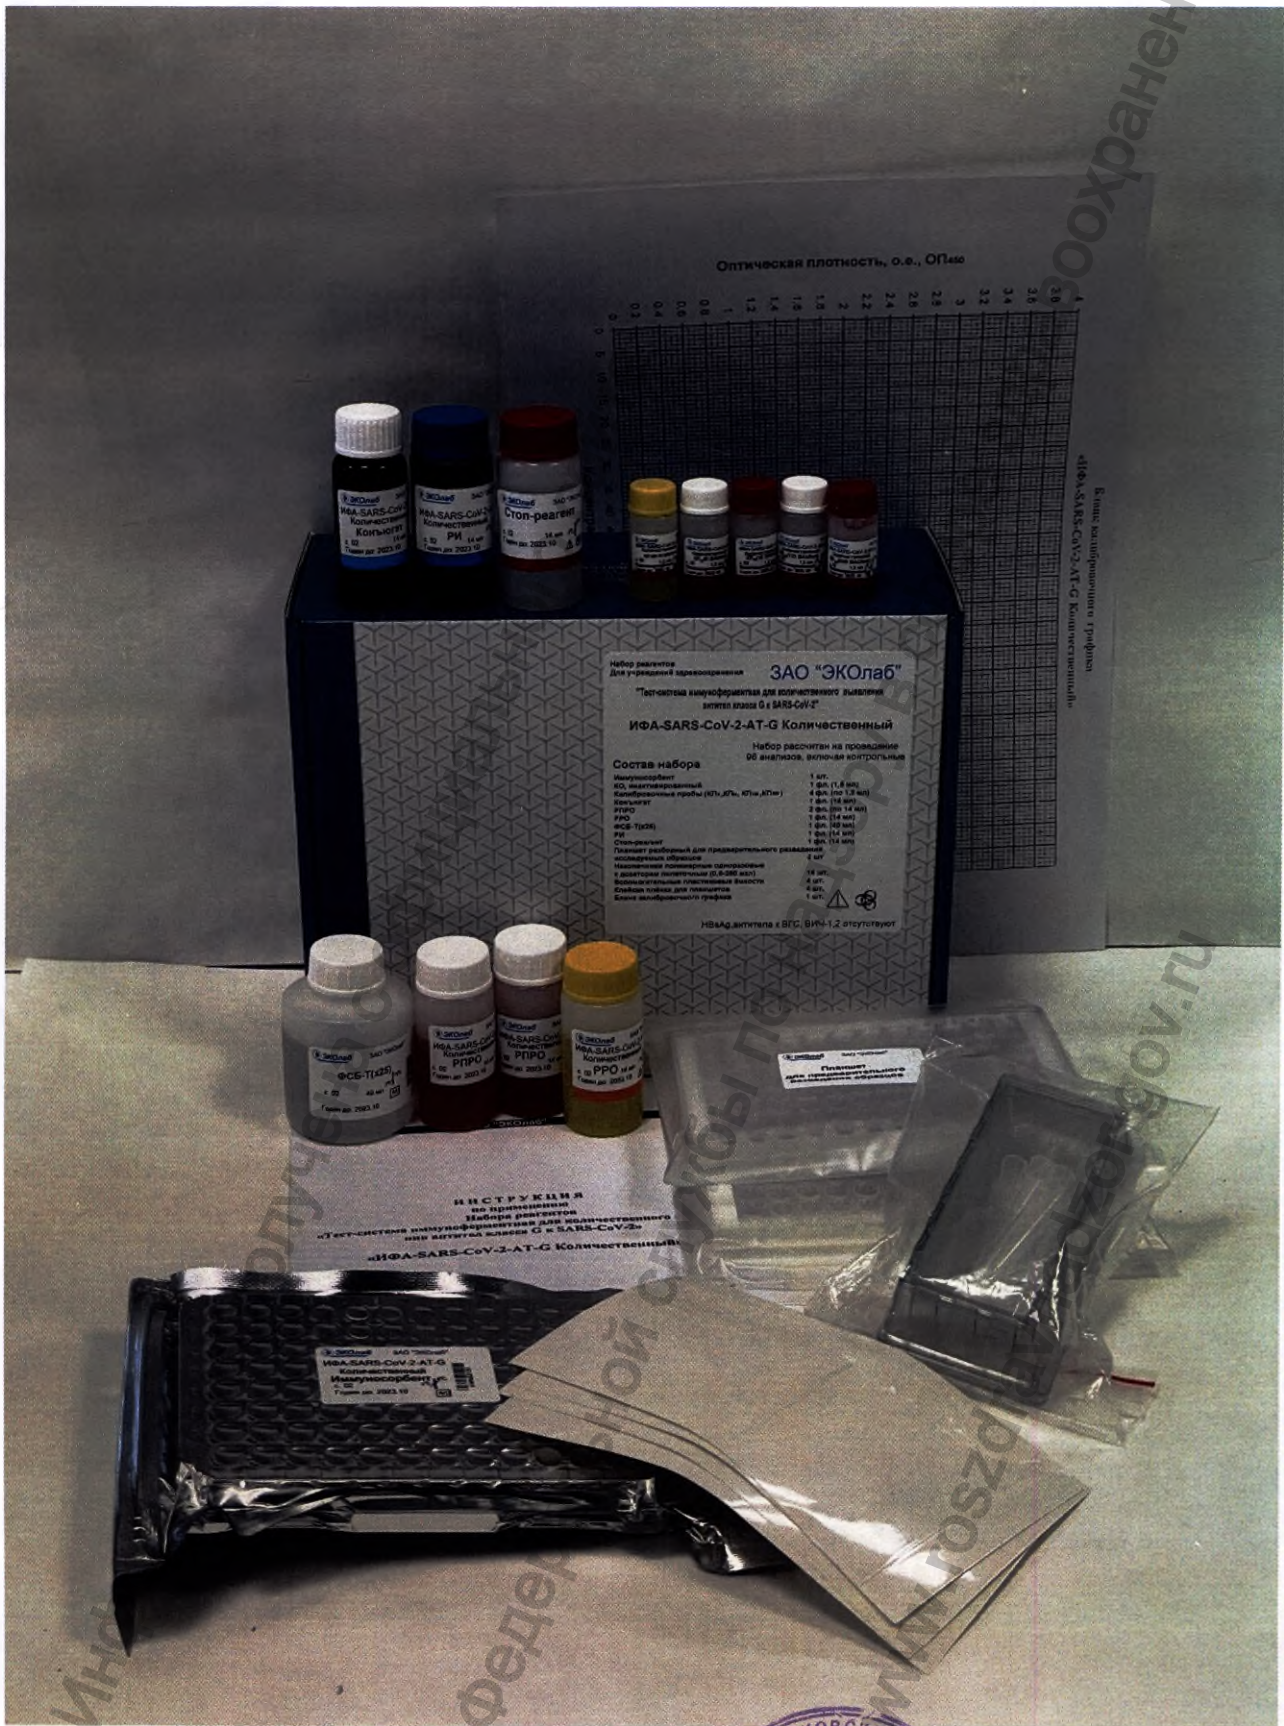

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере защиты

www.goszdravnadzor.gov.ru

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист а

Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

2021 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

"Тест-система иммуноферментная для количественного выявления
антител класса G к SARS-CoV-2"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
КО, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
Калибровочные пробы (КП ₀ , КП ₁₀ , КП ₁₂₅ , КП ₅₀₀)	4 фл. (по 1,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	2 фл. (по 14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.
Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным (0,5-250 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.
Бланк калибровочного графика	1 шт.

HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1,2 отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
Иммуносорбент
с. 01
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
Конъюгат
с. 01 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ФСБ-Т(x25)
с. 01 40 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₀ (1,5 ВАЛ/мл)
с. 01 1,5 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РПРО 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РПРО 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РИ 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₁₂₅ (125 ВАЛ/мл)
с. 01 1,5 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Стоп-реагент
с. 01 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

Планшет
для предварительного
разведения образцов

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КО (149-70 ВАЛ/мл)
с. 01 1,5 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₅₀₀ (500 ВАЛ/мл)
с. 01 1,5 мл
Годен до: 2023.10

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

"Тест-система иммуноферментная для количественного выявления
антител класса G к SARS-CoV-2"

ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный

Набор рассчитан на проведение
96 анализов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 шт.
КО, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
Калибровочные пробы (КП ₀ , КП ₁₀ , КП ₁₂₅ , КП ₅₀₀)	4 фл. (по 1,5 мл)
Конъюгат	1 фл. (14 мл)
РПРО	2 фл. (по 14 мл)
РРО	1 фл. (14 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (14 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (14 мл)
Планшет разборный для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.
Наконечники полимерные одноразовые к дозаторам пипеточным (0,5-250 мкл)	16 шт.
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая плёнка для планшетов	4 шт.
Бланк калибровочного графика	1 шт.



HBsAg, антитела к ВГС, ВИЧ-1, 2 отсутствуют

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов

2021 год.



ЗАО «ЭКОлаб»

Для профессионального применения
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G Количественный

ТУ 21.20.23-318-70423725-2021
РУ

Каталожный № 22.13.1

Серия № 02 Контрольный № 104

Дата изготовления: 2021.10.15

Годен до: 2023.10.15



22.13.1

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
Иммуносорбент
с. 02
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
Конъюгат
с. 02 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ФСБ-Т(x25)
с. 02 40 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₀ (0 BALU/ml)
с. 02 1,5 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РПРО
с. 02 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РПРО
с. 02 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
РИ
с. 02 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₁₂₅ (125 BALU/ml)
с. 02 1,5 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
Стоп-реагент
с. 02 14 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
Планшет
для предварительного
разведения образцов

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КО (40-70 BALU/ml)
с. 02 1,5 мл
Годен до: 2023.10

ЗАО «ЭКОлаб»
ИФА-SARS-CoV-2-AT-G
Количественный
КП₅₀₀ (500 BALU/ml)
с. 02 1,5 мл
Годен до: 2023.10

Директор производства ДП:

Осинская А.Д.

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

www.gosdrazhnadzor.gov.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью



лист 2
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
2021 г.