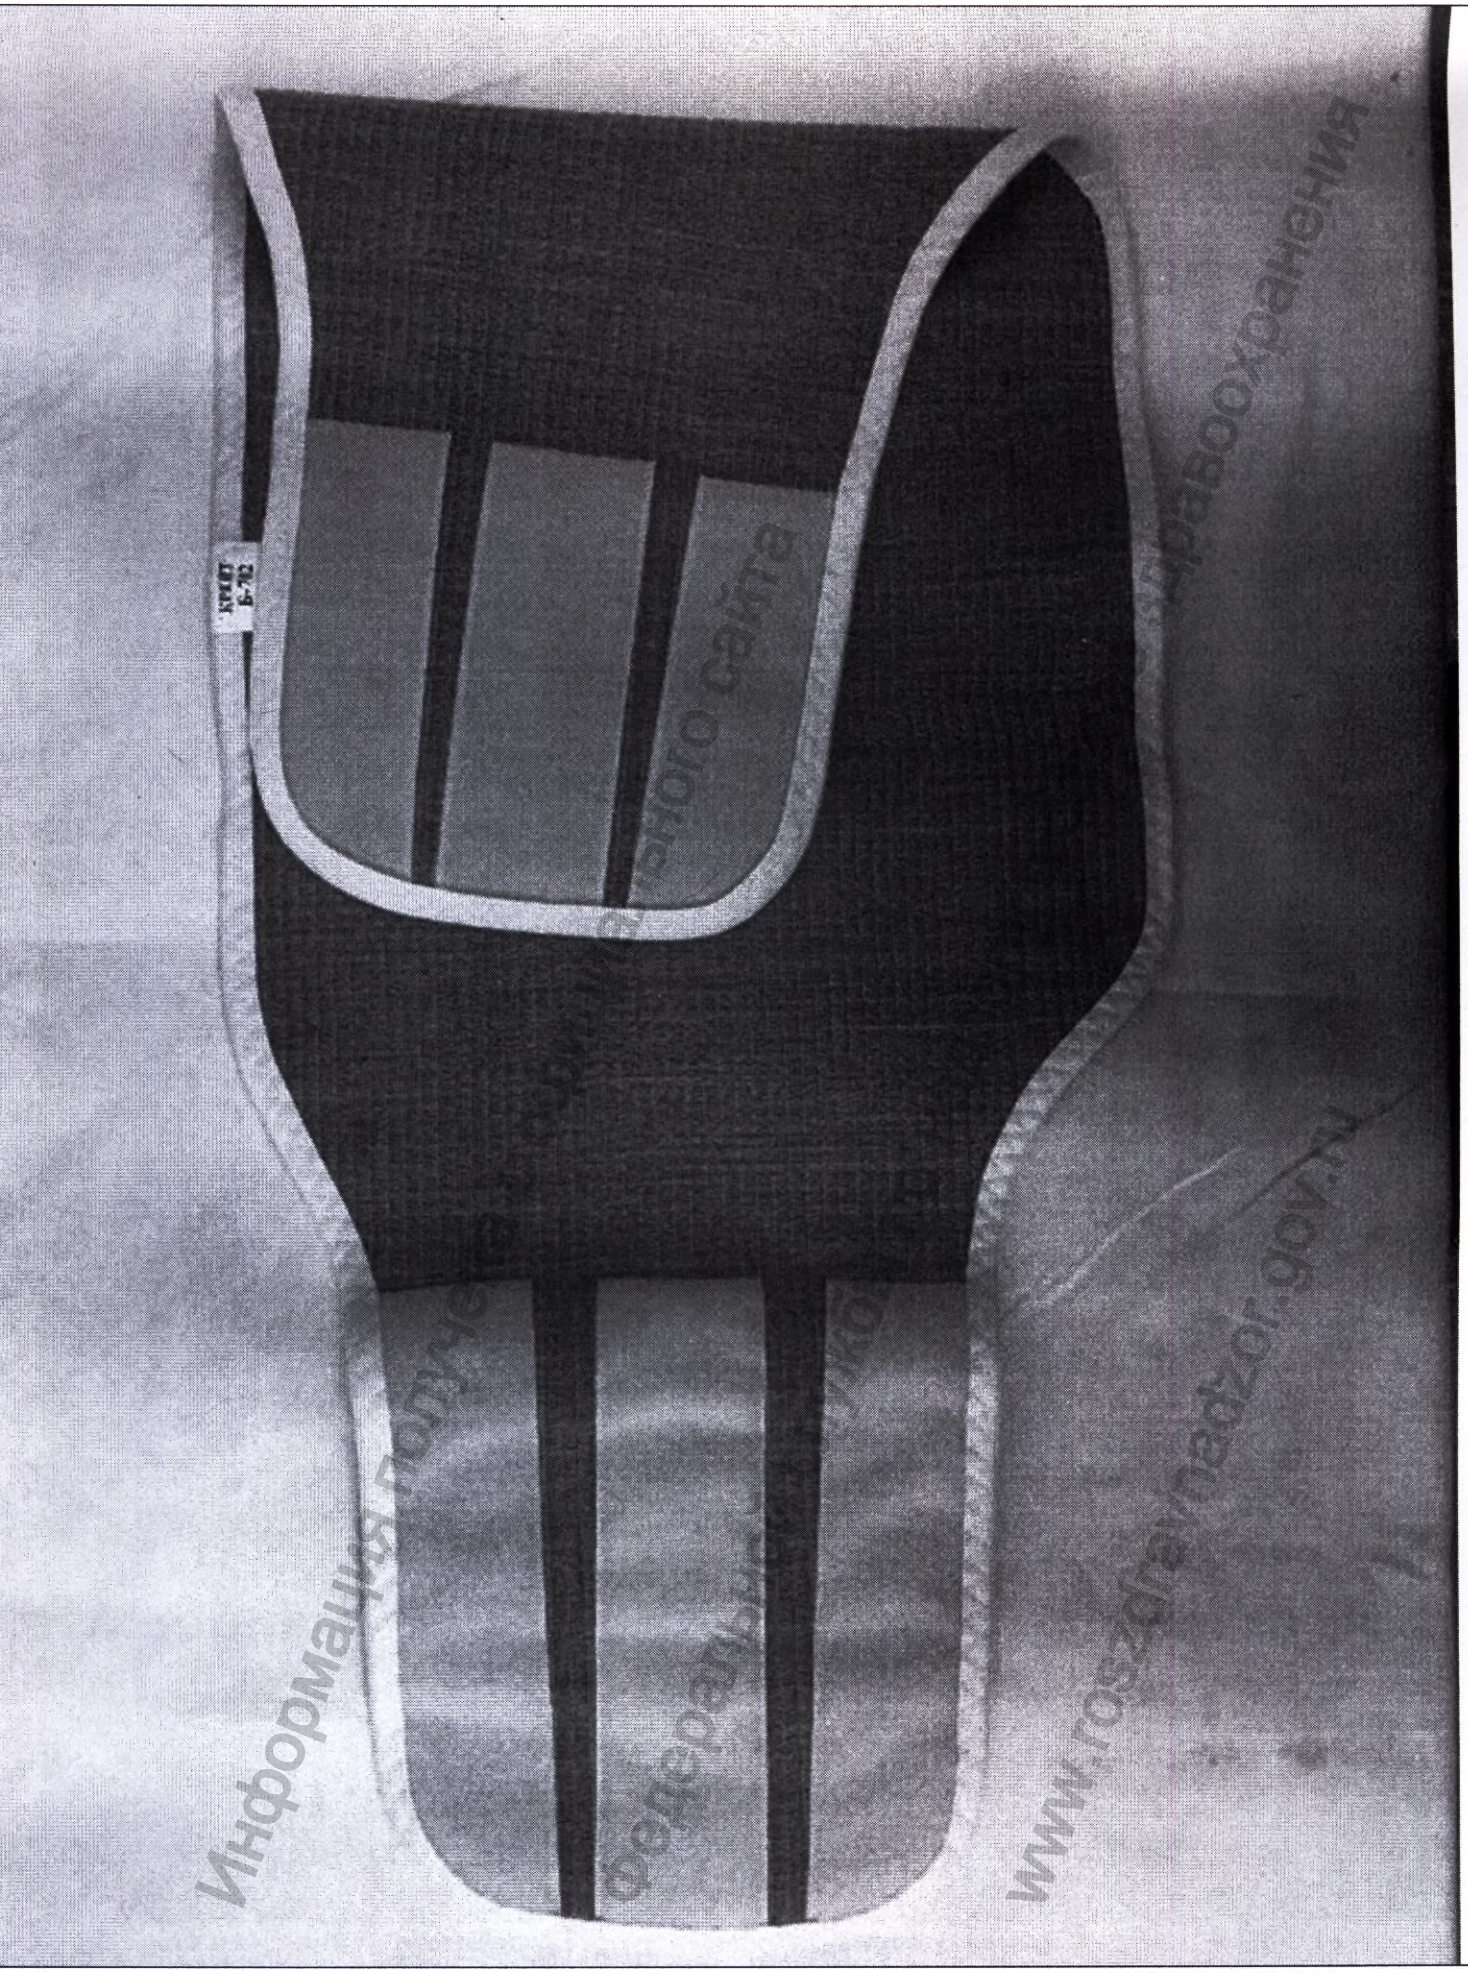

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт», Б-702

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

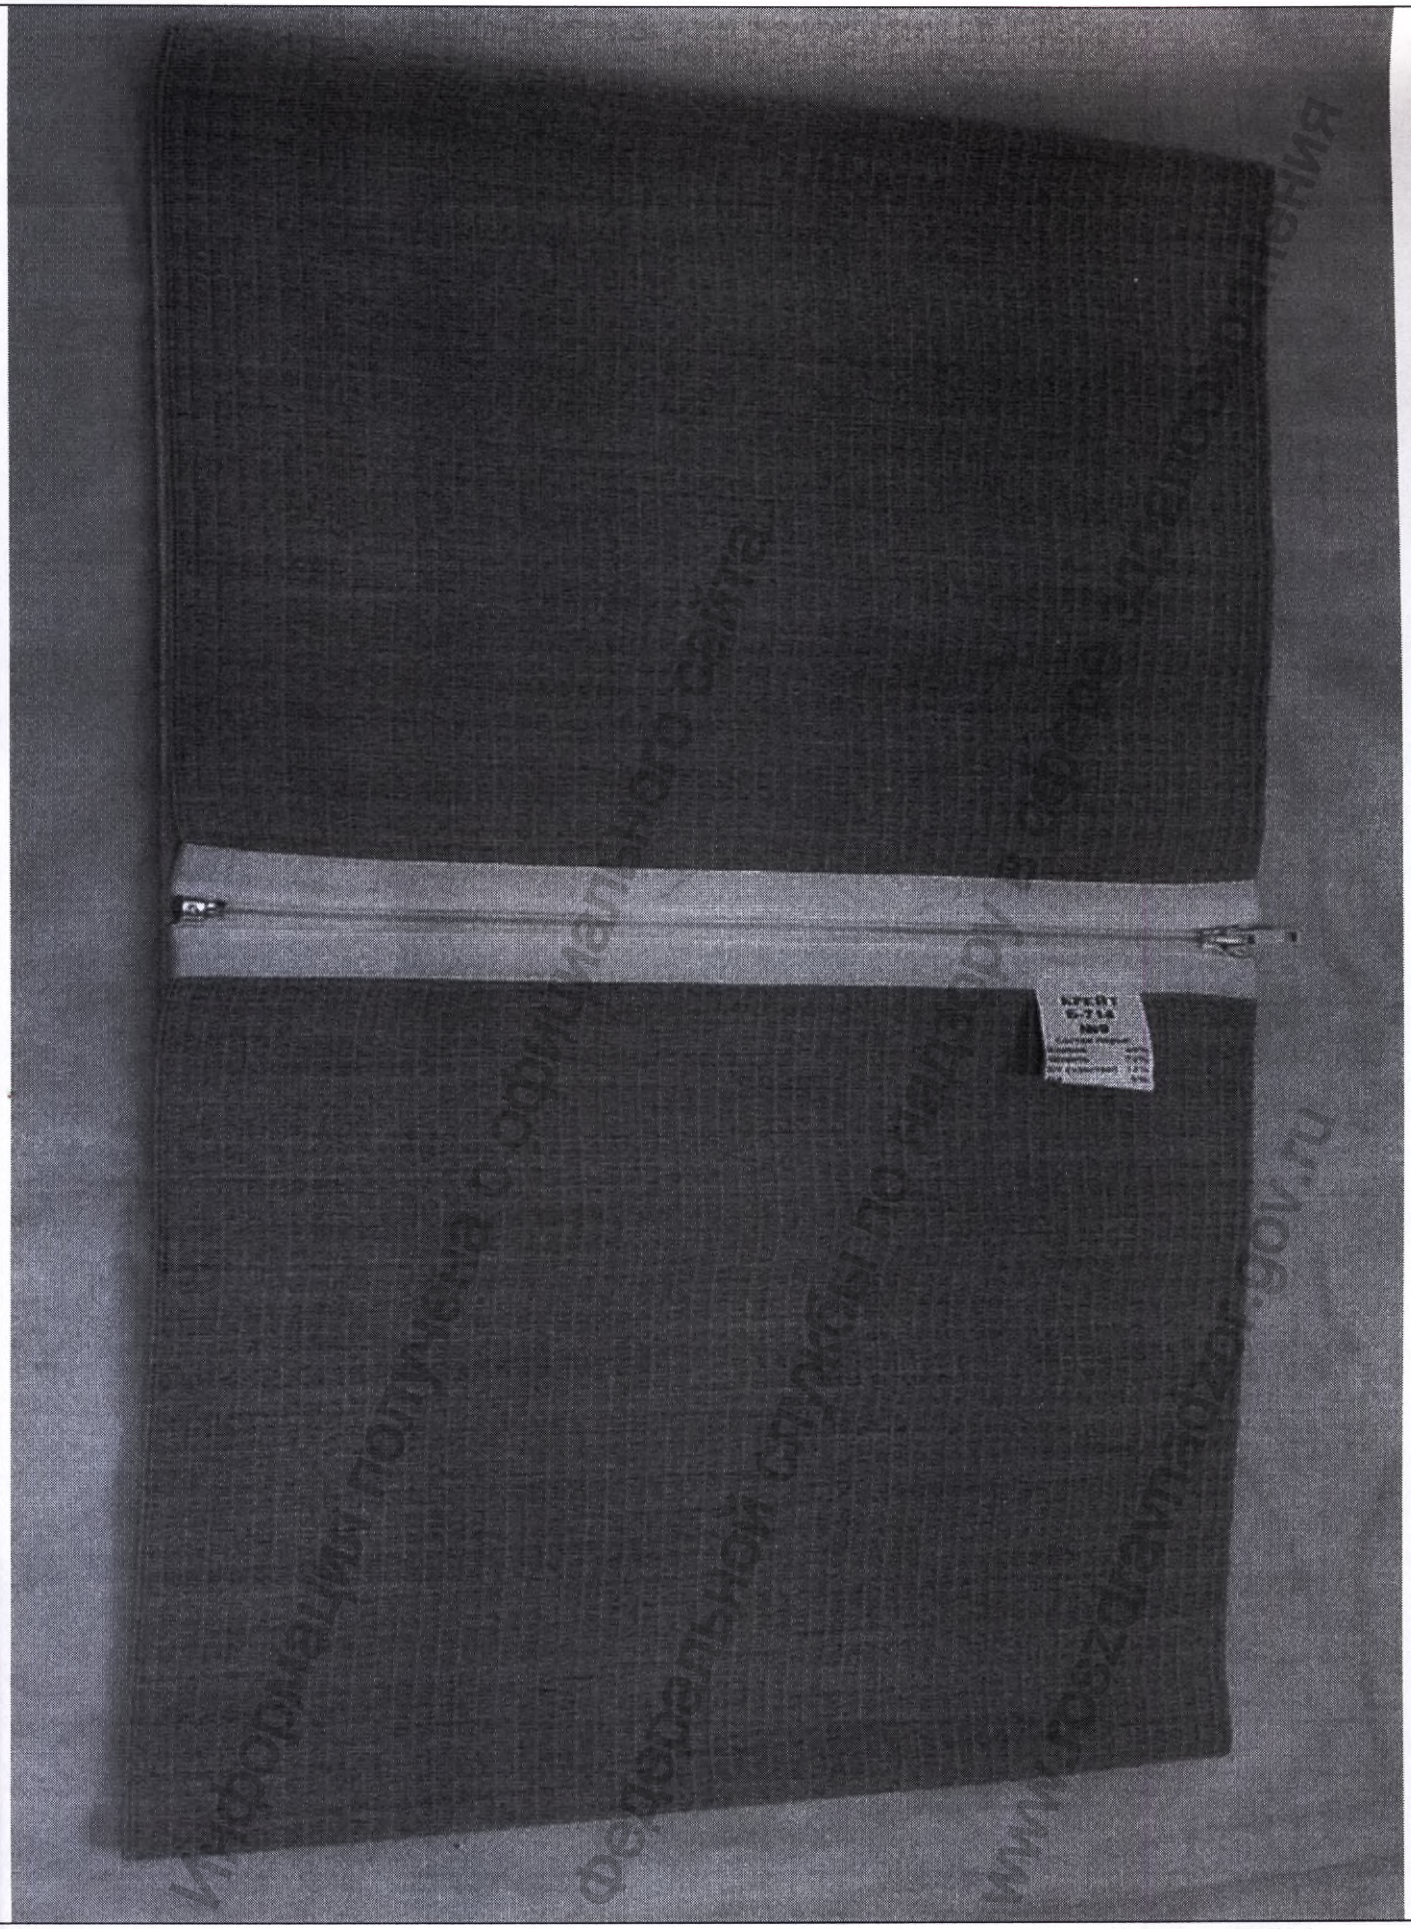

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт», Б-714 (а также Б-710, Б-711)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов) 9

Руководитель организации

08.12.202

Общество с ограниченной ответственностью "Крейт" Санкт-Петербург

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Макет ярлыка для маркировки изделий

КРЕЙТ

Артикул

Размер

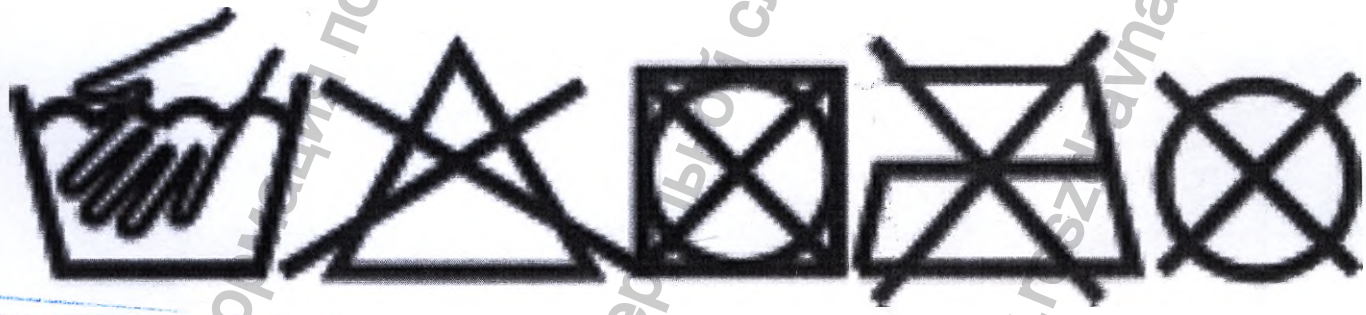

Состав основного материала изделия:

КОПИЯ ВЕРНА
ПОДПИСЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Крейт" Санкт-Петербург
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru
Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

КРЕЙТ

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
№3		
№4		
№5		
№6		
№7		
№8		

РЕКОМЕНДОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для согревания пояснично-крестцового отдела позвоночника при радикулите, остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика переохлаждения, радикулиты, невриты, миозиты, заболевания почек в неострый период.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт».
Инструкция – 1шт.
Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж Б-702 надеть в положении лежа на спине, при этом ребра жесткости должны располагаться на одинаковом расстоянии от позвоночника. Плотно застегнуть бандаж. Бандаж Б-710, Б-711 рекомендуется надевать через ноги. Бандаж Б-714 расположить на теле и застегнуть на застежку-молнию.
СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от _____ 20 ____ года.

№ ФСР _____
ТУ 9396 – 006–96814693–2009.
Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.
Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.
Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.
Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
Номер партии: _____

Изделия применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относятся к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав: _____

Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

КРЕЙТ

Размер	Обхват талии, см	Масса, г
№1		
№2		
№3		
№4		
№5		
№6		
№7		
№8		
№9		
№10		

РЕКОМЕНДОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт»

НАЗНАЧЕНИЕ: Бандаж предназначен для поддержания мягких тканей до и после операций, для согревания пояснично-крестцового отдела позвоночника при радикулите, остеохондрозе и других заболеваниях позвоночника.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Профилактика переохлаждения, радикулиты, невриты, миозиты, заболевания почек в неострый период.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.
ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт».
Инструкция – 1шт.
Индивидуальная потребительская упаковка – 1 шт.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров. Не применять при наличии аллергических реакций на материал. Не допускается применять по истечении срока хранения. Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке. Не использовать вблизи открытого пламени.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ: Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С. Бандаж Б-702 надеть в положении лежа на спине, при этом ребра жесткости должны располагаться на одинаковом расстоянии от позвоночника. Плотно застегнуть бандаж. Бандаж Б-710, Б-711 рекомендуется надевать через ноги. Бандаж Б-714 расположить на теле и застегнуть на застежку-молнию.
СТИРКА И УХОД: Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С. Отбеливание запрещено. Не применять барабанную сушилку. Глажение запрещено. Чистка запрещена.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 20 года.

№ ФСР
ТУ 9396 – 006–96814693–2009.
Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»); Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. тел. 8 (800) 700-68-50; e-mail: torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru.
Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С). Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий. Средний срок хранения не менее трех лет. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.
Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.
Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
Номер партии:

Изделия применять по назначению врача.
Изделие многоразового использования.
Изделие относятся к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

Состав:

Дата изготовления: 20 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.gov.ru

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 лист(ов)

Руководитель организации

8.12.2

Общество с ограниченной ответственностью "Крейт" * Санкт-Петербург *

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

КРЕЙТ

РЕКОМЕНДОВАНО МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ

Размер изделия:

Количество изделий:

Бандаж для пояснично-крестцового отдела позвоночника, согревающий – «Крейт»

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие

от 20 года.

№ ФСР

ТУ 9396 – 006–96814693–2009.

Производитель: общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп. 4, литер А, пом. 24 Н, тел. 8 (800) 700 - 68 -50, e-mail: torg@kreitspb.ru. www.kreitspb.ru.

Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150 — 69, но для температуры от -40 °С до ± 40 °С. Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) и не ближе, чем на 1 м от обогревательных приборов. Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Средний срок хранения не менее 3-х лет.

Дата изготовления: 20 г.

Номер партии:

КОПИЯ ВЕРНА

ПОДПИСЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Крейт" Санкт-Петербург

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Информация с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.gov.ru

МАКЕТ ТРАНСПОРТНОЙ МАРКИРОВКИ

При получении груза проверить целостность упаковки

КОПИЯ ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью "Крейт" Санкт-Петербург

12.2021

Получатель:

Адрес:

Телефон:

Номер заказа:

Вес брутто:

Отправитель: ООО «Крейт»

Адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова д. 10

Телефон: 8 (812) 748-25-00

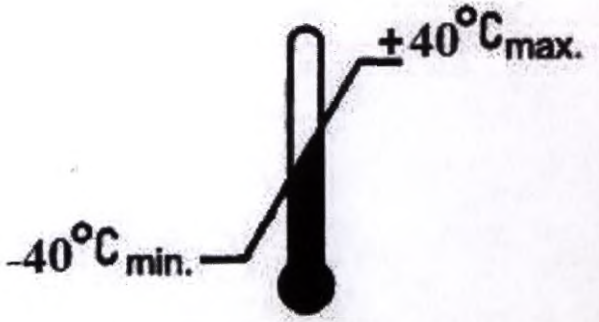

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере www.roszdravnadzor.gov.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru