

Анализатор агрегации тромбоцитов AT-02

АНАЛИЗАТОР АГРЕГАЦИИ
ТРОМБОЦИТОВ

AT-02

С(4)	Д(5)	Ц/Р	7	8	9
Т(2)	А(3)	УТВ	4	5	6
Ш(0)	К(1)	СБР	1	2	3
ПУСК	С	В	0	.	1-1

0.00000.00000


Ц Р

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.gov.ru






Заглушка – 1 шт.

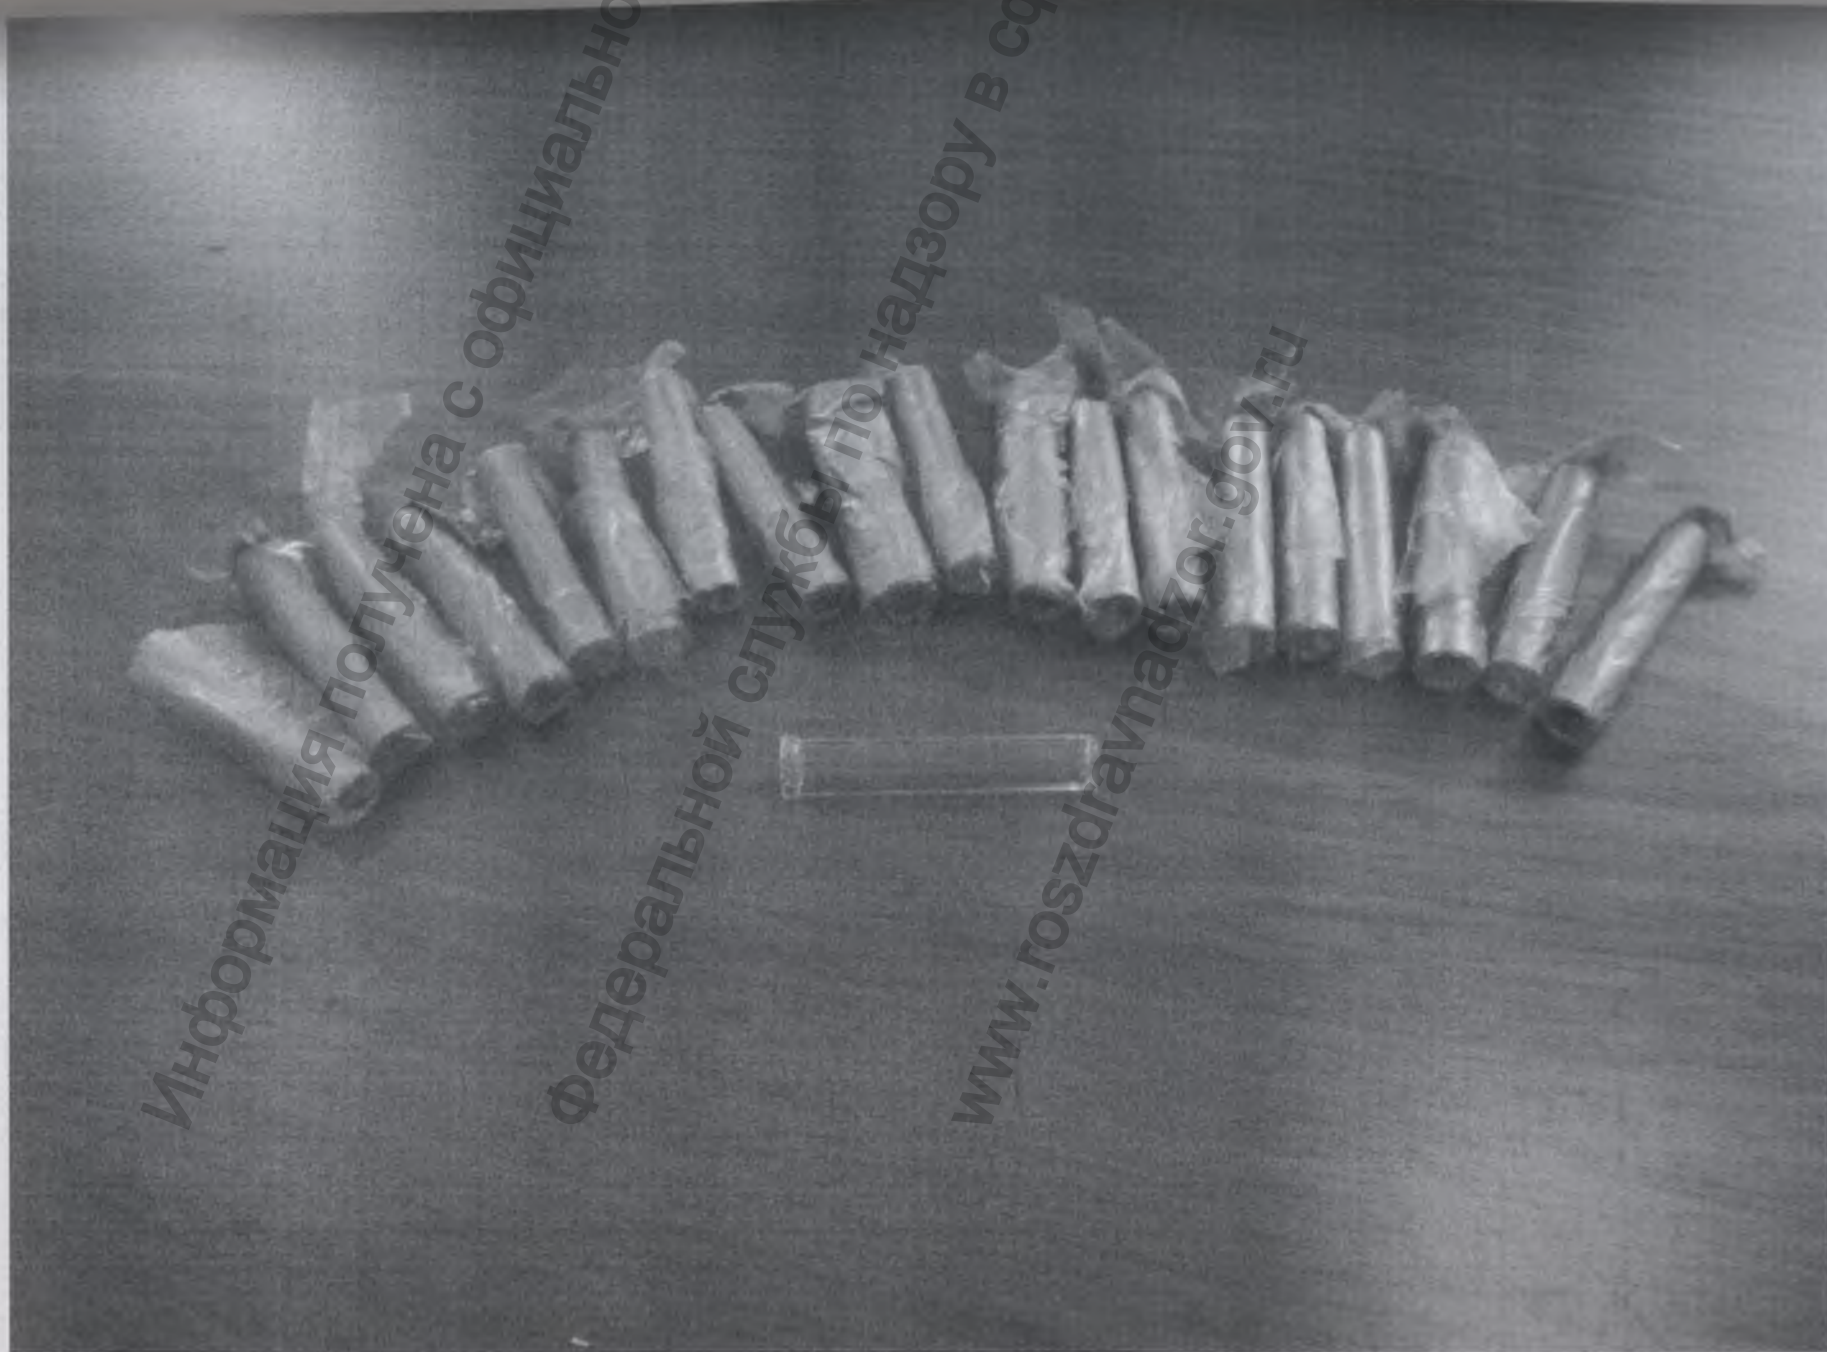

Кювета – 20 шт.

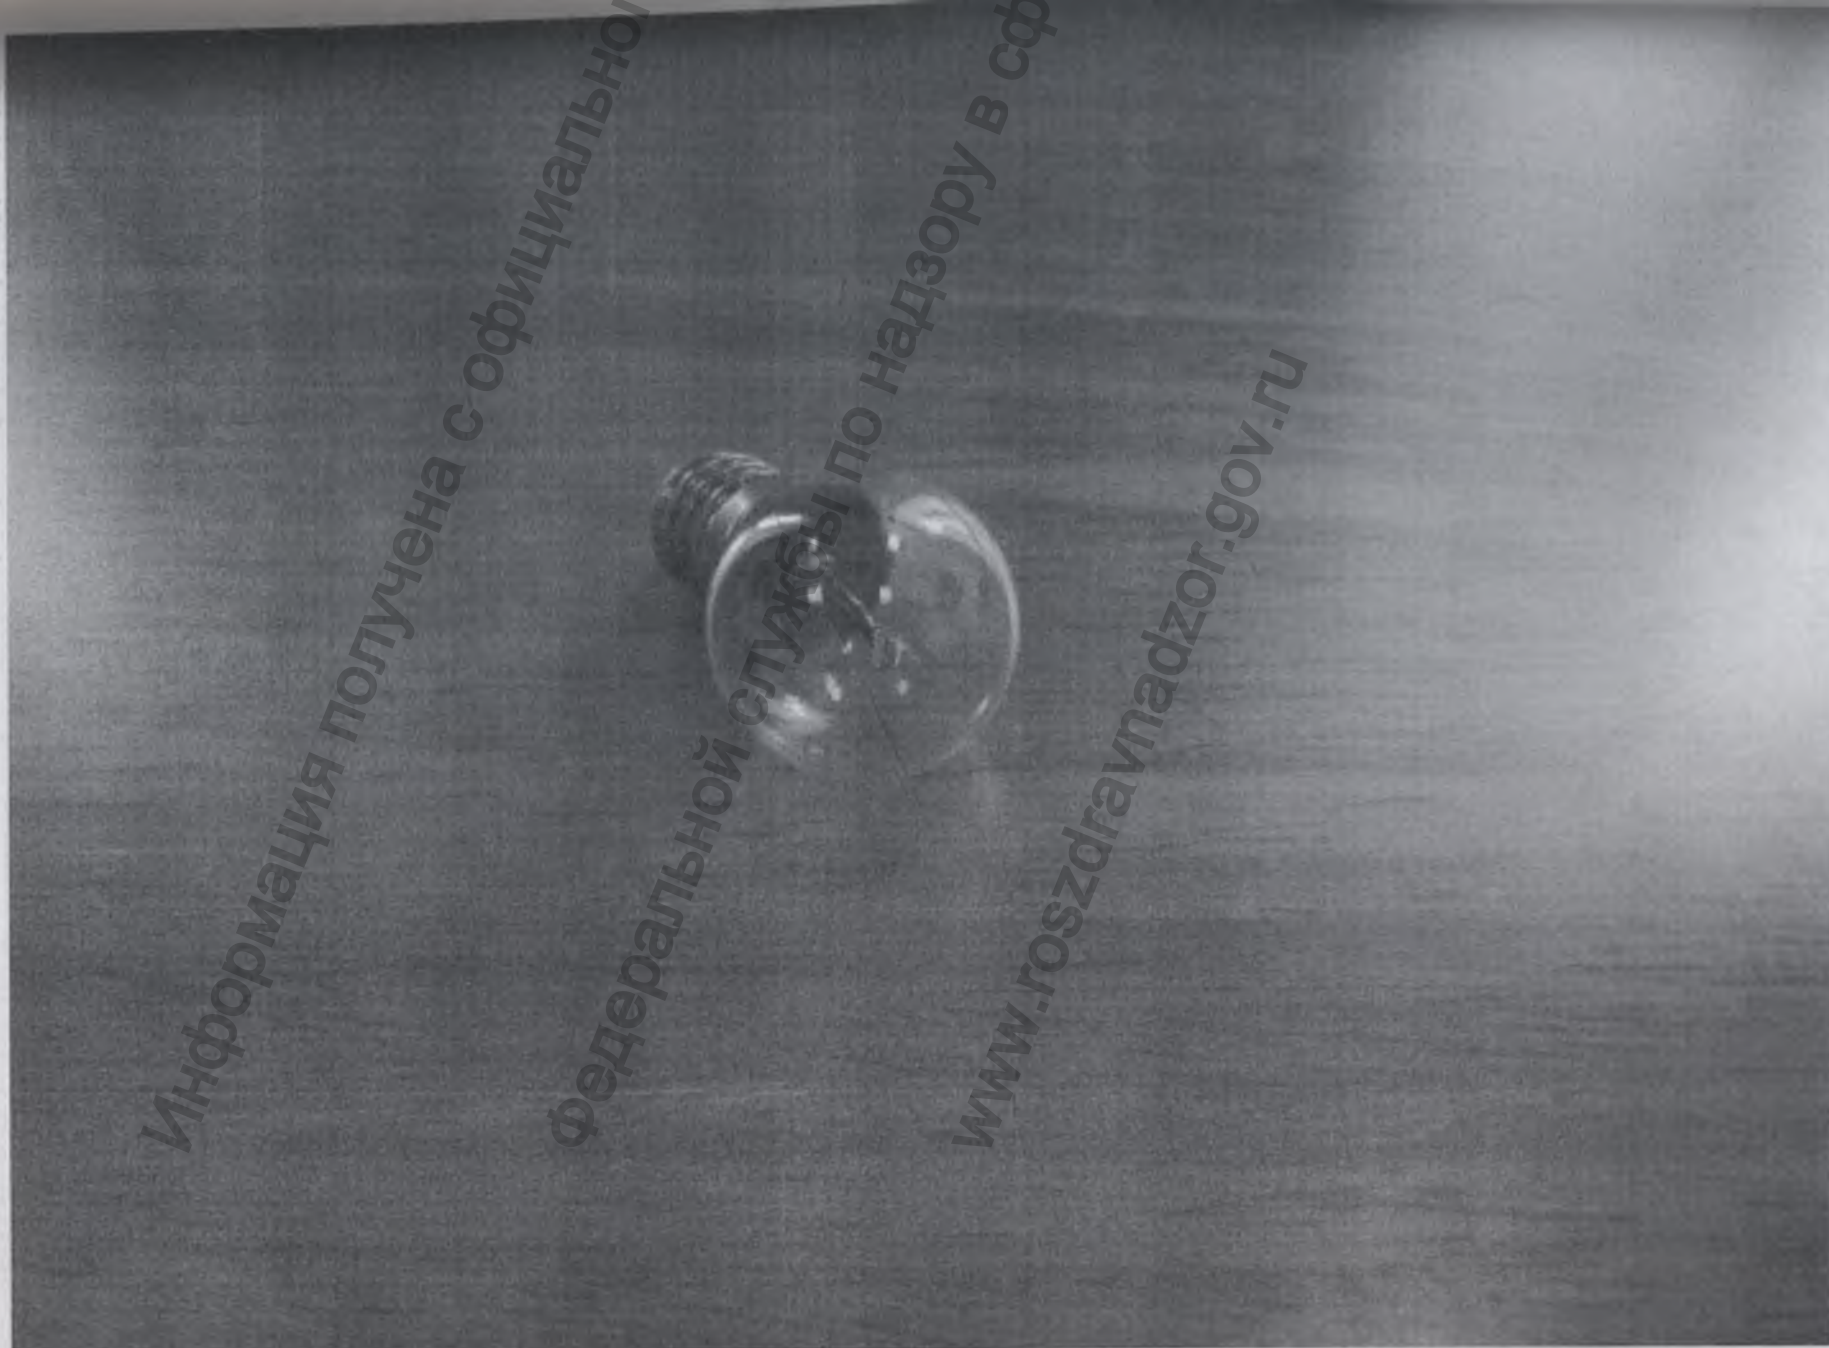

Лампа ОП 8-9

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramadzor.gov.ru



Стержень – 20 шт.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения



Программа АТ-02

www.gosdraznadzor.gov.ru

Информация получена с официальной
Федеральной службы по надзору в сфере
www.roszdravnadzor.gov.ru



Руководитель организации